

Czujnik Inteligentny nadajnik Aplikacja mobilna

eversense E3

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkowania systemu ciągłego monitorowania glikemii firmy Eversense E3



Znak handlowy Eversense E3

Eversense E3, system ciągłego monitorowania glikemii Eversense E3, Eversense E3 CGM, czujnik Eversense E3, inteligentny nadajnik Eversense E3, aplikacja Eversense oraz logo Eversense E3 są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Pozostałe marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Spis treści

Słowniczek 6

I. Wprowadzenie 9

Pomoc techniczna 9
Elementy systemu Eversense E3 CGM 10
Wymagania systemowe 14
Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności 14
Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu 14
Uszkodzony ekran lub przycisk 14
Modyfikacje urządzenia 15
Wskazania do stosowania 15
Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI 16
Przeciwwskazania 17
Wartość opakowania 17
Korzystanie z instrukcji użytkownika 18

2. Korzyści i zagrożenia 19

Zagrożenia i działania niepożądane 21
Ostrzeżenia 22
Przestrogi 25

3. Rozpoczynanie pracy 28

Ładowanie baterii inteligentnego nadajnika 29
Krok 1. Pobranie i zainstalowanie aplikacji 31
Krok 2. Skonfigurowanie aplikacji – Utworzenie konta, Parowanie i Ustawienia 32
Ikony połączenia z inteligentnym nadajnikiem 40

4. Łączenie wykrytego czujnika 41

5. Codzienne noszenie nadajnika 48

Codzienne użytkowanie 49
Mocowanie inteligentnego nadajnika nad wszczepionym czujnikiem 50
Włączanie i wyłączanie inteligentnego nadajnika 54
Obsługa i konserwacja inteligentnego nadajnika 55
Wskaźnik poziomu naładowania baterii 55
Kontrolki LED stanu 56

6. Kalibrowanie systemu..... 58
Fazy kalibracji 60
Metoda kalibracji 63

7. Użytkowanie aplikacji..... 68
Zarządzanie kontem w aplikacji Eversense 69
Sprawdzanie ustawień urządzenia przenośnego 70
Ekran „Moja Glukoza” 71
Strzałki trendu 74
Zrozumienie decyzji związanych z leczeniem podejmowanych z wykorzystaniem systemu CGM 75
Należy skontaktować się z lekarzem. 77
Podejmowanie decyzji związanych z leczeniem z wykorzystaniem systemu Eversense E3 80
Strzałki trendu w systemie Eversense E3 i decyzje związane z leczeniem 82
Co należy zrobić 85
Wykres trendu 90
Opcje menu 91

8. Dostosowywanie ustawień.. 93
Ustawianie poziomów alertów glikemii 95
Ustawianie poziomów docelowych poziomu glukozy 97
Ustawianie alertów przewidywania 99
Ustawianie alertów o szybkości zmian 101
Ustawianie przypomnień o dziennej kalibracji 103
Ustawianie informacji o systemie 104
Ponownie łączenie czujnika 105
Ustawianie dźwięków 107
Ustawienie Nadpisanie nis. poz. glukozy 109
Ustawienie „Nadajnik odłączony” 116
Ustawianie profilu tymczasowego 120

9. Opisy alertów..... 123
Historia alertów 125
Opisy alertów i wymagane działania 127

10. Dziennik zdarzeń..... 153
Glukoza 155
Posiłek 157
Insulina 158
Zdrowie 159
Ćwiczenie 160

II. Raporty 161
Tygodniowe zestawienie modalne 162
Wykres kołowy poziomu glukozy 163
Raport statystyk poziomu glukozy 163

I2. Udostępniane danych 164
Oprogramowanie do zarządzania danymi Eversense DMS 164
Udostępnij moje dane 164
Synchr. 165
Mój krąg 167
Udostępnianie aplikacji 168

I3. Informacje o produkcie i ogólne informacje o aplikacji 169
Zdjęcie profilowe 170
Wylogowanie 173

I4. Przeglądanie danych z systemu Eversense E3 na urządzeniu Apple Watch 174
Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch 177

I5. Mój krąg 198
Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense E3 CGM i aplikacji Eversense NOW 198

I6. Informacje o czujniku 205
Etapy wszczepiania 206
Etapy wyjmowania 207

I7. Podróże 208

I8. Rozwiązywanie problemów 209
Inteligentny nadajnik 209
Bateria inteligentnego nadajnika i jej ładowanie 211
Łączenie z inteligentnym nadajnikiem 212
Kalibracja 216
Alerty i powiadomienia. 218
Odczyty poziomu glukozy 220
Podejmowanie decyzji o leczeniu 221
Strzałki trendu 222
Aplikacja 222
Czujnik 225
Zdarzenia 227
Synchr. 227
Skróty 228

19. Działanie urządzenia..... 229
Parametry pracy urządzenia w trakcie badania klinicznego 229
Dokładność czujnika Eversense E3 względem analizatora YSI w ramach badania PROMISE 231
Czas eksploatacji czujnika 241
Bezpieczeństwo 242

20. Dane techniczne..... 243
Czujnik 243
Inteligentny nadajnik 244
Zasilacz i ładowarka 245
Przewód USB* do ładowania i pobierania 246
Normy bezpieczeństwa i elektryczne 247
Symbole w aplikacji mobilnej Eversense CGM 250
Symbole na opakowaniu i urządzeniu 253
Ograniczona gwarancja inteligentnego nadajnika Eversense E3 256

21. Eversense DMS..... 259
Wprowadzenie 259
Rozpoczynanie pracy 260
Raporty 276
Ustawienia 294
Nadajnik 298
Udostępnianie danych 306
Pomoc 308

22. Eversense NOW..... 310
Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense CGM i aplikacji Eversense NOW 310
Używanie aplikacji Eversense NOW 313
Dołączenie do kręgu Eversense 315
Menu główne 322
Wyświetlanie danych z systemu CGM 324

Informacje prawne..... 332
Informacje prawne firmy Apple 332
Informacje prawne firmy Google 332
Informacje o Bluetooth® 332
Znak handlowy Bluetooth® 332
Informacje FCC 333
Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego 334

Indeks..... 335

Słowniczek

Alert Alert ostrzega o wystąpieniu sytuacji wymagającej uwagi i reakcji użytkownika w postaci podjęcia odpowiedniego działania.

Aplikacja Eversense Oprogramowanie do zainstalowania na urządzeniu przenośnym, które przedstawia dane dotyczące poziomu glukozy z systemu CGM uzyskane z inteligentnego nadajnika.

Aplikacja kliencka Eversense Aplikacja desktopowa, która umożliwia użytkownikom Eversense przesyłanie danych z inteligentnego nadajnika do systemu zarządzania danymi za pomocą kabla USB.

Automatyczna synchronizacja Po włączeniu tej funkcji w aplikacji mobilnej Eversense dane dotyczące poziomu glukozy i ustawienia glukozy będą automatycznie synchronizowane z systemem Eversense DMS co dwie godziny.

Bluetooth® Nazwa technologii wykorzystującej fale na częstotliwości radiowej (RF) do bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami przenośnymi i innymi urządzeniami.

CGM System ciągłego monitorowania glikemii. Ciągłe monitorowanie poziomu glikemii z płynu tkankowego co kilka minut.

Czujnik Przyrząd wprowadzany podskórnie w celu zapewnienia ciągłego pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym.

Czujnik glukozy Wartość glukozy uzyskana za pomocą czujnika Eversense.

EULA Licencja dla użytkownika końcowego

Eversense NOW Aplikacja mobilna do zdalnego monitorowania, umożliwiająca udostępnianie danych dotyczących poziomu glukozy innym osobom.

FAQ Najczęściej zadawane pytania

Faza rozgrzewania Okres adaptacyjny czujnika między umieszczeniem pod skórą i skalibrowaniem.

Glukometr Dostępny na rynku przyrząd służący do pomiaru poziomu glukozy przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca.

Hiperglikemia Epizod z wysokim poziomem glukozy.

Hipoglikemia Epizod z niskim poziomem glukozy.

Inteligentny nadajnik Przyrząd wielorazowego użytku noszony na zewnątrz ciała, nad wprowadzonym czujnikiem. Inteligentny nadajnik zasila czujnik i przesyła informacje na temat poziomu glukozy do urządzenia przenośnego w celu wyświetlenia ich w aplikacji Eversense.

Kalibracja Odczyt poziomu glukozy we krwi z próbki krwi pobranej z opuszki palca wprowadzony do aplikacji Eversense w celu sprawdzenia dokładności systemu. Kalibracja systemu Eversense E3 obejmuje dwie fazy: fazę inicjalizacji, podczas której wymagane są 4 pomiary z opuszki palca, oraz fazę codziennej kalibracji, podczas której wymagane jest przeprowadzenie pomiaru z opuszki palca jeden lub dwa razy dziennie.

LED Kontrolka LED

mg/dl Miligramy na decylitr to jednostka miary oznaczająca stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. W niektórych krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mg/dl, wskazując ilość glukozy obecnej we krwi w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów przy użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense E3 CGM.

mmol/l Milimole na litr to jednostka miary, która oznacza stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. W wielu krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mmol/l, wskazując ilość glukozy obecnej we krwi w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów przy użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense E3 CGM.

Naruszone urządzenie Urządzenie (iPhone lub iPod), które zostało zmodyfikowane w celu usunięcia elementów kontrolnych i ograniczeń zainstalowanych przez producenta.

Płyn tkankowy (ISF) Płyn znajdujący się między komórkami organizmu. W systemie Eversense E3 CGM pomiar glukozy jest wykonywany z próbki płynu tkankowego i porównywany z wynikiem pomiaru glukozy z próbki krwi uzyskanej z opuszki palca.

Podskórny Umieszczany pod skórą.

Połączony czujnik Czujnik połączony z inteligentnym nadajnikiem.

Poziom glukozy we krwi Wartość glukozy uzyskana z testu z wykorzystaniem krwi pobranej z opuszki palca.

Pracownik służby zdrowia Wykwalifikowany pracownik służby zdrowia, który pomyślnie ukończył program szkoleniowy poświęcony wszczepianiu i usuwaniu czujnika Eversense E3 CGM oraz przeczytał ze zrozumieniem instrukcję wszczepiania i usuwania czujnika Eversense E3 CGM.

Przeciwwskazanie Stan lub warunki, w których dana osoba nie powinna używać tego przyrządu.

Przyrząd warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego Przyrząd z potwierdzonym poziomem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego w określonych warunkach, w tym w warunkach dotyczących statycznego pola magnetycznego, gradientów pól magnetycznych zróżnicowanych czasowo oraz pól częstotliwości radiowej.

RM Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

Szybkość zmian / strzałki trendów Wskaźniki kierunku i prędkości zmian poziomów glukozy.

System zarządzania danymi (DMS) Eversense Aplikacja internetowa kompatybilna z aplikacją Eversense, w której dane użytkownika dotyczące poziomu glukozy mogą być przechowywane i wyświetlane.

TK Tomografia komputerowa

Tryb „Nie przeszkadzać" (NP w aplikacji Eversense) Po włączeniu aplikacja mobilna przestanie wyświetlać alerty niekrytyczne, a inteligentny nadajnik przestanie przesyłać powiadomienia wibracyjne dotyczące alertów niekrytycznych. Alerty krytyczne będą nadal przesyłane. Wiele urządzeń mobilnych ma własny tryb „Nie przeszkadzać". Więcej informacji można znaleźć w instrukcji producenta.

Urządzenie przenośne Urządzenie ręczne z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługującym aplikację Eversense i komunikujące się z inteligentnym nadajnikiem.

Ustawienie powtarzania Wykorzystywane do ustawienia częstotliwości powtarzania alertów.

Wskazanie „NIS" Oznacza, że wartość poziomu glukozy podana przez czujnik < 40 mg/dl.

Wskazanie „WYS." Oznacza, że wartość poziomu glukozy podana przez czujnik wynosi > 400 mg/dl.

Zakłócenia elektromagnetyczne Mocne pole energii generowane przez urządzenie elektryczne lub magnetyczne.

Zdalne monitorowanie Funkcja dodatkowa umożliwiająca zaproszenie innych osób do przeglądania danych CGM używających Eversense NOW, oddzielnej aplikacji pobranej na zgodne urządzenie przenośne.

I. Wprowadzenie

Rozdział zawiera informacje dotyczące sposobu użytkowania, przeznaczenia oraz elementów składowych systemu Eversense E3 CGM.

Gratulujemy możliwości korzystania z technologii Eversense E3 CGM przeznaczonej do kontrolowania cukrzycy. System Eversense E3 CGM mierzy poziomy glukozy w trybie ciągłym, przez maksymalnie 180 dni od dnia wprowadzenia czujnika. System gromadzi informacje dotyczące poziomu glukozy i przesyła je automatycznie do Twojego urządzenia przenośnego. Należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia terminu wszczepienia i usunięcia czujnika.

Pomoc techniczna

Niniejszą instrukcję użytkownika należy przeanalizować ze swoim dostawcą usług zdrowotnych. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z czujnikiem Eversense E3 prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem infolinii na terenie Stanów Zjednoczonych: 844-SENSE4U (844-736-7348). Użytkownicy przebywający poza granicami Stanów Zjednoczonych powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Lista oraz dane kontaktowe lokalnych dystrybutorów znajdują się na stronie internetowej **https://global.eversensediabetes.com**. Aby uzyskać najnowszą wersję instrukcji użytkownika, należy odwiedzić stronę **https://global.eversensediabetes.com**.

Elementy systemu Eversense E3 CGM

W skład systemu wchodzą elementy: 1) mały czujnik umieszczany przez pracownika służby zdrowia pod skórą w górnej części ramienia, 2) zdejmowany inteligentny nadajnik mocowany nad czujnikiem podskórnym, 3) aplikacja mobilna wyświetlająca wyniki pomiarów glukozy.

Czujnik Eversense E3

Po wprowadzeniu pod skórę (na ramieniu) czujnik mierzy poziom glukozy w płynie tkankowym przez okres do 180 dni. Wartości poziomu glukozy są obliczane przez inteligentny nadajnik i przesyłane do aplikacji.



Czujnik

Inteligentny nadajnik Eversense E3

Zdejmowany inteligentny nadajnik noszony jest przez użytkownika nad czujnikiem i służy do zasilania czujnika. Inteligentny nadajnik bezprzewodowo (przez połączenie Bluetooth) przesyła dane dotyczące stężenia glukozy do aplikacji w urządzeniu przenośnym. Inteligentny nadajnik generuje odczuwalne dla użytkownika alerty wibracyjne, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Inteligentny nadajnik wyposażony jest w baterię, a jego czas eksploatacji wynosi rok.




Inteligentny nadajnik

Aplikacja Eversense

Aplikacja Eversense to oprogramowanie instalowane na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie czy tablecie), wyświetlające na kilka sposobów dane na temat poziomu glukozy. Inteligentny nadajnik generuje odczuwalne dla użytkownika alerty wibracyjne, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Układy ekranów aplikacji Eversense zmieniają się w zależności od modelu i/lub systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera kilka przykładów takich różnic.

Należy się upewnić, że urządzenie przenośne ma zainstalowaną najnowszą wersją systemu operacyjnego, który znajduje się na liście kompatybilnych systemów operacyjnych na naszej stronie internetowej https://global.eversensediabetes.com/compatibility.

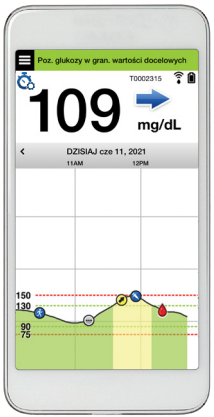

iOS



Android

WAŻNE: Aby korzystać z systemu Eversense E3 CGM, należy umieć pobierać i instalować aplikacje na swoim urządzeniu przenośnym. Dane z inteligentnego nadajnika Eversense E3 są przesyłane bezprzewodowo przez łącze Bluetooth. Należy uważnie przeczytać zalecenia w niniejszej instrukcji użytkownika dotyczące pobierania i instalowania aplikacji mobilnej Eversense oraz parowania urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem. Jeżeli którykolwiek z fragmentów niniejszej instrukcji użytkownika jest niejasny, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

W skład systemu wchodzą przylepce jednorazowego użytku, dostarczane przez pracownika służby zdrowia po wszczepieniu czujnika. Przylepiec z jednej strony przylega do tylnej części inteligentnego nadajnika, zaś druga przylepna warstwa z silikonu przylega do skóry.

Informacje ogólne o systemie Eversense E3

Do skalibrowania systemu CGM oraz do podejmowania decyzji dotyczących leczenia w określonych warunkach wymagany jest odrębny system monitorowania poziomu glukozy we krwi (niedostarczany przez firmę Senseonics). Patrz rozdział *Zrozumienie decyzji o leczeniu podejmowanych za pomocą systemu CGM*.
Komponenty systemu zapewniają ciągłe monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez maksymalnie 180 dni, pod warunkiem prawidłowego użytkowania.

W celu zapewnienia otrzymywania ciągłych odczytów poziomu glukozy i innych informacji należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących codziennego użytkowania systemu:

- ✓ Inteligentny nadajnik należy nosić przy sobie przez cały czas, z wyjątkiem przerwy na ładowanie baterii.
- ✓ Inteligentny nadajnik jest odporny na działanie wody do głębokości 1 m (3,2 stopy), przez 30 minut. Narażenie nadajnika na takie warunki przez dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.
- ✓ Należy się upewnić, że bateria inteligentnego nadajnika jest przez cały czas odpowiednio naładowana.
- ✓ Należy codziennie wykonywać dwa testy kalibracyjne po otrzymaniu przypomnienia.
- ✓ Należy zwracać uwagę na alerty i powiadomienia wysyłane przez inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne.
- ✓ Przylepiec na inteligentnym nadajniku należy wymieniać codziennie.
- ✓ Nadajnik można zdjąć z ramienia w dowolnej chwili, z wyjątkiem momentu kalibracji. Należy pamiętać, że w przypadku braku łączności między czujnikiem i nadajnikiem nie są gromadzone żadne dane. Po ponownym przymocowaniu nadajnika nad czujnikiem należy odczekać do 10 minut do momentu ponownego nawiązania połączenia i pojawienia się odczytów poziomu glukozy w aplikacji.

✓ Jeżeli inteligentny nadajnik jest poza zasięgiem urządzenia przenośnego, dane zgromadzone przez inteligentny nadajnik są zapisywane i przesyłane do aplikacji po ponownym znalezieniu się urządzenia przenośnego w zasięgu nadajnika.

✓ Czujnik i inteligentny nadajnik można bezpiecznie przenosić przez bramki wykrywacza metali na lotnisku. W czasie lotu inteligentny nadajnik zachowuje się tak, jak wszystkie inne urządzenia Bluetooth. Należy się zawsze stosować do zaleceń bezpieczeństwa określonych przez linię lotniczą.

Poniżej wymieniono niektóre z funkcji systemu Eversense E3 CGM:

- Bezprzewodowa komunikacja z czujnikiem, inteligentnym nadajnikiem i aplikacją.
- Czas działania czujnika wszczepionego w górną część ramienia wynosi maksymalnie 180 dni.
- Generowanie alertów po osiągnięciu skonfigurowanych poziomów niskiego i wysokiego poziomu glukozy (hipoglikemii i hiperglikemii).
- Generowanie alertów przewidywania mających na celu ostrzeżenie pacjenta ***przed*** zbliżającymi się alertami niskiego lub wysokiego poziomu glukozy.
- Wyświetlanie odczytów wartości poziomu glukozy na wyświetlaczu urządzenia przenośnego (np. smartfona).
- Alerty wibracyjne odczuwane na ciele użytkownika i generowane przez inteligentny nadajnik nawet w przypadku, gdy urządzenie przenośne nie znajduje się w pobliżu.
- Odczyty w zakresie 40–400 mg/dl, podawane co 5 minut.
- Strzałki trendów informujące o wzroście lub spadku poziomu glukozy oraz o szybkości zachodzących zmian.
- Wykresy i dane statystyczne przedstawiające wyniki pomiarów poziomu glukozy w łatwych do odczytu formatach.
- Wymienny inteligentny nadajnik z możliwością wielokrotnego ładowania.
- Możliwość wprowadzania zdarzeń (np. posiłków, ćwiczeń i podawanej insuliny).
- Zapisywanie danych dotyczących poziomu glukozy w aplikacji i inteligentnym nadajniku.
- Zapewnia możliwość zdalnego monitorowania danych innym osobom używającym aplikacji mobilnej Eversense NOW.

Wymagania systemowe

- System Eversense E3 CGM.
- Zgodny smartfon z systemem Android bądź Apple iPhone®, iPod® lub iPad® wyposażony w funkcję Bluetooth Smart (lub Bluetooth Low Energy). Aplikacja Eversense działa też na urządzeniu Apple Watch®.
- Wykaz zgodnych urządzeń i systemów operacyjnych zamieszczono na stronie **https://global.eversensediabetes.com/compatibility**.
- Aplikację Eversense można pobrać na urządzenie przenośne ze sklepu Apple App Store lub Google Play™.

Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności

Użytkowanie systemu Eversense podlega warunkom najnowszej licencji dla użytkownika końcowego i polityki prywatności firmy Eversense. Dokumenty te są okresowo aktualizowane i publikowane na stronie **https://global.eversensediabetes.com**.

Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu

NIE WOLNO używać aplikacji Eversense na urządzeniach iPhone lub iPod poddanych nieautoryzowanym modyfikacjom systemu. Urządzenia, które poddano nieautoryzowanym modyfikacjom systemu, nie zapewniają użytkownikowi wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, w związku z czym nie zostały zatwierdzone przez firmę Senseonics.

Uszkodzony ekran lub przycisk

Jeśli ekran urządzenia przenośnego jest uszkodzony lub przyciski nie działają, użytkownik może nie być w stanie korzystać z systemu Eversense E3, w związku z czym stan hiperglikemii lub hipoglikemii może zostać niezauważony.

Modyfikacje urządzenia

NIE WOLNO modyfikować systemu Eversense E3 CGM pod kątem użytkowania z produktami, akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi, które nie zostały dostarczone ani zatwierdzone na piśmie przez firmę Senseonics. Nieautoryzowane modyfikacje spowodują unieważnienie gwarancji nadajnika i mogą negatywnie wpłynąć na działanie systemu.

Wskazania do stosowania

System Eversense E3 CGM służy do ciągłego pomiaru poziomu glukozy u dorosłych osób chorych na cukrzycę (w wieku co najmniej 18 lat) przez okres do 180 dni. System jest używany, aby zastąpić pomiary glukozy z użyciem próbki krwi z opuszki palca w celu podejmowania decyzji o leczeniu cukrzycy.

System przeznaczony jest do:

- podawania odczytów wartości poziomu glukozy w czasie rzeczywistym,
- dostarczania informacji o trendzie poziomu glikozy,
- generowania alertów ostrzegających o wykryciu lub przewidywaniu epizodów hipoglikemii (niskiego stężenia glukozy) i hiperglikemii (wysokiego stężenia glukozy),
- wspomagania kontrolowania cukrzycy.

Interpretacja danych historycznych z systemu ułatwia wprowadzanie zmian w leczeniu. Zmiany te powinny opierać się na wzorcach i trendach obserwowanych w czasie. System jest przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI

U pacjenta z tym urządzeniem można bezpiecznie wykonać skanowanie w poziomym skanerze MR z systemem zamkniętym, spełniającym następujące warunki:

- Statyczne pole magnetyczne 1,5 T lub 3,0 T.
- Maksymalny przestrzenny gradient pola 1900 gausów/cm (≤ 19 T/m).
- Maksymalny zgłaszany dla systemu MR, uśredniony współczynnik absorpcji swoistej (SAR) dla całego ciała wynoszący 4 W/kg (kontrolowany tryb pracy pierwszego poziomu) przez 15 minut ciągłego skanowania lub SAR wynoszący 2 W/kg przez 30 minut ciągłego skanowania.

W warunkach skanowania zdefiniowanych powyżej wyniki badań nieklinicznych wskazują, że czujnik Eversense E3 może spowodować maksymalny wzrost temperatury o mniej niż 5,4°C.

W badaniach nieklinicznych artefakt obrazu spowodowany przez urządzenie ma zasięg około 72 mm (2,83 cala) od czujnika Eversense E3, gdy jest obrazowany sekwencją impulsów echa gradientowego i systemem MR 3T.

Czujnik Eversense E3 nie był testowany w systemach MR, które nie spełniają powyższych warunków. Narażenie czujnika Eversense E3 na warunki MRI, które nie mieszczą się w warunkach opisanych powyżej, może spowodować potencjalne powikłania, takie jak migracja urządzenia, ogrzanie i uszkodzenie tkanki lub erozja przez skórę.

Inteligentny nadajnik Eversense E3 nie jest bezpieczny dla rezonansu magnetycznego i NALEŻY GO WYJĄĆ przed poddaniem się procedurze rezonansu magnetycznego. Zanim pacjent podda się badaniu MRI powinien poinformować personel MRI, że ma wszczepiony czujnik Eversense E3 i nosi inteligentny nadajnik, oraz skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, który wszczepił czujnik.

Najnowszą wersję etykiet systemu Eversense E3 CGM można znaleźć na stronie **https://global.eversensediabetes.com**. Po każdym wszczepieniu czujnika pacjent otrzyma międzynarodową kartę implantu od pracownika służby zdrowia. Kartę należy nosić w portfelu w celach informacyjnych.

Przeciwwskazania

System jest przeciwwskazany u osób, u których stosowanie deksametazonu lub octanu deksametazonu jest przeciwwskazane.

Inteligentny nadajnik jest niekompatybilny z badaniami rezonansem magnetycznym (MRI). Pacjenci noszący inteligentny nadajnik nie powinni poddawać się badaniu rezonansem magnetycznym. Aby uzyskać informacje na temat czujnika, patrz punkt *Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI*.

Mannitol lub sorbitol, podawane dożylnie lub jako składnik roztworu do irygacji lub dializy otrzewnowej, mogą podwyższać stężenie mannitolu lub sorbitolu we krwi i powodować fałszywie podwyższone odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik. Sorbitol jest stosowany w niektórych sztucznych słodzikach, ale poziom jego stężenia we krwi na skutek spożycia w ramach typowej diety nie wpływa na odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik.

Wartość opakowania

Zestaw inteligentnego nadajnika Eversense E3 zawiera poniższe elementy:



Inteligentny nadajnik Eversense E3



Stacja dokująca



Zasilacz
(Zestaw inteligentnego czujnika zawiera wtyczkę odpowiednią do użytkowania w lokalnym obszarze).

Opakowanie zawiera także niniejszą *instrukcję użytkownika* i *skróconą instrukcję obsługi*.

Korzystanie z instrukcji użytkownika

Instrukcja opisuje sposób korzystania z systemu CGM. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Wszelkie **ostrzeżenia** i **przestrogi** zostały wyszczególnione w ramkach.
- Porady dla użytkownika poprzedzone zostały symbolem ✓.

2. Korzyści i zagrożenia

Rozdział zawiera opis korzyści, oczekiwań i zagrożeń związanych z użytkowaniem systemu Eversense E3 CGM. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/eudamed (europejska baza danych wyrobów medycznych – EUDAMED) w dokumencie „Podsumowanie bezpieczeństwa i działania (SSCP) systemu Eversense E3 CGM" lub na prośbę złożoną do działu obsługi klienta. Dokument SSCP jest powiązany z numerami podstawowego UDI-DI systemu Eversense E3 CGM, które są wymienione z tyłu okładki instrukcji obsługi.

Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy pomaga w leczeniu cukrzycy i kontrolowaniu poziomu glukozy, co wpływa na poprawę jakości życia pacjenta. Najlepsze rezultaty osiąga się po uzyskaniu pełnych informacji na temat zagrożeń i korzyści, procedury wszczepiania, wymagań kontrolnych i obowiązków pacjenta. Nie należy wszczepiać czujnika bez dogłębnej znajomości obsługi systemu CGM.

System CGM dokonuje pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym (ISF) wypełniającym przestrzeń pomiędzy komórkami ciała. Fizjologiczne różnice pomiędzy ISF i krwią pobraną z opuszki mogą być powodem różnic w pomiarach glukozy. Różnice te są szczególnie widoczne w okresach gwałtownych zmian stężenia glukozy we krwi (np. po jedzeniu, podaniu insuliny lub ćwiczeniach) oraz u niektórych osób w ciągu pierwszych kilku dni po wszczepieniu, z powodu stanu zapalnego, który może wynikać z zabiegu wszczepienia. Wartości poziomu glukozy w płynie ISF zmieniają się z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wartości poziomu glukozy we krwi.

WAŻNE: Jeśli objawy nie są zgodne z alertami i odczytami glukozy z systemu Eversense E3 CGM, przed podjęciem decyzji związanych z leczeniem należy wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca.

Korzystanie z systemu Eversense E3 CGM w sposób niezgodny z instrukcją obsługi może skutkować przeoczeniem wystąpienia hipoglikemii i hiperglikemii, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

Czujnik wyposażony jest w silikonowy pierścień z niewielką ilością leku steroidowego o działaniu przeciwzapalnym (octan deksametazonu). Nie ustalono, czy zagrożenia związane z octanem deksametazonu podanym we wstrzyknięciu dotyczą octanu deksametazonu uwalnianego z pierścienia w czujniku. Pierścień uwalnia niewielkie ilości octanu deksametazonu po kontakcie czujnika z płynami ustrojowymi. Lek służy do łagodzenia odpowiedzi zapalnej organizmu na wprowadzony podskórnie czujnik. Octan deksametazonu w pierścieniu może też powodować inne działania niepożądane, których nie zaobserwowano po podaniu leku we wstrzyknięciu. Wykaz potencjalnie szkodliwych skutków związanych z octanem deksametazonu można uzyskać od lekarza.

Nieuprawnione modyfikowanie urządzeń, uzyskiwanie niewłaściwego dostępu do informacji w urządzeniu lub poddanie urządzenia mobilnego nieautoryzowanym modyfikacjom systemu oraz wykonywanie innych nieuprawnionych czynności może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu CGM i stwarzać zagrożenie dla jego użytkownika. Nieuprawnione modyfikowanie urządzeń nie jest dozwolone i skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z użytkowaniem urządzenia, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi w państwie członkowskim.

Zagrożenia i działania niepożądane

Alerty i powiadomienia dotyczące poziomu glukozy nie będą emitowane, jeżeli dźwięk w urządzeniu mobilnym pacjenta będzie wyłączony. Jeżeli system nie może wyświetlić wartości glukozy, nie może również wygenerować alertów poziomu glukozy. Jeżeli pacjent nie może wyczuć wibracji inteligentnego nadajnika, może nie zauważyć generowanych alertów. Pacjent może wymagać pomocy medycznej, gdy nie jest świadomy wystąpienia u siebie zdarzenia hiperglikemii lub hipoglikemii. Wartości poziomu glukozy obliczane przez system mogą nieco odbiegać od wartości podawanych przez glukometr. Może to powodować aktywację alertu w innym czasie niż w przypadku, gdyby wartości podawane przez system zawsze odpowiadały wartościom podawanym przez glukometr.

WAŻNE: Jeżeli pacjent nie sprawdza wartości stężenia glukozy za pomocą glukometru, gdy objawy nie odpowiadają odczytom czujnika glukozy, stan hiperglikemii lub hipoglikemii może zostać niezauważony.

Decyzje o leczeniu powinny być podejmowane na podstawie oceny następujących czynników: wartość stężenia glukozy z czujnika, strzałka trendu, wykres najnowszego trendu poziomu glukozy i alerty/powiadomienia systemu. Pacjent nie powinien podejmować decyzji związanych z leczeniem, jeśli nie wziął pod uwagę tych wszystkich informacji. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w zakresie działania insuliny, aby zrozumieć, jaki wpływ wywiera na poziom glukozy i decyzje związane z leczeniem.

Wszczepienie czujnika polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia i umieszczeniu urządzenia pod skórą. Wszczepienie może powodować zakażenie, ból, podrażnienie skóry, zasinienie, odbarwienie lub atrofię skóry. Zawroty głowy, omdlenia i nudności były zgłaszane w niewielkiej liczbie przypadków podczas badań klinicznych, podobnie jak przypadki uszkodzenia czujnika lub nieusunięcia go przy pierwszej próbie. Ponadto przylepiec może wywołać reakcję skórną lub podrażnienie skóry. Wszelkie problemy medyczne związane z procedurą lub użytkowaniem urządzenia należy zgłaszać swojemu lekarzowi. Pod koniec okresu użytkowania czujnika konieczna będzie dodatkowa procedura jego usunięcia.

Ostrzeżenia

- System Eversense E3 CGM nie był testowany w miejscach wszczepienia innych niż ramię.
- Jeżeli objawy pacjenta nie odpowiadają odczytom czujnika glukozy, pacjent powinien zbadać poziom glukozy za pomocą glukometru.
- Przed podjęciem decyzji o leczeniu pacjent powinien wziąć pod uwagę wartość stężenia glukozy z czujnika, wykres trendu, strzałkę trendu i wszelkie alerty z systemu Eversense E3 CGM. Jeśli strzałka trendu nie jest wyświetlana, system nie ma wystarczającej ilości danych, aby wyświetlić kierunek i szybkość zmian. Nie wolno podejmować decyzji o leczeniu wyłącznie na podstawie wartości poziomu glukozy z czujnika.
- NIE NALEŻY używać uszkodzonego lub pękniętego inteligentnego nadajnika, ponieważ mogłoby to stworzyć niebezpieczeństwo elektryczne lub awarię oraz doprowadzić do porażenia prądem.
- Bliski kontakt z bezpośrednim źródłem zakłóceń elektromagnetycznych może wpływać na możliwość przesyłania danych z nadajnika do urządzenia mobilnego. Należy odsunąć się od źródła zakłóceń elektromagnetycznych i sprawdzić, czy urządzenie mobilne jest połączone z inteligentnym nadajnikiem.
- Antybiotyki z klasy tetracyklin mogą fałszywie zaniżać odczyty czujnika glukozy podawane przez czujnik. W przypadku przyjmowania tetracyklin pacjent nie powinien polegać wyłącznie na odczytach czujnika glukozy.
- W ramach odpowiedniego standardu opieki opatrunek powinien zakrywać nacięcie przez 48 godzin, ponieważ konieczne jest umożliwienie utworzenia wodoszczelnego uszczelnienia w celu ochrony przed zakażeniem. Przed przyklejeniem inteligentnego nadajnika nad czujnikiem miejsce nacięcia należy zawsze osłaniać jałowym bandażem aż do momentu wygojenia rany. W przeciwnym razie może dojść do zakażenia w miejscu nacięcia.

Ostrzeżenia (cd.)

- Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika wraz z dostawcą usług zdrowotnych. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z czujnikiem Eversense E3 prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem infolinii na terenie Stanów Zjednoczonych: 844-SENSE4U (844-736-7348). Użytkownicy przebywający poza granicami Stanów Zjednoczonych powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Lista oraz dane kontaktowe lokalnych dystrybutorów znajdują się na stronie internetowej **https://global.eversensediabetes.com**.
- System należy zawsze kalibrować wyłącznie z użyciem próbki krwi pobranej z opuszki palca. NIE NALEŻY stosować odczytu poziomu glukozy z krwi pobranej z innych miejsc (np. z przedramienia lub dłoni) do kalibracji systemu.
- NIE NALEŻY wprowadzać zestawu infuzyjnego ani wstrzykiwać insuliny w promieniu 10,16 cm (4 cale) od miejsca wszczepienia czujnika. Jeżeli miejsce podawania insuliny znajduje się w promieniu 10,16 cm (4 cale) od miejsca wszczepienia czujnika, może dochodzić do zakłócenia odczytów czujnika oraz niedokładnych odczytów.
- Należy zawsze przestrzegać wytycznych pracowników służby zdrowia dotyczących pielęgnacji po wszczepieniu lub usunięciu czujnika. W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji należy skontaktować się ze swoim lekarzem:
  - Ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wszczepienia czujnika występujący po 5 dniach od zabiegu lub jego usunięcia nie ustąpiły w ciągu 5–7 dni.
- Jeśli stężenie glukozy z czujnika jest bardzo niskie (poniżej 40 mg/dl) lub bardzo wysokie (powyżej 400 mg/dl), przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem pacjent powinien wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca.
- System Eversense E3 CGM wymaga kalibracji w celu zagwarantowania dokładnych odczytów. Jeśli pacjent nie przestrzegał instrukcji dotyczących codziennej kalibracji, nie powinien wykorzystywać odczytów z systemu CGM do podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Ostrzeżenia (cd.)

- System Eversense E3 CGM nie zapewnia odczytów podczas 24-godzinnej fazy rozgrzewania ani podczas fazy inicjalizacji do momentu pomyślnego zakończenia drugiej kalibracji. W tym okresie pacjent powinien monitorować stężenie glukozy za pomocą urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi.
- Niektóre warunki i alerty uniemożliwiają wyświetlenie danych dotyczących poziomu glukozy. W tym okresie pacjent powinien używać urządzenia do pomiaru poziomu glukozy we krwi, aby podejmować decyzje związane z leczeniem. Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z rozdziałem *Alerty i powiadomienia* w *instrukcji użytkownika systemu Eversense E3 CGM*, aby zrozumieć te sytuacje.
- Alerty i powiadomienia dotyczące poziomu glukozy nie będą emitowane, jeżeli dźwięk w urządzeniu mobilnym pacjenta będzie wyłączony. Jeżeli system nie może wyświetlić wartości glukozy, nie może również wygenerować alertów poziomu glukozy. Jeżeli pacjent nie może wyczuć wibracji inteligentnego nadajnika, może nie zauważyć generowanych alertów.
- Gdy inteligentny nadajnik nie jest noszony nad czujnikiem, na przykład podczas ładowania, system Eversense E3 CGM nie będzie przesyłał alertów ani powiadomień na urządzenie mobilne ani alertów wibracyjnych z inteligentnego nadajnika.
- Jeśli użytkownik jest uczulony na którykolwiek z wymienionych w danych technicznych w tej instrukcji obsługi materiałów użytych w czujniku lub inteligentnym nadajniku, systemu CGM Eversense NIE WOLNO używać.

Przestrogi

- Użytkownik NIE powinien wymieniać inteligentnych nadajników z innymi osobami. Każdy inteligentny nadajnik można jednocześnie połączyć tylko z jednym czujnikiem. System jest przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę w środowisku domowym.
- Wymienione niżej metody leczenia i zabiegi mogą powodować trwałe uszkodzenie czujnika, zwłaszcza jeżeli są stosowane w pobliżu urządzenia:
  - **Litotrypsja –** zabieg ten nie jest zalecany u pacjentów z wszczepionym czujnikiem, ponieważ wpływ litotrypsji na urządzenie jest nieznany.
  - **Diatermia –** NIE NALEŻY stosować diatermii u pacjentów z wszczepionym czujnikiem. Energia generowana podczas diatermii może przenikać przez czujnik i uszkadzać tkankę w miejscu wprowadzenia czujnika.
  - **Elektrokoagulacja –** elektrokoagulacja wykonywana w pobliżu miejsca wszczepienia czujnika może uszkodzić urządzenie. NIE należy stosować elektrokoagulacji w pobliżu czujnika.
- Stosowanie leków steroidowych – nie ustalono, czy zagrożenia wiążące się zwykle z octanem deksametazonu podanym w iniekcji dotyczą również octanu deksametazonu uwalnianego z pierścienia, który w sposób kontrolowany i punktowo uwalnia lek. Pierścień z octanem deksametazonu może powodować inne, niewymienione lub wcześniej nieobserwowane działania niepożądane.
- NIE NALEŻY nosić inteligentnego nadajnika podczas badań RTG (rentgen) lub TK (tomografia komputerowa). Aby uniknąć zniekształceń na obrazach, należy zdjąć inteligentny nadajnik przed poddaniem się badaniu RTG lub TK. Należy poinformować lekarza o inteligentnym nadajniku.
- Czujnik i inteligentny nadajnik powinny zostać połączone w dniu wszczepienia. Niewykonanie tej czynności może opóźnić odbiór odczytów poziomu glukozy.
- Jeżeli czujnik, miejsce wszczepienia lub inteligentny nadajnik są ciepłe, pacjent powinien natychmiast zdjąć inteligentny nadajnik i skonsultować się z lekarzem. Ciepły czujnik może oznaczać zakażenie lub awarię urządzenia.

Przestrogi (cd.)

- NIE NALEŻY używać aplikacji Eversense podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
- Nie należy poddawać się masażom w pobliżu miejsca umieszczenia czujnika. Masaż wykonywany w okolicy czujnika może powodować dyskomfort lub podrażnienie skóry.
- Do ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB, które dostarczono wraz z inteligentnym nadajnikiem. Korzystanie z innego zasilacza może uszkodzić inteligentny nadajnik, co może uniemożliwić poprawny odbiór odczytów poziomu glukozy, stworzyć ryzyko pożaru oraz skutkować unieważnieniem gwarancji. Jeśli zasilacz sieciowy Eversense lub kabel USB są uszkodzone bądź zostały zgubione, należy się skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
- W przypadku obaw dotyczących reakcji alergicznej na plastry zawierające silikon, przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem. Plaster Eversense należy usunąć po każdym użyciu trwającym maksymalnie 24 godziny.
- NIE WOLNO zmieniać jednostki miary bez konsultacji z lekarzem. Użycie nieprawidłowej jednostki miary może skutkować niezauważeniem stanu hiperglikemii lub hipoglikemii.
- Wprowadzenie nieprawidłowych wartości poziomu glukozy we krwi na potrzeby kalibracji może skutkować niedokładnymi odczytami czujnika glukozy, co może spowodować, że stan hiperglikemii lub hipoglikemii nie zostanie zauważony przez użytkownika.
- Pacjent powinien przestrzegać zalecenia lekarza dotyczącego ustawiania alertów poziomu glukozy. Nieprawidłowe ustawienie alertów poziomu glukozy może spowodować, że stan hiperglikemii lub hipoglikemii nie zostanie zauważony przez użytkownika.
- Pacjent powinien zwracać szczególną uwagę na alerty poziomu glukozy generowane przez system. Nieprawidłowa reakcja na alert może spowodować, że stan hiperglikemii lub hipoglikemii nie zostanie zauważony przez użytkownika.

Przestrogi (cd.)

- **Aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastępuje schematu monitorowania zalecanego przez lekarza.**
- **Nie prowadzono badań dotyczących stosowania systemu Eversense E3 CGM w następujących populacjach pacjentów: kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, osób w wieku poniżej 18 lat, pacjentów w stanie krytycznym lub hospitalizowanych, osób poddawanych leczeniu z zastosowaniem leków immunosupresyjnych, chemioterapii lub leczeniu z zastosowaniem antykoagulantów, osób, u których zastosowano inny aktywny, wszczepialny wyrób medyczny, na przykład defibrylator serca (dozwolone są implanty pasywne, np. stenty kardiologiczne), pacjentów z rozpoznaną alergią na glikokortykosteroidy stosowane ogólnie lub poddawanych leczeniu z ich zastosowaniem (nie dotyczy to leków stosowanych miejscowo, doocznie lub donosowo, ale dotyczy leków wziewnych). Dokładność systemu nie została przetestowana u tych populacji, a odczyty czujnika glukozy mogą być niedokładne, co może spowodować, że stan hiperglikemii lub hipoglikemii nie zostanie zauważony.**
- **Urządzenie Apple Watch jest dodatkowym ekranem do wyświetlania danych z systemu Eversense E3 CGM i nie należy używać go zamiast ekranu głównego systemu Eversense E3 CGM.**

3. Rozpoczynanie pracy

Rozdział opisuje czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do codziennego użytkowania systemu Eversense E3 CGM. Czynności te może wykonać pracownik służby zdrowia przed wszczepieniem czujnika.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, potrzebne jest:

- urządzenie przenośne do pobrania aplikacji Eversense,
- bezprzewodowe połączenie z Internetem,
- zestaw inteligentnego nadajnika Eversense E3, zawierający inteligentny nadajnik oraz zasilacz.

Uwaga: W przypadku nieotrzymania zestawu inteligentnego nadajnika należy pominąć instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Eversense na urządzeniu przenośnym.

Czynności te można wykonać przed wszczepieniem czujnika, aby zapoznać się zawczasu z systemem.

2 proste kroki uruchomienia:

1. Pobierz aplikację Eversense na urządzenie przenośne.
2. Skonfiguruj aplikację – funkcje Utwórz konto, Parowanie i Ustawienia.

Po otrzymaniu inteligentnego nadajnika i przed sparowaniem go z urządzeniem przenośnym należy całkowicie go naładować.

Uwaga: Na czas transportu inteligentny nadajnik został ustawiony w tryb uśpienia. Podczas pierwszego ładowania baterii inteligentnego nadajnika tryb pracy zmienia się na aktywny.


Inteligentny nadajnik jest objęty 12-miesięczną gwarancją. System wygeneruje alert, gdy 365-dniowa gwarancja nadajnika dobiegnie końca.

Ładowanie baterii inteligentnego nadajnika


Ważne jest, aby codziennie ładować baterię w celu zagwarantowania zbierania danych i wysyłania ich do aplikacji. Podczas ładowania baterii inteligentny nadajnik nie gromadzi informacji z czujnika i nie wysyła ich do aplikacji. Baterię nadajnika można również ładować, podłączając kabel USB do gniazda USB komputera, zamiast do zasilacza prądu zmiennego. Naładowanie baterii nadajnika w ten sposób może potrwać dłużej.

Przestroga: do ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB, które dostarczono wraz z inteligentnym nadajnikiem. Korzystanie z innego zasilacza może uszkodzić inteligentny nadajnik, co może uniemożliwić poprawny odbiór odczytów poziomu glukozy, stworzyć ryzyko pożaru oraz skutkować unieważnieniem gwarancji. Jeśli zasilacz sieciowy Eversense lub kabel USB są uszkodzone bądź zostały zgubione, należy się skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

1. **Podłącz standardową końcówkę kabla USB do adaptera w porcie USB.**




2. **Podłącz końcówkę micro USB kabla do stacji dokującej w porcie USB.**




3. Cztery złote styki na spodzie inteligentnego nadajnika muszą pokrywać się z czterema złotymi stykami na stacji dokującej.

- Wsuń inteligentny nadajnik do stacji dokującej.
- Po wsunięciu naciśnij nadajnik tak, aby zablokował się na miejscu.



4. Podłącz zasilacz do gniazda ściennego AC.

- Po pełnym naładowaniu mała zielona kontrolka LED zaświeci się z przodu inteligentnego nadajnika na górze (powyżej przycisku zasilania).
- Po pełnym naładowaniu odłącz zasilacz od inteligentnego nadajnika.
- Aby zwolnić inteligentny nadajnik ze stacji dokującej, pociągnij wypustkę i podnieś inteligentny nadajnik ze stacji dokującej.

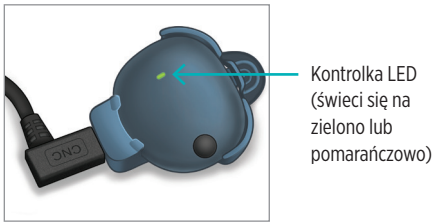

Krok I. Pobranie i zainstalowanie aplikacji

Aplikacja została opracowana tak, aby umożliwiała współpracę z inteligentnym nadajnikiem i odbieranie oraz wyświetlanie danych z czujnika glukozy.

1. **Wybierz urządzenie przenośne do wyświetlania poziomów glukozy. W większości przypadków będzie to smartfon.**



2. **Pobierz darmową aplikację ze sklepu Apple App Store lub Google Play.**


   Instrukcje instalacji będą różne dla systemów iOS i Android.

Ikona aplikacji Eversense

Uwaga: Należy się upewnić, że urządzenie przenośne używa najnowszej wersji systemu operacyjnego zgodnej z aplikacją Eversense.

3. **Na ekranie instalacji dotknij opcji Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.**

   Po upływie 1–2 minut sprawdź, czy ikona aplikacji Eversense (po lewej) pojawiła się na ekranie urządzenia przenośnego.



Uwaga: Należy się upewnić, że zezwolono na przesyłanie powiadomień z aplikacji Eversense, aby otrzymywać alerty i powiadomienia na urządzenie przenośne.


WAŻNE: Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji bezprzewodowe połączenie z Internetem, że data i godzina w urządzeniu przenośnym są prawidłowo ustawione oraz że funkcja Bluetooth jest włączona.

Krok 2. Skonfigurowanie aplikacji – Utworzenie konta,Parowanie i Ustawienia


Po pobraniu aplikacji na urządzenie przenośne należy połączyć ją z inteligentnym nadajnikiem przez sparowanie.

1. **Uruchom aplikację, dotykając ikony aplikacji Eversense w urządzeniu przenośnym. Zostanie wyświetlona pełna wersja LICENCJI DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.**
   - Zapoznaj się z nią i dotknij opcji **Akceptuj**.






2. **Po zaakceptowaniu umowy można utworzyć i zarejestrować konto, wprowadzając adres e-mail i hasło.**
   - Aby się zalogować, należy najpierw zarejestrować konto. Dotknij opcji **Utwórz konto**.

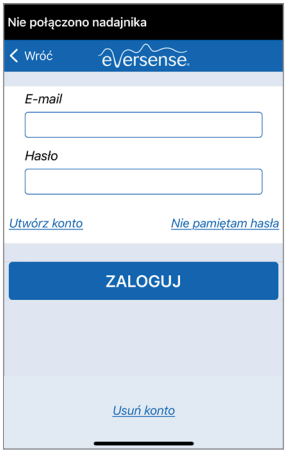


Uwaga: Jeśli masz już konto i nie pamiętasz hasła, możesz je zresetować z poziomu aplikacji. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail powiązanego z kontem, przejdź do obszaru **Menu główne** > **Informacje** > **Moje konto**.

3. **Wpisz informacje o koncie, a następnie wybierz opcję Zatwierdź.**
   - Dotknij opcji **Gotowe**, aby powrócić do ekranu LOGOWANIE Eversense.

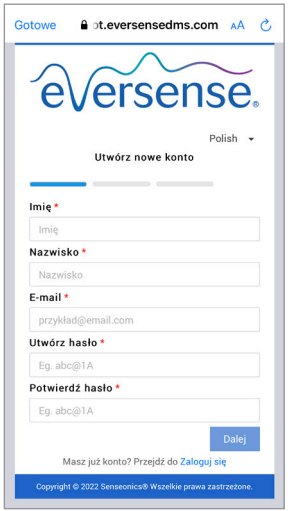


4. **Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji ZALOGUJ SIĘ. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz przycisk OK.**

   Uwaga: Ekran logowania rozróżnia wielkie i małe litery.



5. **Po zakończeniu rejestracji i zalogowaniu wyświetli się ekran WITAJ.**

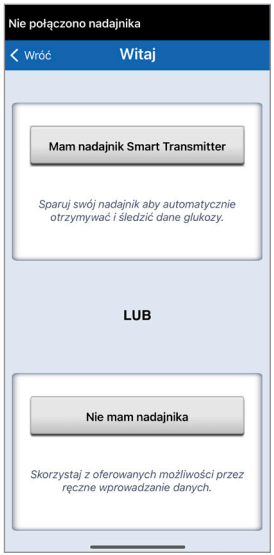

6. **Wybierz jedną z dwóch opcji, w zależności od tego, czy masz już do dyspozycji inteligentny nadajnik, czy nie:**

   Mam nadajnik Smart Transmitter


   lub

   Nie mam nadajnika

   (przejdź do kroku 12).

Użytkownicy systemu Android muszą włączyć usługi lokalizacji.

- Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić, że wymagany jest dostęp do usług lokalizacji na połączenie Bluetooth.



- Następnie wybierz opcję **Zezwalaj**, aby upewnić się, że otrzymasz alerty, gdy aplikacja jest używana lub działa w tle.



Uwaga: System operacyjny Android 12 i nowsze mogą wyświetlać okno podręczne z innym żądaniem pozwolenia.




7. **Gdy w urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlony ekran SPARUJ SWÓJ NADAJNIK przy włączonym inteligentnym nadajniku, ustaw inteligentny nadajnik w trybie „Widoczny”, aby umożliwić urządzeniu przenośnemu wykrycie nadajnika:**
   - Trzykrotnie naciśnij przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika. Upewnij się, że inteligentny nadajnik nie jest podłączony do zasilacza.
   - Kontrolka LED będzie migać na zielono i pomarańczowo, co oznacza, że inteligentny nadajnik pracuje w trybie „Widoczny”.




Uwaga: Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania na inteligentnym nadajniku nie zapali się kontrolka LED, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, aby uruchomić nadajnik.

8. **Na ekranie SPARUJ SWÓJ NADAJNIK identyfikator inteligentnego nadajnika, który został wykryty przez aplikację, jest oznaczony jako „Nie połączono”. (Identyfikator inteligentnego nadajnika jest identyczny z numerem seryjnym na tylnej ściance inteligentnego nadajnika).**
   - Dotknij pozycji **Nie połączono**, aby rozpocząć proces parowania.

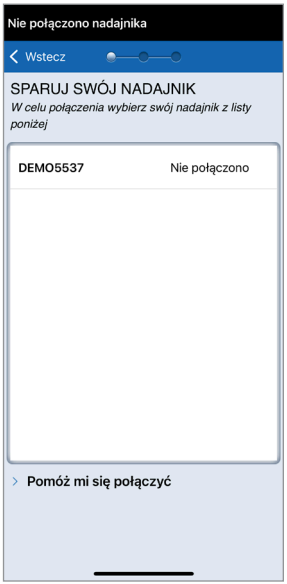


9. **Wyświetli się wyskakujący ekran ŻĄDANIE PAROWANIA BLUETOOTH.**
   - Dotknij opcji **Połącz**, aby dokończyć proces parowania.


Uwaga: Inteligentny nadajnik można sparować tylko z jednym urządzeniem na raz.



10. **Po zakończeniu parowania aplikacja wyświetli komunikat „Połączono” obok identyfikatora inteligentnego nadajnika. Inteligentny nadajnik będzie emitował przerywane wibracje do czasu połączenia inteligentnego nadajnika z wszczepionym czujnikiem (patrz rozdział *Wszczepianie i łączenie czujnika*).**
    - Dotknij opcji **Dalej**.

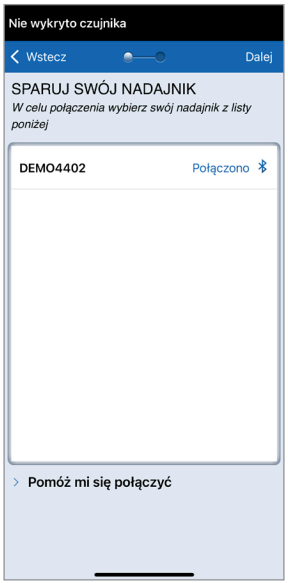


11. **Wyświetli się ekran JEDNOSTKA MIARY ze standardową jednostką miary dla danego regionu. Wartości pomiaru glukozy będą wyświetlane w ustawionych jednostkach miary.**
    - Po potwierdzeniu jednostki miary dotknij opcji **Koniec**.

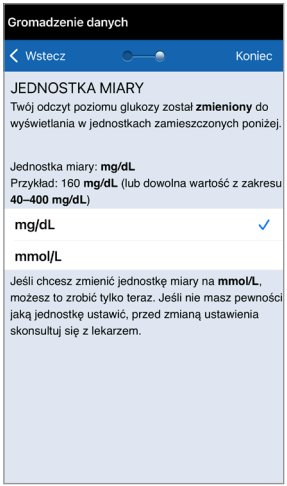



Przestroga: NIE WOLNO zmieniać jednostki miary bez konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

12. Zapoznaj się z ekranami z ogólnymi informacjami dotyczącymi podejmowania decyzji o leczeniu z wykorzystaniem systemu Eversense E3 CGM.



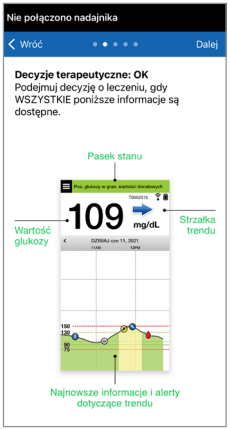


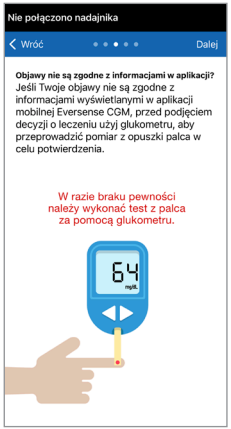

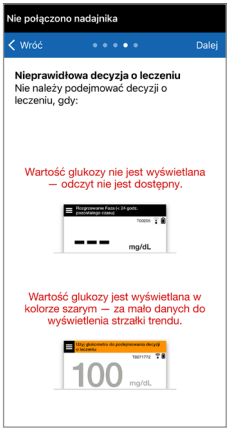



13. **Następnie wyświetli się ekran MOJA GLUKOZA. W tym momencie ekran nie będzie zawierał żadnych danych do wyświetlenia.**

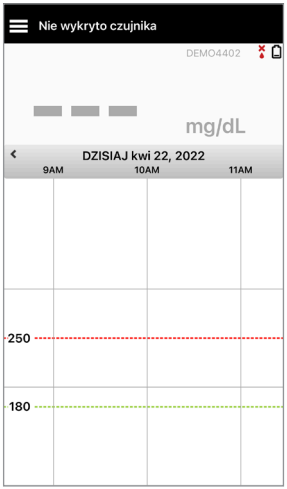

Po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia oraz po zakończeniu 24-godzinnej fazy rozgrzewania można przystąpić do kalibracji. Nawet jeśli czujnik nie jest wprowadzony, należy przejrzeć niniejszą instrukcję użytkownika w celu zapoznania się z aplikacją i jej funkcjami.

Ikony połączenia z inteligentnym nadajnikiem

	Gdy ikona to szara kropla krwi ze znakiem X, inteligentny nadajnik nie jest wykrywany. Ikona ta będzie widoczna przed sparowaniem inteligentnego nadajnika z aplikacją mobilną oraz za każdym razem, gdy połączenie BLE między inteligentnym nadajnikiem i aplikacją mobilną zostanie przerwane.
	Gdy ikona to czerwona kropla krwi ze znakiem X, czujnik nie jest wykrywany. Ikona ta będzie widoczna przed połączeniem czujnika z nadajnikiem oraz za każdym razem, gdy połączony czujnik nie będzie wykrywany przez nadajnik.
   	Gdy ikona to szara lub czarna kropla krwi z paskami na górze, połączenie NFC między czujnikiem i inteligentnym nadajnikiem zostało nawiązane. Paski wskazują siłę sygnału połączenia. Informacje o sile sygnału można również wyświetlić w obszarze **Menu główne** > **Przewodnik umieszczania** w aplikacji Eversense. **Przypomnienie: Nie można nawiązać połączenia z czujnikiem aż do momentu sparowania nadajnika z aplikacją Eversense.**

4. Łączenie wykrytego czujnika


Rozdział opisuje metodę łączenia czujnika z inteligentnym nadajnikiem po raz pierwszy po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia. Tylko Personel pracownik zdrowia może wprowadzić czujnik pacjentowi. Więcej informacji zawiera rozdział „Informacje o czujniku".

Po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia inteligentny nadajnik oraz czujnik należy połączyć w celu rozpoczęcia **24-godzinnej** fazy rozgrzewania. Inteligentny nadajnik można jednocześnie połączyć wyłącznie z jednym czujnikiem. W fazie rozgrzewania noszenie inteligentnego nadajnika nie jest konieczne.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do łączenia czujnika należy przeczytać cały rozdział.


Można podłączyć czujnik z inteligentnym nadajnikiem w dowolnym momencie po wprowadzeniu czujnika i sparowaniu inteligentnego nadajnika z aplikacją Eversense. Aby połączyć czujnik, urządzenie mobilne musi być połączone z Internetem, a nadajnik musi być naładowany, włączony i sparowany z urządzeniem mobilnym.


Miejsce nacięcia zamyka się za pomocą pasków Steri Strips, a następnie nakłada się opatrunek samoprzylepny, taki jak Tegaderm. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób inteligentny nadajnik powinien zostać umieszczony nad czujnikiem, aby umożliwić wykonanie łączenia. Inteligentny nadajnik powinien być wyśrodkowany nad czujnikiem, jak pokazano na ilustracji.




WAŻNE: Pracownik służby zdrowia wypełni kartę implantu w momencie wprowadzenia. Tę kartę należy zachować w portfelu i wymienić ją po otrzymaniu nowej karty po następnym wprowadzeniu.

Kiedy łączenie czujnika odbywa się po raz pierwszy, a na miejsce wprowadzenia nałożony jest opatrunek Tegaderm, nacięcie prawdopodobnie znajduje się pośrodku opatrunku Tegaderm. Oznacza to, że czujnik jest najprawdopodobniej nad środkiem opatrunku Tegaderm.





Przy pierwszym łączeniu czujnika nie należy używać przylepca Eversense na inteligentnym nadajniku. Umieszczając inteligentny nadajnik nad czujnikiem, należy go umieścić nieco powyżej środka przylepca Tegaderm.





1. **Upewnij się, że inteligentny nadajnik jest włączony (patrz *Użytkowanie inteligentnego nadajnika*) oraz że urządzenie przenośne ma dostęp do Internetu.**
   - Ustawiaj inteligentny nadajnik bezpośrednio nad wprowadzonym czujnikiem, aż **Przewodnik umieszczania** w aplikacji wskaże połączenie, a następnie utrzymaj pozycję bez wywierania nacisku. Przewodnik umieszczania można znaleźć w **Menu** > **Przewodnik umieszczania**.




2. **Po potwierdzeniu wykrycia sygnału przejdź do strony Przewodnik umieszczania na ekranie Menu głównego.**


Uwaga: połączenie między czujnikiem i inteligentnym nadajnikiem jest wrażliwe na orientację nadajnika. Jeżeli inteligentny nadajnik umieszczono bezpośrednio nad czujnikiem, a strona Przewodnik umieszczania wskazuje na brak połączenia, należy spróbować obrócić inteligentny nadajnik nieznacznie w lewo lub w prawo, tak aby nadajnik był wyśrodkowany nad czujnikiem w pionie.






3. **Aby połączyć inteligentny nadajnik i czujnik, dotknij opcji Połącz czuj. w oknie podręcznym Wykryto nowy czujnik lub dotknij Menu > Ustawienia > System > Połączony czujnik, a następnie dotknij Połącz wykryty czujnik.**




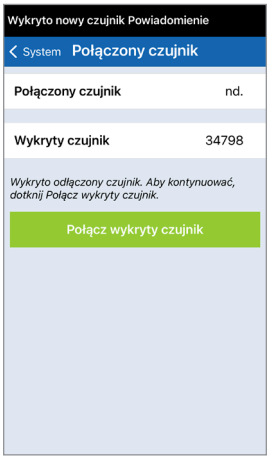


Uwaga: zanim wyświetli się powiadomienie „Wykryto nowy czujnik”, może minąć do 5 minut.

4. Rozpocznie się proces łączenia. Po zakończeniu każdego etapu zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia. Proces łączenia trwa do 10 minut. NIE WOLNO zdejmować inteligentnego nadajnika znad miejsca wszczepienia czujnika do czasu wyświetlenia trzeciego symbolu zaznaczenia.

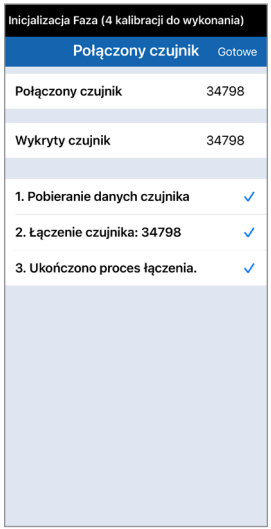




W przypadku zdjęcia inteligentnego nadajnika z miejsca wszczepienia czujnika system wyświetli powiadomienie.

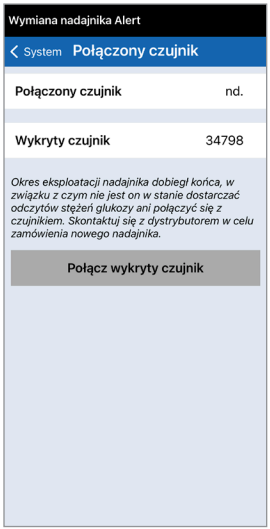

Jeśli inteligentny nadajnik stracił ważność, nie można go połączyć z czujnikiem.

Po podłączeniu czujnika można wyjąć inteligentny nadajnik i umieścić go w ładowarce na następne 24 godziny. Patrz rozdział *Użytkowanie inteligentnego nadajnika*, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z systemu po fazie rozgrzewania.

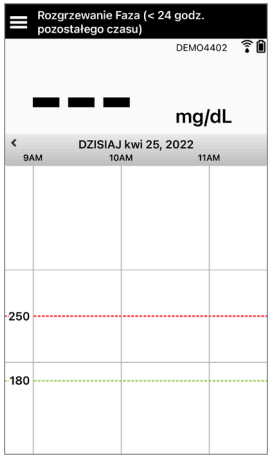


Przestroga: czujnik i inteligentny nadajnik powinny zostać połączone w dniu wszczepienia. Niewykonanie tej czynności może opóźnić odbiór odczytów poziomu glukozy.

Uwaga: czujnik wymaga przeprowadzenia 24-godzinnej fazy rozgrzewania w celu ustabilizowania się w organizmie przed rozpoczęciem pobierania wartości pomiarów glukozy przez inteligentny nadajnik. W fazie rozgrzewania nie trzeba nosić inteligentnego nadajnika. Noszenie inteligentnego nadajnika w tym czasie skutkuje jedynie wyświetleniem w aplikacji komunikatu o trwającej fazie rozgrzewania. Po zakończeniu fazy rozgrzewania należy włączyć inteligentny nadajnik i umieścić go nad czujnikiem za pomocą przylepca Eversense. System przypomni o obowiązku przeprowadzenia kalibracji przy użyciu aplikacji.

Ostrzeżenie: Eversense E3 CGM nie zapewnia odczytów podczas 24-godzinnej fazy rozgrzewania ani podczas fazy inicjalizacji do momentu pomyślnego zakończenia drugiej kalibracji. W tym okresie pacjent powinien monitorować stężenie glukozy za pomocą urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi.

WAŻNE: Po **24-godzinnej** fazie rozgrzewania system nie może dostarczyć odczytów poziomu glukozy, jeśli inteligentny nadajnik nie jest włączony i noszony nad czujnikiem.


✓**Porada**: Czujnik może nie znajdować się precyzyjnie prostopadle do nacięcia. Jeśli uzyskanie dobrego lub doskonałego sygnału w Przewodniku umieszczania jest trudne, NIE wolno wywierać nacisku. Należy spróbować obrócić lekko inteligentny nadajnik nad czujnikiem. Poczekaj mniej więcej 1 sekundę, aż Przewodnik umieszczania odświeży informacje wyświetlane pomiędzy regulacjami położenia inteligentnego nadajnika nad czujnikiem.



Przewodnik umieszczania – ekran główny

Poniżej przedstawiono różne poziomy siły sygnału, które mogą być wyświetlane.


✓**Porada**: Aby połączyć czujnik lub korzystać z systemu, nie jest konieczna doskonała siła sygnału.

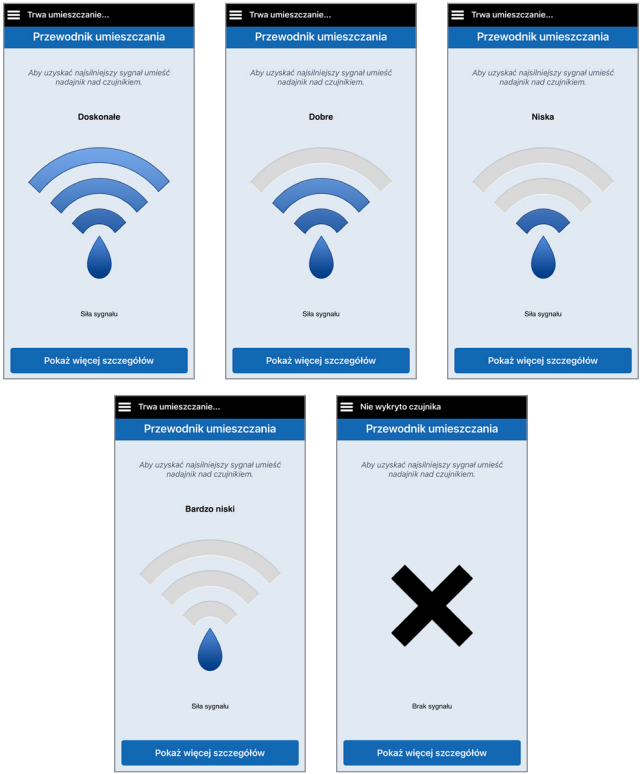

Przewodnik umieszczania – ekran „Pokaż więcej szczegółów”

Dotknięcie opcji Pokaż więcej szczegółów powoduje wyświetlenie wskaźnika siły sygnału w wyższej rozdzielczości.

- Może to ułatwić prawidłowe ustawienie nadajnika nad czujnikiem.

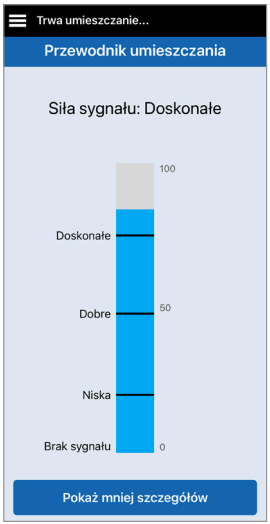


5. Codzienne noszenie nadajnika

Rozdział opisuje wiele funkcji inteligentnego nadajnika oraz metodę uzyskiwania nieprzerwanego i ciągłego monitorowania poziomów glukozy.

Po zakończeniu fazy rozgrzewania rozpocznie się faza inicjalizacji, która umożliwia rozpoczęcie noszenia inteligentnego nadajnika. Przez pierwszych kilka dni należy nosić inteligentny nadajnik na opatrunku Tegaderm™. Należy zawsze naładować inteligentny nadajnik przed rozpoczęciem noszenia. Aby dostarczać informacje do systemu CGM, inteligentny nadajnik pacjenta komunikuje się zarówno z czujnikiem, jak i z aplikacją.

Inteligentny nadajnik Eversense E3:

- Zasila czujnik.
- Wykonuje obliczenia i zapisuje dane dotyczące poziomu glukozy.
- Wysyła alerty wibracyjne odczuwalne na ciele po przekroczeniu ustawionych poziomów glukozy.
- Wysyła dane o poziomie glukozy do aplikacji poprzez łączność Bluetooth.
- Można ładować, umieszczając go w stacji dokującej.
- Wykorzystuje port USB w stacji dokującej do przesyłania danych do zgodnych aplikacji zewnętrznych.
- Wielokolorowa kontrolka LED wskazuje różne tryby pracy inteligentnego nadajnika.
- Komunikuje się z urządzeniem przenośnym.
- Może być włączony lub wyłączony.

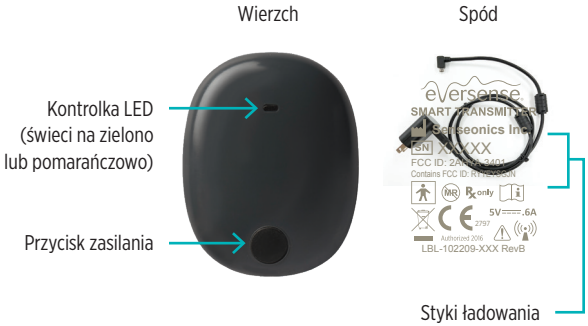

Codzienne użytkowanie

W celu otrzymywania ciągłych odczytów o stężeniach glukozy, korzystając z inteligentnego nadajnika, należy:

- ✓ Inteligentny nadajnik należy nosić na ciele przez cały czas, z wyjątkiem przerwy na ładowanie jego baterii.
- ✓ Inteligentny nadajnik jest odporny na działanie wody do głębokości 1 m (3,2 stopy), przez 30 minut. Narażenie nadajnika na takie warunki przez dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.
- ✓ Należy się upewnić, że bateria inteligentnego nadajnika jest przez cały czas odpowiednio naładowana.
- ✓ Po wyświetleniu monitu należy wykonywać test kalibracyjny za pomocą glukometru.
- ✓ Należy zwracać uwagę na alerty i powiadomienia wysyłane przez inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne.
- ✓ Należy codziennie zmieniać przylepiec.
- ✓ Nadajnik można zdjąć z ramienia w dowolnej chwili, z wyjątkiem momentu kalibracji. Należy pamiętać, że w przypadku braku łączności między czujnikiem i nadajnikiem nie są gromadzone żadne dane. Po ponownym przymocowaniu nadajnika nad czujnikiem należy odczekać do 10 minut do momentu ponownego nawiązania połączenia i pojawienia się odczytów poziomu glukozy w aplikacji.
- ✓ Jeżeli inteligentny nadajnik jest poza zasięgiem urządzenia przenośnego, dane zgromadzone przez inteligentny nadajnik są zapisywane i przesyłane do aplikacji po ponownym znalezieniu się urządzenia przenośnego w zasięgu nadajnika.
- ✓ Czujnik i inteligentny nadajnik można bezpiecznie przenosić przez bramki wykrywacza metali na lotnisku. W czasie lotu inteligentny nadajnik zachowuje się tak, jak wszystkie inne urządzenia Bluetooth. Należy się zawsze stosować do zaleceń bezpieczeństwa określonych przez linię lotniczą.
- ✓ Zanim inteligentny nadajnik otrzyma pierwszą wartość poziomu glukozy po umieszczeniu go nad czujnikiem, pasek stanu w aplikacji mobilnej wyświetli komunikat Gromadzenie danych. Ten pasek stanu może również zostać wyświetlony tuż po ładowaniu.

Ostrzeżenie: NIE NALEŻY używać uszkodzonego lub pękniętego inteligentnego nadajnika, ponieważ mogłoby to stworzyć niebezpieczeństwo elektryczne lub awarię oraz prowadzić do porażenia prądem.

Mocowanie inteligentnego nadajnika nad wszczepionym czujnikiem

5

Inteligentny nadajnik należy przymocować do skóry bezpośrednio nad czujnikiem za pomocą przylepca. Przylepiec powinien być wymieniany codziennie. Z jednej strony przylega on do tylnej części inteligentnego nadajnika, natomiast druga przylepna warstwa z silikonu przylega do skóry. Obie powierzchnie, skóry i nadajnika, powinny być czyste i suche, aby przylepiec lepiej się trzymał. Przez pierwszych kilka dni po wszczepieniu należy nosić inteligentny nadajnik na opatrunku Tegaderm. Opatrunek Tegaderm powinien zostać zdjęty, gdy zezwoli na to pracownik służby zdrowia. Zużyte przylepce należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


Uwaga: Pracownik służby zdrowia przekaże pacjentowi przylepce. Przylepce są dostarczane w wersji z białym lub przezroczystym materiałem. Białe przylepce są perforowane, co pozwala na odprowadzanie wilgoci. Przezroczyste przylepce mogą być stosowane w sytuacjach, kiedy potrzebna jest większa dyskrecja.

Przestroga: W przypadku obaw dotyczących reakcji alergicznej na silikony, przed zastosowaniem należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Po 24 godzinach użytkowania przylepiec należy wyrzucić.

1. **Zdejmij spodnią warstwę papieru z obrysem inteligentnego nadajnika Eversense E3. Postaraj się nie dotykać klejącej środkowej części przylepca.**




2. **Wyrównaj inteligentny nadajnik nad klejącą stroną (środkiem) przylepce i odpowiednio dociśnij w celu przyklejenia.**
   - Inteligentny nadajnik należy umieścić tak, aby „skrzydełka” przylepca były po jego bokach (jak przedstawiono na ilustracji).



3. Zdejmij większy przezroczysty materiał podkładowy i umieść inteligentny nadajnik bezpośrednio nad czujnikiem.

- W celu uzyskania optymalnej siły sygnału nadajnik należy umieścić bezpośrednio nad czujnikiem. Siłę sygnału można też poprawić, obracając inteligentny nadajnik nad czujnikiem tak, aby czujnik był wyśrodkowany w orientacji pionowej pod inteligentnym nadajnikiem.



Po zakończeniu 24-godzinnej fazy rozgrzewania można nosić inteligentny nadajnik nad opatrunkiem Tegaderm z przylepcem Eversense.


4. Sprawdź połączenie między inteligentnym nadajnikiem i czujnikiem.

- Dotknij opcji **Menu** > **Przewodnik umieszczania**.
- Podczas zakładania inteligentnego czujnika zapoznaj się z informacjami na ekranie **Przewodnik umieszczania**, aby upewnić się, że nawiązano połączenie między czujnikiem i inteligentnym nadajnikiem.




Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat siły sygnału i pozycjonowania nadajnik, należy zapoznać się z częścią *Ekran Przewodnik umieszczania – Pokaż więcej szczegółów* w rozdziale *Łączenie czujnika*.

5. **Odpowiednio dociśnij przylepiec do powierzchni skóry nad czujnikiem. Przez kilka pierwszych dni NIE WOLNO stosować nadmiernego nacisku na miejsce wszczepienia.**
   - Inteligentny nadajnik należy ustawić tak, aby skrzydełka przylepca były ułożone poziomo na ramieniu.



6. **Użyj wypustu, aby zdjąć pozostałą część przezroczystego materiału podkładowego.**
   - Wygładź przylepiec na skórze. Upewnij się, ze przylepiec leży płasko na skórze.




Włączanie i wyłączanie inteligentnego nadajnika

Inteligentny nadajnik jest wyposażony w przycisk zasilania, służący do jego włączania i wyłączania. Dodatkowo posiada dwie kontrolki (LED), wskazujące poziom naładowania baterii nadajnika.

5

1. **Aby włączyć inteligentny nadajnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez mniej więcej pięć sekund.**
   - Inteligentny nadajnik zawibruje jednokrotnie.
   - Zwolnij przycisk zasilania. Kontrolka LED mignie, aby poinformować o włączeniu zasilania.

   W dowolnej chwili naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania w celu sprawdzenia, czy nadajnik jest włączony. Jeżeli kontrolka LED zaświeci się, oznacza to, że inteligentny nadajnik jest włączony. Jeżeli kontrolka LED nie zaświeci się, oznacza to, że inteligentny nadajnik jest wyłączony.

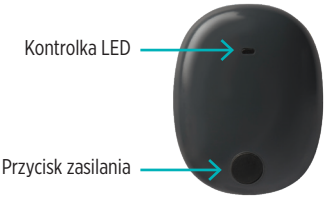

2. **Aby wyłączyć inteligentny nadajnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez mniej więcej pięć sekund.**
   - Inteligentny nadajnik zawibruje jednokrotnie.
   - Zwolnij przycisk zasilania. Pomarańczowa kontrolka LED mignie, aby poinformować o wyłączeniu zasilania.

Obsługa i konserwacja inteligentnego nadajnika

- Nadajnik i stację dokującą należy utrzymywać w czystości (bez widocznych zabrudzeń) i zabezpieczyć, kiedy nie są użytkowane. Przed kolejnym użyciem należy wytrzeć do czysta ściereczką.
- W przypadku wyświetlenia alertu błędu baterii należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany nadajnika.
- W momencie sygnalizacji niskiego poziomu naładowania baterii należy podłączyć nadajnik do ładowarki.
- Baterię inteligentnego nadajnika należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Używanie zasilacza innego niż dołączony przez firmę Senseonics może skutkować unieważnieniem gwarancji. NIE WOLNO używać uszkodzonego zasilacza.
- Inteligentny nadajnik należy czyścić przy użyciu ściereczki zwilżonej wodą. Ściereczkę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Inteligentny nadajnik i wszystkie jego komponenty należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii inteligentnego nadajnika można sprawdzić w aplikacji lub na samym nadajniku.

W aplikacji:

- Dotknij opcji **Menu** > **Informacje** > **Mój nadajnik**. Przewiń ekran w dół, do wiersza Poziom baterii, który pokazuje ilość energii pozostałą w baterii.

  Lub

- Sprawdź ikonę baterii w prawym górnym rogu na ekranie **MOJA GLUKOZA**. Czerwona ikona baterii wskazuje, ze poziom naładowania baterii jest niski.

Na inteligentnym nadajniku:

- Przy włączonym nadajniku naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Jeżeli poziom naładowania akumulatora wynosi przynajmniej 10%, kontrolka LED mignie na zielono. Baterię inteligentnego nadajnika należy zawsze ładować pełne 15 minut, aż do całkowitego naładowania, podłączając ją do gniazda ściennego. Więcej informacji o kontrolkach LED zamieszczono na następnej stronie.

Kontrolki LED stanu

Inteligentny nadajnik może informować o wielu stanach samym kolorem kontrolki LED.

- **Podczas korzystania z inteligentnego nadajnika:**

Kontrolka LED stanu	Status	Działanie
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka LED będzie świecić się na zmianę na zielono i czerwono, 3 razy w ciągu 5 sekund	Tryb „Widoczny”	Sparuj inteligentny nadajnik z urządzeniem przenośnym
Po wciśnięciu przycisku kontrolka nie miga	Inteligentny nadajnik jest wyłączony	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć nadajnik.
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka mignie na zielono	Poziom naładowania baterii wynosi 10–90%	Nie jest wymagane żadne działanie
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka mignie na pomarańczowo	Niski poziom naładowania baterii, pozostało mniej niż 10%	Naładuj baterię
Kontrolka LED świeci na pomarańczowo przez 1 minutę	Wysłano alert	Sprawdź aplikację na swoim urządzeniu przenośnym, aby odczytać alert

- **Podczas ładowania inteligentnego nadajnika:**

Kontrolka LED stanu	Stan baterii	Działanie
Stałe lub migające światło pomarańczowe po podłączeniu kabla USB	Poziom naładowania 0%–65%	Przed odłączeniem od źródła zasilania należy ładować przez 15 minut
Stałe światło zielone po podłączeniu kabla USB	Poziom naładowania 65%–100%	Przed odłączeniem od źródła zasilania należy ładować przez 15 minut

6. Kalibrowanie systemu

Niniejszy rozdział opisuje procedurę i harmonogram kalibracji systemu Eversense E3 CGM.

Ostrzeżenie: NIE WOLNO pobierać krwi do badania glukometrem z innych miejsc, np. z ramienia.

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności systemu należy go regularnie kalibrować. Kalibracja systemu odbywa się przy użyciu odczytów z glukometru na podstawie próbki krwi pobranej z opuszki palca. Do kalibracji można używać każdego dostępnego w handlu glukometru. Po wszczepieniu czujnika i powiązaniu go z inteligentnym nadajnikiem rozpocznie się 24-godzinna faza rozgrzewania systemu. Podczas trwania tej fazy wykonywanie kalibracji nie jest wymagane.


Proces kalibracji składa się z trzech faz:


Faza inicjalizacji – po zakończeniu 24-godzinnej fazy rozgrzewania należy wykonać 4 testy kalibracyjne przy użyciu pomiaru z opuszki palca w odstępie od 2 do 12 godzin.

Faza 2 dziennych kalibracji – po fazie inicjalizacji należy wykonać test kalibracyjny przy użyciu pomiaru z opuszki palca co 12 godzin przez co najmniej 21 dni.

Faza 1 dziennej kalibracji – system wykryje, czy potrzebna jest 1 czy 2 kalibracje dzienne i wyświetli alert dla użytkownika. Podczas fazy 1 dziennej kalibracji należy wykonywać testy kalibracyjne przy użyciu pomiaru z opuszki palca co 24 godziny.

Po pierwszych 21 dniach system powiadomi, czy potrzebna jest 1 czy 2 dzienne kalibracje.





Ostrzeżenie: W fazie 2 dziennych kalibracji system Eversense E3 CGM wymaga kalibracji co 12 godzin, aby zapewnić dokładne odczyty. Podczas fazy 1 dziennej kalibracji system Eversense E3 CGM co 24 godziny. Jeśli pacjent nie przestrzegał instrukcji dotyczących codziennej kalibracji, nie powinien wykorzystywać odczytów z systemu CGM do podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Wykonywanie dziennej kalibracji jest bardzo ważne dla zapewnienia jak najlepszej wydajności systemu E3 CGM Eversense. Poniższe wskazówki pomogą w usprawnieniu pomiarów kalibracyjnych:

Porady dotyczące zapewnienia dobrej kalibracji:

- ✓ Kalibrację należy wykonywać w godzinach, w których poziom glukozy nie zmienia się gwałtownie (np. przed posiłkami, przed podaniem insuliny).
- ✓ Po rozpoczęciu kalibracji nie wolno zdejmować nadajnika inteligentnego przez kolejne 15 minut.
- ✓ Przed wykonaniem pomiaru zawartości glukozy we krwi należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wytrzeć. Wymycie i wytarcie rąk przed przystąpieniem do kalibracji jest bardzo ważne.
- ✓ Aby zapewnić dokładność pomiaru zawartości glukozy we krwi, należy zawsze stosować się do zaleceń producenta glukometru.
- ✓ Upewnić się, że kod na pasku testowym fiolki odpowiada kodowi na glukometrze (jeżeli kodowanie jest wymagane).

Kalibracja *NIE* będzie kompletna lub wyniki *NIE* zostaną zaakceptowane, jeśli:

- ✗ Wartość wskazywana przez glukometr jest mniejsza niż 40 mg/dl.
- ✗ Wartość wskazywana przez glukometr jest większa niż 400 mg/dl.
- ✗ Pomiar poziomu glukozy we krwi został wykonany więcej niż 10 minut przed wprowadzeniem wyników do aplikacji Eversense.
- ✗ Wskazanie czujnika różni się znacznie od wskazania glukometru.
- ✗ Inteligentny nadajnik został usunięty lub nie mógł zebrać danych dotyczących poziomu glukozy z czujnika w ciągu 15 minut od wprowadzenia wartości kalibracji.

Fazy kalibracji

A. Faza inicjalizacji (po upływie 24-godzinnej fazy rozgrzewania)

Ta faza wymagania przeprowadzenia testów 4 próbek krwi pobranych z palca.

- Te 4 pomiary kalibracyjne należy wykonać w odstępie od 2 do 12 godzin, przy czym wszystkie 4 pomiary należy wykonać w ciągu 36 godzin. Po 8 godzinach bez wpisu dotyczącego kalibracji nie będą wyświetlane żadne dane dotyczące poziomu glukozy.
  - 1. kalibracja = 24 godziny po połączeniu czujnika.
  - 2. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 1. pomyślnej kalibracji.
  - 3. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 2. pomyślnej kalibracji.
  - 4. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 3. pomyślnej kalibracji.
- Zmierzona wartość glukozy zostanie wyświetlona w aplikacji po kilku minutach od pomyślnego zakończenia 2. kalibracji.

WAŻNE: jeżeli inteligentny nadajnik nie jest włączony, sparowany z aplikacją Eversense i połączony z czujnikiem, system nie przypomni pacjentowi o kalibracji.

Ponowne przejście do fazy inicjalizacji

Poniższe okoliczności spowodują ponowne przejście systemu do fazy inicjalizacji:

- Nieukończenie testu kalibracyjnego w fazie inicjalizacji w ciągu 12 godzin.
- Nieukończenie wszystkich 4 testów kalibracyjnych w fazie inicjalizacji w ciągu 36 godzin.
- Niewprowadzenie wymaganych wpisów dotyczących kalibracji podczas fazy dziennej kalibracji.
  - 1 kalibracja co 12 godzin w ciągu pierwszych 21 dni noszenia i za każdym razem, gdy system znajduje się w fazie 2 dziennych kalibracji
  - 1 kalibracja co 24 godziny, gdy system znajduje się w fazie 1 dziennej kalibracji

- Znaczna różnica między wynikami ostatnich kilku pomiarów poziomu glukozy i wynikiem pokazywanym przez czujnik.
- Bateria inteligentnego nadajnika pozostawała nienaładowana przez ponad 16 godzin.
- Po otrzymaniu alertu kontroli czujnika.
- Sześć godzin po otrzymaniu alertu wstrzymania czujnika.

B. Faza dziennej kalibracji

Istnieją dwie fazy dziennej kalibracji.


Faza 2 dziennych kalibracji wymaga testu przyrządu do pomiaru poziomu glukozy we krwi co 12 godzin. Faza dziennej kalibracji rozpoczyna się po pomyślnym zakończeniu fazy inicjalizacji.


- 12 godzin po ostatniej udanej kalibracji system wyświetli monit o wykonanie kalibracji.
- Opcjonalnie można wprowadzać kalibracje częściej. Wpisy dotyczące dziennej kalibracji muszą być oddzielone o co najmniej jedną godzinę.
- Jeśli kalibracja nie zostanie przeprowadzona w ciągu 16 godzin, pojawi się alert „Minął termin wymaganej kalibracji" i żadne wartości glukozy nie będą wyświetlane do czasu wprowadzenia wartości kalibracji. Po 24 godzinach bez wprowadzenia wartości kalibracji pojawi się alert o „Kalibracja przeterminowana" i system powróci do fazy inicjalizacji.

Faza 1 dziennej kalibracji wymaga badania poziomu glukozy we krwi pobranej z opuszki palca co 24 godzin.

- 24 godziny po ostatniej udanej kalibracji system wyświetli monit o wykonanie kalibracji.
- Opcjonalnie można wprowadzać kalibracje częściej. Wpisy dotyczące dziennej kalibracji muszą być oddzielone o co najmniej jedną godzinę.

- Jeśli kalibracja nie zostanie przeprowadzona w ciągu 28 godzin, pojawi się alert „Minął termin wymaganej kalibracji” i żadne wartości glukozy nie będą wyświetlane do czasu wprowadzenia wartości kalibracji. Po 40 godzinach bez wprowadzenia wartości kalibracji pojawi się alert o „Kalibracja przeterminowana” i system powróci do fazy inicjalizacji.





Ostrzeżenie: pewne warunki i alerty uniemożliwiają wyświetlenie danych dotyczących poziomu glukozy. W tym okresie pacjent powinien używać urządzenia do pomiaru poziomu glukozy we krwi, aby podejmować decyzje związane z leczeniem. Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z rozdziałem *Alerty i powiadomienia* w *instrukcji użytkownika*, aby zrozumieć te sytuacje.


Uwaga: Jeśli wpis kalibracji znacznie różni się od wartości poziomu glukozy z czujnika, około godzinę później zostanie wyświetlony monit z powiadomieniem „Kalibruj teraz”. Alert „Kalibruj teraz” zostanie wyświetlony 11 do 12 godzin później, niezależnie od fazy dziennej kalibracji, w której znajduje się system. W takiej sytuacji, jeśli nie wykona się kalibracji w ciągu 16 godzin, nie zostaną wyświetlone żadne wartości glukozy. Po 24 godzinach bez kalibracji system powraca do fazy inicjalizacji.

Metoda kalibracji


Ostrzeżenie: System należy zawsze kalibrować wyłącznie z użyciem próbki krwi pobranej z opuszki palca. NIE NALEŻY stosować odczytu poziomu glukozy z krwi pobranej z innych miejsc (np. z przedramienia lub dłoni) do kalibracji systemu.


Uwaga: Można wprowadzić dodatkowe wyniki kalibracji, jeśli tylko każda z tych kalibracji była wykonywana w odstępie co najmniej 1 godziny.

1. **Można wprowadzić wartość kalibracji, dotykając Kalibruj w menu głównym lub w powiadomieniu „Kalibruj teraz" albo alercie.**

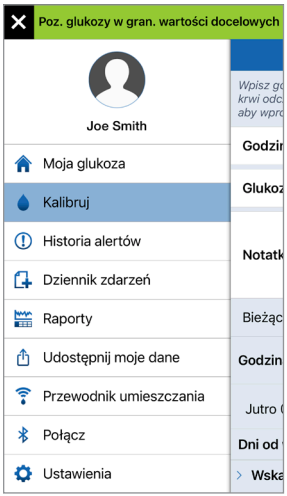







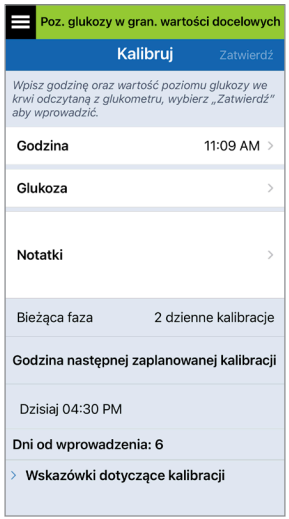


2. **Wykonaj odczyt z opuszki palca za pomocą glukometru.**




3. **Dotknij Glukoza i wprowadź wartość uzyskaną z badania z opuszki palca.**
   - Dotknij opcji **OK**.
   - Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.
   - Dotknij opcji **OK**.

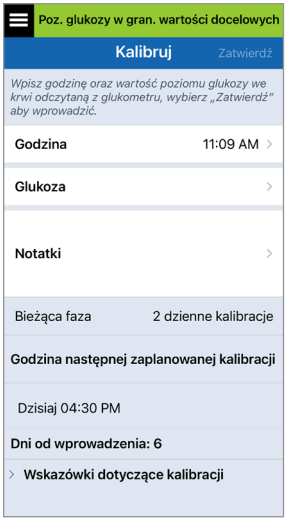

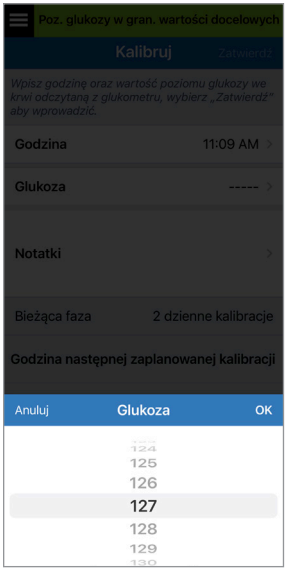


Uwaga: Nie można wprowadzić wartości kalibracji, która jest starsza niż 10 minut.

4. Ekran **KALIBRUJ** wyświetla teraz godzinę i wprowadzony odczyt poziomu glukozy. W przypadku stwierdzenia błędu powtórz krok 3.
   - Po skorygowaniu dotknij **Zatwierdź**.

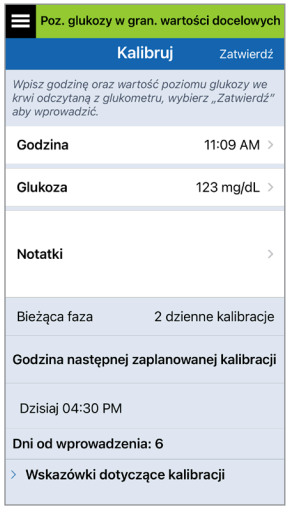

5. Pojawi się ekran **TRWA KALIBRACJA**.
   - Wybierz przycisk **OK**.

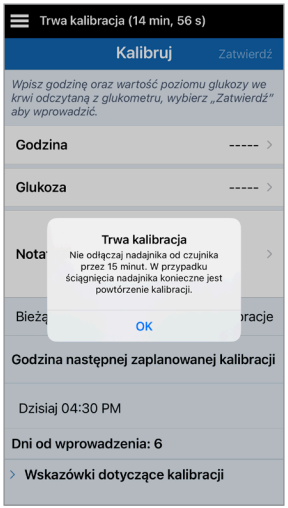

6. Ekran **MOJA GLUKOZA** pojawia się z szarą ikoną kropli krwi, aby wskazać, że trwa kalibracja na podstawie badania z opuszki palca. Symbol kropli krwi zmieni kolor na czerwony, gdy wartość kalibracji zostanie zaakceptowana.



WAŻNE: w okresie co najmniej 5 minut przed testem i 15 minut po teście kalibracji nie należy zdejmować inteligentnego nadajnika z miejsca wszczepienia czujnika. Pasek stanu w górnej części ekranu informuje pacjenta o czasie zakończenia kalibracji. Jeśli inteligentny nadajnik zostanie usunięty przed zakończeniem kalibracji, pojawi się monit o ponowną kalibrację.

Uwaga: mogą wystąpić sytuacje, w których wynik kalibracji NIE zostanie zaakceptowany.

Kalibracja *NIE* zostanie zaakceptowana, jeśli:

- ✕ Wartość wskazywana przez glukometr jest mniejsza niż 40 mg/dl.
- ✕ Wartość wskazywana przez glukometr jest większa niż 400 mg/dl.



- ✕ Inteligentny nadajnik został usunięty lub nie mógł zebrać danych dotyczących poziomu glukozy z czujnika w ciągu 15 minut od wprowadzenia wartości kalibracji.

Kolory ikony kalibracji wskazują status wpisu kalibracji. Patrz tabela poniżej.

Status		Opis
	**Trwa kalibracja**	Wyświetlany przez mniej więcej 15 minut po wprowadzeniu wartości kalibracji. W tym czasie nie usuwaj nadajnika. Ikona zmieni kolor na czerwony, czarny lub niebieski, gdy kalibracja nie będzie już w toku.
	**Kalibracja zaakceptowana**	Wyświetlany po ok. 15 minutach okresu kalibracji, jeśli wpis kalibracji został zaakceptowany.
	**Kalibracja niekompletna**	Wyświetlany gdy nadajnik zostanie usunięty z lokalizacji nad czujnikiem podczas kalibracji trwającej ok. 15 minut. Konieczny będzie nowy wpis kalibracji.
	**Nie można zastosować wartości kalibracji**	Wyświetlany gdy wprowadzona wartość kalibracji wynosi mniej niż 40 mg/dl lub więcej niż 400 mg/dl. Wprowadzona wartość jest wyświetlana jako ręczny wpis poziomu glukozy we krwi. Kalibrację należy powtórzyć, jeśli wartość poziomu stężenia glukozy będzie mieścić się w zakresie od 40 do 400 mg/dl.
	**Wpis zdarzenia poziomu glukozy we krwi**	Wyświetlany, kiedy ręczna wartość glukozy we krwi zostanie wprowadzona za pomocą dziennika zdarzeń.

7. Użytkowanie aplikacji

Rozdział opisuje aplikację Eversense: ekran główny, wykres trendu, strzałki trendu i ekran menu.

Aplikacja komunikuje się z inteligentnym nadajnikiem w celu otrzymywania i wyświetlania informacji o poziomie glukozy, trendów, wykresów i alertów. Aplikacja przechowuje także historię pomiarów poziomu glukozy w zakresie maksymalnie 90 dni.

Uwaga: Po wylogowaniu się przez pacjenta z aplikacji Eversense inteligentny nadajnik nie będzie wysyłał informacji o poziomie glukozy do czasu, aż pacjent ponownie zaloguje się do aplikacji.


Na ekranie **MOJA GLUKOZA** można uzyskać dostęp:


- odczytów z czujnika poziomu glukozy w czasie rzeczywistym,
- szybkości i kierunku zmian poziomów glukozy,
- wykresów trendów poziomów glukozy,
- alertów (dotyczących hipoglikemii lub hiperglikemii),
- zdarzeń, takich jak posiłki, ćwiczenia i przyjmowanie lekarstw.

Uwaga: Do pobierania lub aktualizowania aplikacji Eversense wymagane jest bezprzewodowe połączenie z Internetem.

Zarządzanie kontem w aplikacji Eversense

Ze względów bezpieczeństwa, jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowe hasło w aplikacji mobilnej, konto zostanie zablokowane na 30 minut. W tym czasie nie będzie dostępu do danych CGM w aplikacji mobilnej.







Przestroga: Jeśli nie można uzyskać dostępu do danych CGM, należy monitorować stężenie glukozy za pomocą urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi.


Aplikacja mobilna Eversense będzie okresowo sprawdzać, czy dane logowania nie zostały zmienione za pośrednictwem konta Eversense DMS.

Jeśli hasło do konta Eversense zostanie zmienione z poziomu ekranu logowania DMS lub na stronie zmiany hasła DMS, należy wylogować się z aplikacji mobilnej Eversense i zalogować się ponownie przy użyciu nowego hasła. Jeśli hasła są niezgodne, aplikacja mobilna Eversense powiadomi o tym użytkownika i wskaże niedostępność niektórych funkcji, w tym brak możliwości synchronizacji danych z kontem DMS, brak możliwości dodania użytkowników Eversense NOW do kręgu oraz brak możliwości wprowadzania zmian w zdjęciu profilowym.





Jeśli trzykrotnie wprowadzone zostanie nieprawidłowe hasło na stronie logowania DMS, niektóre funkcje aplikacji mobilnej mogą być niedostępne przez 30 minut, w tym nie będzie możliwości synchronizacji danych z kontem DMS, dodawania użytkowników Eversense NOW do kręgu i zmiany zdjęcia profilowego. W tym czasie nie należy wylogowywać się z aplikacji mobilnej.



Sprawdzanie ustawień urządzenia przenośnego


Do używania systemu Eversense E3 CGM jest wymagane urządzenie przenośne. Aby dane poziomu glukozy były prawidłowo wyświetlane w aplikacji, należy prawidłowo skonfigurować urządzenie przenośne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przenośnego, aby skonfigurować następujące ustawienia:

- godzina i data,
- włączenie komunikacji Bluetooth (aktywacja),
- włączenie odbierania powiadomień,
- poziom naładowania baterii,
- strefa geograficzna,
- język.
- Dźwięk w urządzeniu przenośnym musi być włączony, a nie ustawiony na wibracje.
- Tryb „Nie przeszkadzać" powinien być wyłączony. Niektóre aplikacje i ustawienia, takie jak tryb jazdy mogą automatycznie włączać tryb „Nie przeszkadzać". Więcej informacji znajduje się w instrukcjach urządzenia mobilnego.
- Jeśli w urządzeniu przenośnym zostanie ustawiony tryb „Nie przeszkadzać", powiadomienia z aplikacji Eversense nie będą odtwarzane.

*** W przypadku systemu iOS w wersji 12 lub nowszej oraz Android w wersji 6 lub nowszej można zezwolić na nadpisywanie ustawień urządzenia przenośnego przez alerty Niski poziom glukozy i Poza zakresem niskiego stężenia glukozy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Ustawienia dźwięku*.**

Ekran „Moja Glukoza”

Ekran **MOJA GLUKOZA** stanowi główny ekran aplikacji. Przedstawia szereg danych, takich jak: odczyty czujnika glukozy, kierunek i szybkość zmian strzałki trendu, wykres trendu, zdarzenia, kalibracje i alerty oraz powiadomienia.

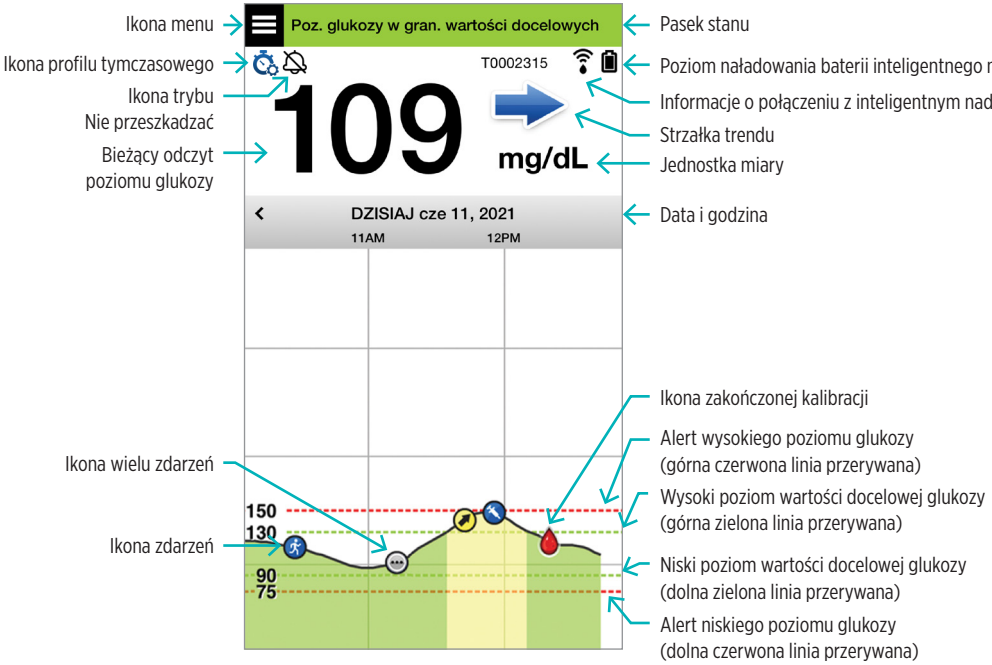

Przed podjęciem decyzji o leczeniu pacjenci powinni wziąć pod uwagę wartość stężenia glukozy z czujnika, wykres trendu, strzałkę trendu i wszelkie alerty z systemu Eversense E3 CGM. Jeśli strzałka trendu nie jest wyświetlana, system nie ma wystarczającej ilości danych, aby wyświetlić kierunek i szybkość zmian. Nie wolno podejmować decyzji o leczeniu wyłącznie na podstawie wartości poziomu glukozy z czujnika.

Uwaga:

- W przypadku urządzeń z systemem iOS lub Android można wyświetlić migawkę informacji o aplikacji Eversense. Informacje dotyczące zarządzania widżetami można znaleźć w instrukcji użytkownika urządzenia przenośnego. Widget Eversense nie jest dostępny we wszystkich systemach operacyjnych.
- Ekran **MOJA GLUKOZA** można wyświetlić w orientacji poziomej, aby uzyskać dostęp do przycisków skrótów w celu wyświetlenia ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni. Zrzut tego ekranu można wysłać w wiadomości e-mail za pomocą jednego dotknięcia.

Pasek stanu	Informuje o bieżącym stężeniu glukozy we krwi i stanie systemu.
Identyfikator inteligentnego nadajnika	Jest to obecnie używany inteligentny nadajnik. Nazwę można zmienić, dotykając opcji **Ustawienia** > **System**.
Bieżący odczyt poziomu glukozy	Bieżąca zawartość glukozy we krwi, podawana w czasie rzeczywistym. Wskazanie jest aktualizowane co 5 minut.
Data i godzina	Bieżąca data i godzina. Można przewinąć ekran w lewo lub w prawo w celu sprawdzenia danych dla różnych dni i godzin.
Poziom naładowania baterii inteligentnego nadajnika	Wskazuje ilość energii pozostałą w baterii inteligentnego nadajnika.
Połączenie z inteligentnym nadajnikiem	Wskazuje siłę sygnału połączenia inteligentnego nadajnika z czujnikiem lub urządzeniem przenośnym.
Strzałka trendu	Pokazuje kierunek zmiany poziomu glukozy.
Jednostka miary	Jednostka miary używana podczas wyświetlania wszystkich danych poziomu glukozy.

Alert **wysokiego/niskiego poziomu glukozy**	Wartości graniczne alertu wysokiego i niskiego poziomu glukozy.
Poziom *docelowy* wysokiego/ niskiego stężenia glukozy	Wartości graniczne wysokiego i niskiego docelowego stężenia glukozy (zakres docelowy).
Ikona wielu zdarzeń	Wskazuje na wystąpienie wielu zdarzeń w jednym czasie.
Ikona zdarzeń	Wskazuje ręcznie wprowadzone zdarzenia (np. aktywność fizyczną). Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Rejestrowanie zdarzeń*.
Ikony kalibracji	Wskazuje stan początkowy kalibracji.
Wykres trendu poziomu glukozy	Wskazuje rozkład poziomu glukozy w czasie. Stronę można przewijać do przodu i do tyłu lub powiększać ją w celu wyświetlenia danych w zakresie od 3 godzin do 3 dni.
Menu	Zapewnia łatwe przechodzenie między różnymi sekcjami aplikacji Eversense: Moja glukoza Kalibruj Historia alertów Dziennik zdarzeń Raporty Udostępnij moje dane Przewodnik umieszczania Połącz Ustawienia Informacje

Strzałki trendu

Istnieje 5 różnych strzałek trendu, które przedstawiają bieżący kierunek zmian poziomu glukozy oraz szybkość tych zmian.

	Poziomy glukozy rosną lub spadają z prędkością od 0,0 mg/dl do 1,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy rosną umiarkowanie z prędkością od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy spadają umiarkowanie z prędkością od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy rosną gwałtownie z prędkością ponad 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy spadają gwałtownie z prędkością ponad 2,0 mg/dl na minutę.

Aby wykonać obliczenia i wyświetlić strzałkę trendu poziomu glukozy, aplikacja wykorzystuje **dane dotyczące stałego monitorowania poziomu glukozy z ostatnich 20 minut**.

W przypadku braku wystarczającej ilości danych z czujnika do obliczeń strzałka trendu nie jest wyświetlana, a wartość poziomu glukozy ma kolor szary zamiast czarnego.

Przed podjęciem decyzji o leczeniu pacjenci powinni wziąć pod uwagę wartość stężenia glukozy z czujnika, wykres trendu, strzałkę trendu i wszelkie alerty z systemu Eversense E3 CGM. Jeśli strzałka trendu nie jest wyświetlana, system nie ma wystarczającej ilości danych, aby wyświetlić kierunek i szybkość zmian. Nie wolno podejmować decyzji o leczeniu wyłącznie na podstawie wartości poziomu glukozy z czujnika.

Zrozumienie decyzji związanych z leczeniem podejmowanych z wykorzystaniem systemu CGM

Należy przeczytać całą instrukcję użytkownika systemu Eversense E3 CGM, aby dowiedzieć się, w jakich sytuacjach można podejmować decyzje o leczeniu na podstawie informacji z czujnika CGM. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu Eversense E3 należy skonsultować się z lekarzem, aby zrozumieć, w jaki sposób jedzenie, insulina, leki, stres i ćwiczenie oddziałują na poziom glukozy.

WAŻNE:

- Jeśli objawy nie są zgodne z wyświetlanymi informacjami o poziomie glukozy z czujnika lub aplikacja nie wyświetla wartości i strzałki trendu, należy użyć glukometru, aby podjąć decyzje o leczeniu.
- Glukometru należy używać do podejmowania decyzji o leczeniu, aż do pełnego zrozumienia funkcjonowania systemu Eversense E3. Użytkownik może potrzebować kilku dni, tygodni lub miesięcy, aby swobodnie korzystać z danych CGM do podejmowania decyzji o leczeniu.

Nie wolno podejmować pochopnych decyzji. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi sytuacji, w których można używać systemu Eversense E3 zamiast glukometru.

Poziom glukozy z czujnika i poziom glukozy we krwi

Poziom glukozy z czujnika jest mierzony w płynie tkankowym, a nie we krwi. W związku z tym wartości poziomu glukozy z czujnika mogą zmieniać się z kilkuminutowym opóźnieniem w porównaniu z wartościami poziomu glukozy we krwi. Na przykład, gdy strzałka trendu CGM przedstawia szybko spadające stężenie glukozy, poziom glukozy może być niższy niż wyświetlana wartość; lub gdy strzałka trendu informuje o szybkim wzroście, poziom glukozy może być wyższy niż wyświetlana wartość. Wystąpienie takich sytuacji jest bardziej prawdopodobne, gdy poziom glukozy pacjenta ulega gwałtownym zmianom, np. po posiłku, po podaniu insuliny i po ćwiczeniach. Stres, choroba i niektóre przyjmowane leki mogą wpłynąć na poziom glukozy. Czasami najlepszą decyzją w zakresie leczenia jest poczekanie i częste sprawdzenie danych z systemu CGM przed podjęciem działań.

Początkowy okres użytkowania

Podczas 24-godzinnej fazy rozruchu wartości glukozy nie są wyświetlane. Podczas gojenia się rany w początkowym okresie użytkowania wartości poziomu glukozy z czujnika mogą również nie być zgodne z wartościami poziomu glukozy we krwi w takim zakresie, jak po wygojeniu rany. Podczas fazy rozruchu oraz do momentu pełnego zrozumienia wartości CGM, należy używać glukometru przy decyzjach związanych z leczeniem. Należy zawsze używać glukometru, jeśli samopoczucie pacjenta nie jest zgodne z wartością poziomu glukozy i trendem strzałki.

7

Łączność Bluetooth

Aby wyświetlić odczyt poziomu glukozy, inteligentny nadajnik łączy się bezprzewodowo z urządzeniem mobilnym poprzez funkcję Bluetooth. Jeśli połączenie między inteligentnym nadajnikiem i urządzeniem mobilnym zostanie przerwane, wartość poziomu glukozy ani strzałka trendu nie zostaną wyświetlone. Jeśli inteligentny nadajnik nie nawiązał łączności z urządzeniem mobilnym, należy używać glukometru do podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Alert wibracyjny

Inteligentny nadajnik wysyła alerty wibracyjne po przekroczeniu ustawionych poziomów alertów glukozy. Jednak nie wolno wykorzystywać alertów wibracyjnych do podejmowania decyzji związanych z leczeniem. W przypadku otrzymania alertu wibracyjnego należy sprawdzić odczyt poziomu glukozy i strzałkę trendu w aplikacji Eversense.

Zdalne monitorowanie za pomocą aplikacji Eversense NOW

Decyzje związane z leczeniem nie mogą być podejmowane na podstawie informacji z systemu CGM wyświetlane w aplikacji mobilnej do zdalnego monitorowania Eversense NOW. Działanie funkcji zdalnego monitorowania opiera się na danych przesyłanych z urządzenia mobilnego do aplikacji Eversense NOW poprzez chmurę Eversense. Przerwanie dowolnego z tych połączeń spowoduje opóźnienie wyświetlania danych w aplikacji Eversense NOW. Tylko informacje z systemu CGM przesyłane bezpośrednio z inteligentnego nadajnika do urządzenia mobilnego mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Należy skontaktować się z lekarzem.

Posiłek

Zarówno różne rodzaje posiłków i żywności, jak i warunki, takie jak opóźnione opróżnianie żołądka, mogą w różny sposób wpływać na poziomy glukozy i strzałki trendu. Niektóra żywność spowoduje szybszy wzrost poziomu glukozy niż inna. Przed wykorzystaniem danych z systemu CGM do podjęcia decyzji związanych z leczeniem konieczne jest omówienie z lekarzem sposobu dawkowania insuliny w przypadku różnych żywności oraz metody dokładnego wyliczania węglowodanów.

Insulina

Insulina nie wywiera natychmiastowego wpływu na poziom glukozy. Na przykład w zależności od marki zastosowanej insuliny o szybkim działaniu, rozpoczęcie oddziaływania może zająć od 5 do 15 minut, szczytowa skuteczność może wystąpić w ciągu 1–2 godzin, a łączny czas oddziaływania może wynieść 4–6 godzin. Pacjent musi wiedzieć, kiedy przyjmowana insulina zaczyna obniżać poziom glukozy, kiedy ma maksymalną skuteczność oraz jak długo utrzymuje się w jego ciele w celu obniżenia poziomu glukozy. Konsultacja z lekarzem w celu zrozumienia działania insuliny, jego początku, szczytu, pomaga w uniknięciu przedawkowania insuliny. Nakładanie się dawek insuliny występuje po przyjęciu kolejnej dawki insuliny, gdy poprzednia dawka jest nadal aktywna. Może to skutkować hipoglikemią, czasami ciężką. Zamiast reagować i przyjmować insulinę na podstawie wysokiej wartości z systemu CGM, należy zastanowić się, czy insulina z ostatniej dawki nadal aktywnie obniża poziom glukozy.

Ćwiczenie

Nawet stosunkowo lekkie ćwiczenie, które nie jest częścią normalnego planu treningowego, może spowodować szybszą niż zwykle zmianę poziomu glukozy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością CGM lub jeśli wartość CGM i strzałka trendu nie są zgodne z oczekiwaniami, należy użyć glukometru do podjęcia decyzji związanej z leczeniem. U niektórych osób hipoglikemia może wystąpić nawet kilka godzin po ćwiczeniu. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi dawkowania insuliny po ćwiczeniu, aby uniknąć wystąpienia niskiego poziomu glukozy.

Choroba i stres

Choroba lub stres ma wpływ na poziom glukozy. Należy uwzględnić to w przypadku podejmowania decyzji związanych z leczeniem. Należy pamiętać, że stres nie zawsze działa negatywnie na organizm. Poziomy glukozy mogą się zmieniać podczas okresu wakacyjnego lub podczas spotkań towarzyskich. Lekarz może pomóc pacjentowi w opracowaniu planu dotyczącego podejmowania decyzji związanych z leczeniem w przypadku choroby lub stresujących sytuacji.

Leki

Należy zrozumieć, jak przyjmowane leki wpływają na poziom glukozy. Niektóre leki na cukrzycę mają na celu zmniejszenie poziomu glukozy, a inne leki, takie jak sterydy, mogą podwyższać poziomy glukozy. W przypadku stosowania systemu Eversense E3 leki z klasy tetracyklin mogą fałszywie obniżać poziom glukozy. Jeśli pacjent przyjmuje leki z tej klasy, nie powinien polegać na odczytach CGM. Należy omówić przyjmowane leki z lekarzem i brać je pod uwagę podczas podejmowania decyzji o leczeniu.

Alerty poziomu glukozy Eversense E3

Lekarz pomoże określić pacjentowi, czy zakres docelowy i poziomy alertów stężenia glukozy są dla niego odpowiednie. Należy zwracać szczególną uwagę na alerty poziomów glukozy Eversense E3 – konieczne może być podjęcie decyzji związanej z leczeniem. W przypadku wygenerowania alertu Glukoza poza zakresem wartość poziomu glukozy z czujnika jest niższa niż 40 mg/dl, a symbol NIS. jest wyświetlany zamiast liczby. Jeśli wartość 400 mg/dl zostanie przekroczona, wyświetlany jest symbol WYS. zamiast liczby. Należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, aby dowiedzieć się, w jaki sposób różni się leczenie bardzo niskiego i bardzo wysokiego poziomu glukozy od standardowego leczenia. Należy zawsze używać glukometru do podejmowania decyzji o leczeniu, kiedy wyświetli się wskazanie NIS. lub WYS.


Przewidywanie


Podobnie jak w przypadku użytkowania glukometru należy dokładnie określić porę dnia, w której podejmowane są decyzje związane z leczeniem z wykorzystaniem systemu CGM. Na przykład, jeśli poziom glukozy jest wysoki i rośnie tuż przed porą snu, należy dostosować dawkę insuliny zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy również wziąć pod uwagę leczenie w przypadku planowania ćwiczeń lub uczestnictwa w spotkaniu przez cały dzień. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi dostosowanie decyzji o leczeniu do nadchodzących wydarzeń w celu uniknięcia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.


Podejmowanie decyzji związanych z leczeniem z wykorzystaniem systemu Eversense E3

Aby podjąć decyzję związaną z leczeniem, należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

- Informacje na pasku stanu.
- Bieżąca wartość poziomu glukozy z czujnika – bieżąca wartość poziomu glukozy powinna być wyświetlana na czarno.
- Strzałka trendu – strzałka trendu powinna być wyświetlana.
- Najnowsze informacje o trendach i alerty.

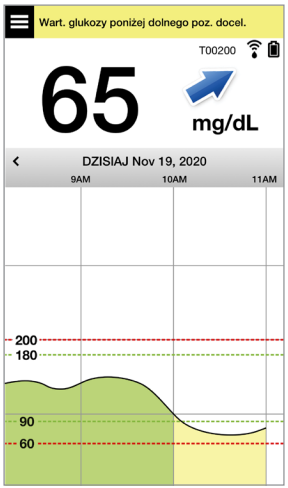


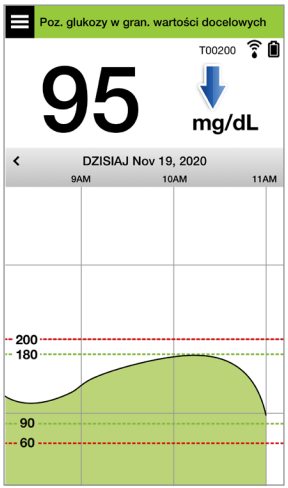


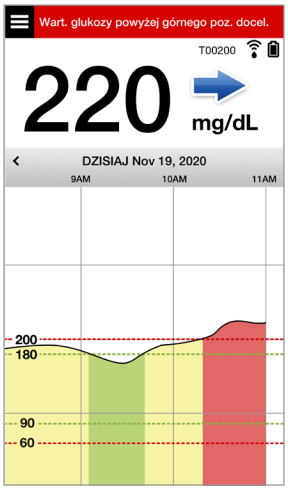

Kiedy NIE należy podejmować decyzji związanych z leczeniem:

- Wartość poziomu glukozy nie jest wyświetlana.
- Strzałka trendu nie jest wyświetlana.
- Objawy nie są zgodne z wyświetlanymi informacjami o poziomie glukozy.
- Bieżąca wartość poziomu glukozy z czujnika jest wyświetlana na szaro.
- Pasek stanu jest wyświetlany na pomarańczowo.
- Pacjent przyjmuje leki z klasy tetracyklin.

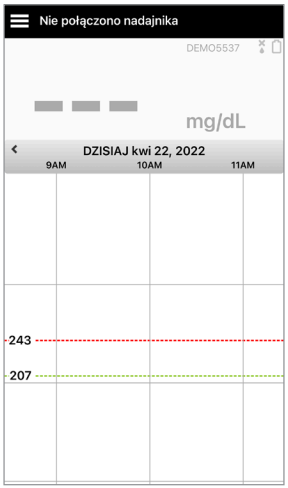

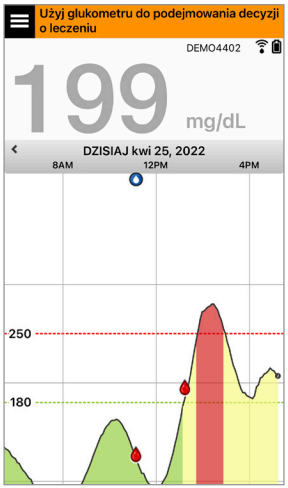

Uwaga: Aby podejmować decyzje związane z leczeniem, należy zawsze zapoznać się z informacjami o poziomie glukozy w aplikacji Eversense CGM. Nie używać pomocniczych ekranów urządzeń takich jak Apple Watch lub aplikacji Eversense NOW.

Strzałki trendu w systemie Eversense E3 i decyzje związane z leczeniem

Strzałki trendu w systemie Eversense E3 przedstawiają kierunek i szybkość zmian poziomu glukozy, aby poinformować pacjenta o zmianach stężenia glukozy. Należy skonsultować się z lekarzem w zakresie wykorzystywania strzałek trendów do podejmowania decyzji związanych z leczeniem. Jeśli strzałka jest skierowana w dół, pacjent może rozważyć przyjęcie mniejszej dawki insuliny. Jeśli strzałka trendu jest skierowana w górę, pacjent może przyjąć większą dawkę. Nie wolno przyjąć zbyt dużej ilości insuliny w krótkim czasie, ponieważ może to skutkować niskim poziomem glukozy z powodu przedawkowania insuliny. Poniżej przedstawiono strzałki Eversense E3 wraz z informacjami, jak je wykorzystać do podejmowania decyzji związanych z leczeniem. Należy skonsultować się z lekarzem w zakresie wprowadzania zmian w leczeniu na podstawie strzałek trendów. **Nie należy podejmować decyzji związanych z leczeniem z wykorzystaniem systemu CGM, jeśli strzałka nie jest wyświetlana.**

Strzałka trendu Eversense E3		Co oznacza	Niski poziom glukozy	Wysoki poziom glukozy	Glukoza w zakresie
Brak strzałki trendu		Brak wystarczającej ilości danych do obliczenia kierunku trendu lub szybkości zmian poziomu glukozy.	**Nawet jeśli poziom glukozy mieści się w zakresie, przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem należy przeprowadzić test za pomocą glukometru przy użyciu próbki krwi z opuszki palca.**		
	Poziom glukozy spada w szybkim tempie (> 2,0 mg/dl/ minuta).	Poziom glukozy mógł spaść o 30 mg/dl **lub więcej** w ciągu 15 minut.	Pacjent powinien przyjąć węglowodany i wziąć pod uwagę, czy przed chwilą nie zakończył ćwiczeń lub czy nie wziął zbyt dużej ilości insuliny.	Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien poczekać i często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem.	Pacjent powinien przyjąć węglowodany i wziąć pod uwagę, czy przed chwilą nie zakończył ćwiczeń lub czy nie wziął zbyt dużej ilości insuliny.
	Poziom glukozy spada w umiarkowanym tempie (od 1,0 do 2,0 mg/dl/ minuta).	Poziom glukozy może zmaleć do zakresu od 15 do 30 mg/dl w ciągu 15 minut.			

Strzałka trendu Eversense E3		Co oznacza	Niski poziom glukozy	Wysoki poziom glukozy	Glukoza w zakresie
	Poziom glukozy rośnie w szybkim tempie (> 2,0 mg/dl/ minuta).	Poziom glukozy mógł wzrosnąć o 30 mg/dl **lub więcej** w ciągu 15 minut.	Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien poczekać i często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem.	Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien poczekać i często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu. Jeśli pacjent nie przyjmował insuliny w ostatnim czasie i nie zamierza poćwiczyć, powinien rozważyć zwiększenie dawki insuliny.	Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien poczekać i często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem. Jeśli pacjent nie przyjmował insuliny ani nie zakończył ćwiczeń w ostatnim czasie, powinien rozważyć zwiększenie dawki insuliny.
	Poziom glukozy rośnie w umiarkowanym tempie (od 1,0 do 2,0 mg/dl/ minuta).	Poziom glukozy może wzrosnąć do zakresu od 15 do 30 mg/dl w ciągu 15 minut.			

Strzałka trendu Eversense E3		Co oznacza	Niski poziom glukozy	Wysoki poziom glukozy	Glukoza w zakresie
	Poziom glukozy zmienia się stopniowo (1,0 mg/dl/ minuta lub mniej).	Poziom glukozy może wzrosnąć lub spaść do 15 mg/dl w ciągu 15 minut.	Należy rozważyć przyjęcie węglowodanów. Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę, powinien często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu.	Jeśli pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien poczekać i często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu. Jeśli pacjent nie przyjmował insuliny w ostatnim czasie, powinien rozważyć zwiększenie dawki insuliny.	Bez leczenia – jeśli jednak pacjent niedawno przyjął insulinę lub ma zamiar poćwiczyć, powinien często sprawdzać wartość CGM oraz strzałkę trendu.


Co należy zrobić

Niniejszy rozdział pokazuje przykłady sytuacji, z którymi można się spotkać. Ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem za pomocą CGM, wziąć pod uwagę co się wydarzyło oraz co ma się wydarzyć. Należy dokładnie zapoznać się z tymi przykładami i zastanowić się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem. W przypadku braku pewności, przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem należy zawsze wykonać test za pomocą glukometru przy użyciu próbki krwi z opuszki palca.

Poziom glukozy znajduje się poniżej wartości docelowej wynoszącej 65, mg/dl lecz rośnie w sposób umiarkowany. Poziom glukozy może osiągnąć wartość 120 mg/dl w ciągu 30 minut.


Jest godzina 7:00, pacjent ma zamiar zjeść śniadanie i wypić niewielką ilość soku pomarańczowego po przebudzeniu.

- Czy pacjent powinien rozważyć przyjęcie nieco mniejszej dawki insuliny do posiłku niż zazwyczaj?
- Czy pacjent powinien przyjąć dawkę insuliny, którą przyjmuje zazwyczaj do śniadania i kontrolować wartość poziomu glukozy, strzałkę i swoje samopoczucie?

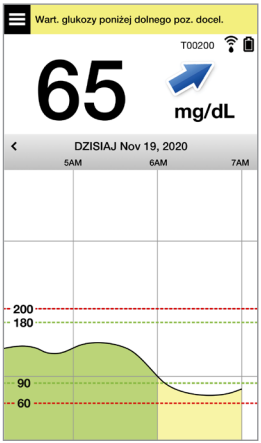

Jest godzina 9:00, pacjent przyjął insulinę do śniadania 2 godziny temu.


- Czy pacjent powinien poczekać i monitorować wartość poziomu glukozy oraz strzałkę przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem?
- Czy pacjent powinien rozważyć przyjęcie węglowodanów teraz, aby zwalczać niski poziom glukozy?

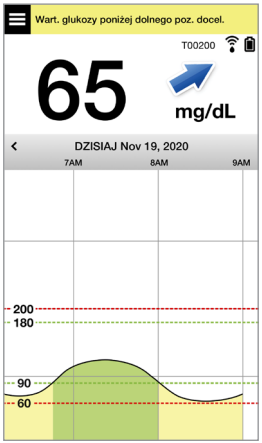

Poziom glukozy osiągnął wartość docelową wynoszącą 90 mg/dl, lecz szybko rośnie. Poziom glukozy może osiągnąć wartość 180 mg/dl lub większą w ciągu 45 minut.


Jest południe, pacjent zamierza zjeść obiad.

- Co może powodować wzrost poziomu glukozy?
- Czy pacjent powinien rozważyć przyjęcie większej dawki insuliny niż zazwyczaj do posiłku?
- Co zaleca lekarz w zakresie dostosowania dawki insuliny w takiej sytuacji?

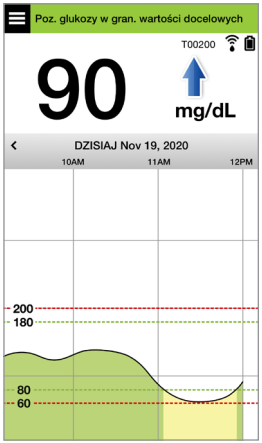

Jest godzina 14:00, około 90 minut temu pacjent przyjął insulinę do obiadu w nieco zwiększonej dawce z powodu strzałki szybkiego wzrostu.


- Biorąc pod uwagę to, że minęło zaledwie 90 minut od przyjęcia ostatniej dawki insuliny, czy pacjent powinien poczekać i monitorować wartość poziomu glukozy i strzałki trendów?
- Jaki odstęp między dawkami insuliny zalecił lekarz, aby uniknąć przedawkowania insuliny?

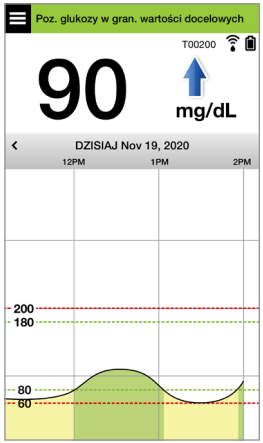

Poziom glukozy osiągnął wartość docelową wynoszącą 95 mg/dl, lecz szybko spada. Poziom glukozy może osiągnąć wartość 65 mg/dl lub mniejszą w ciągu 15 minut.


Pacjent zamierza poćwiczyć.

- Co może powodować gwałtowny spadek poziomu glukozy?
- Pacjent powinien rozważyć przekąskę, aby uniknąć niskiego poziomu glukozy.
- Pacjent powinien rozważyć opóźnienie treningu i poczekanie na stabilizację trendu i poziomu glukozy. Należy ściśle monitorować wartość poziomu glukozy, strzałkę trendu i swoje samopoczucie.

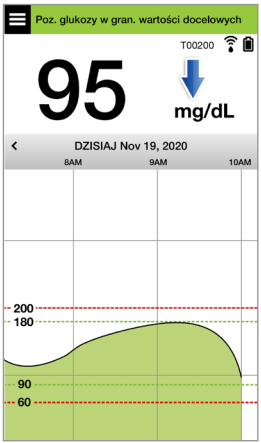

Pacjent właśnie skończył ćwiczyć.


- Co zaleca lekarz, aby nie dopuścić do wystąpienia niskiego poziomu glukozy po ćwiczeniu?
- Pacjent powinien rozważyć przekąskę, aby uniknąć niskiego poziomu glukozy.
- Należy ściśle monitorować wartość poziomu glukozy, strzałkę trendu i swoje samopoczucie.

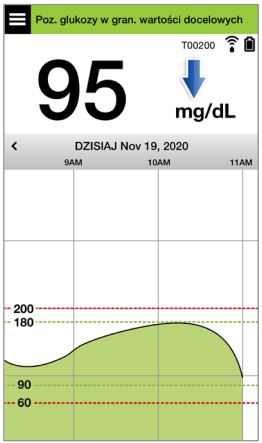

Poziom glukozy powyżej alertu wysokiego stężenia wynoszący 220 mg/dl zmienia się stopniowo. Poziom glukozy może spaść do wartości 190 mg/dl lub wzrosnąć do wartości 250 mg/dl w ciągu 30 minut.


Jest godzina 19:00, pacjent zamierza zjeść kolację. Minęło 6 godzin od przyjęcia ostatniej dawki insuliny do obiadu.

- Co może powodować tak wysoki poziom glukozy po upłynięciu dużej ilości czasu od ostatniego posiłku?
- Czy pacjent miał stresujący dzień albo nie ma dobrego samopoczucia?
- Czy pacjent powinien rozważyć zwiększenie dawki insuliny lub przyjęcie mniejszej ilości węglowodanów do tego posiłku niż zazwyczaj?

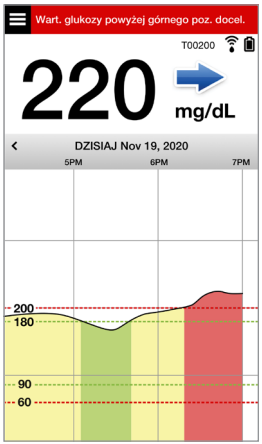

Jest godzina 22:00, pacjent zamierza położyć się do łóżka. Od przyjęcia ostatniej dawki insuliny minęły dwie i pół godziny.

- Co może powodować wysoki poziom glukozy?
- Ile czasu zajmuje obniżenie poziomu glukozy po przyjęciu insuliny?
- Jaką wartość poziomu glukozy przed snem zaleca lekarz?
- Jakie kroki w zakresie leczenia są zazwyczaj podejmowane przez pacjenta w przypadku wysokiego poziomu glukozy w porze snu?

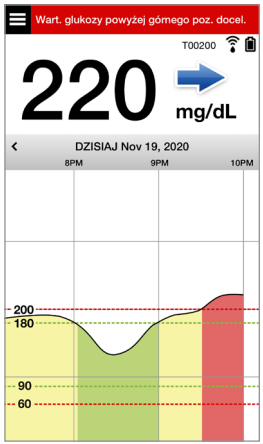


Należy pamiętać, że w przypadku braku pewności zaleca się wykonanie testu za pomocą glukometru przy użyciu próbki krwi z opuszki palca przed podjęciem decyzji związanej z leczeniem.

Wykres trendu

Wykres trendu służy do wyświetlania i analizowania danych historycznych oraz trendów wartości stężenia glukozy w czasie. Wyświetla również symbole dotyczące zdarzeń zarejestrowanych w aplikacji ręcznie (np. testy kalibracyjne i ćwiczenie).

Wykresu trendu można użyć na kilka sposobów:

- Do szybkiego przeglądania bieżącego stanu poziomu glukozy w stosunku do ustawionych poziomów alertów i docelowych. Czerwone linie przerywane pokazują alerty wysokiego i niskiego poziomu glukozy, a zielone linie przerywane pokazują wartości docelowe wysokiego i niskiego poziomu glukozy.
- Obszary cieniowane wykresu są oznaczone kolorami, w zależności od wprowadzonego ustawienia glukozy:
  - Wartości glukozy, które znajdują się ***poza poziomami alertów glukozy***, zostaną oznaczone na czerwono.
  - Wartości glukozy, które mieszczą się ***między poziomami alertów glukozy***, zostaną oznaczone na zielono.
  - Wartości glukozy, które znajdują ***między poziomami docelowymi i poziomami alertów glukozy***, zostaną oznaczone na żółto.

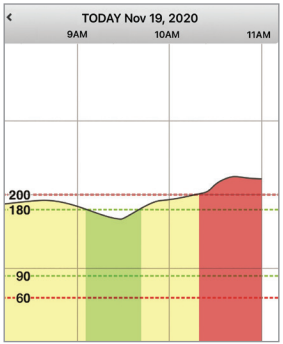

- Wybierz i przytrzymaj dowolny punkt czasowy linii wykresu, aby zobaczyć odpowiadające mu wskazanie stężenia glukozy.
- Wybierz dowolny znak na ekranie aplikacji, aby uzyskać więcej informacji o danym zdarzeniu lub alercie.
- Można przybliżyć lub oddalić ekran gestami, aby zmienić zakres wyświetlanych dni/godzin wykresu trendu. Można powiększyć lub zmniejszyć ekran, aby zmienić zakres wyświetlanych danych od 3 godzin do 3 dni.

- Aby zobaczyć dane wykresu trendu dla innej daty lub godziny, należy wybrać datę na ekranie i wprowadzić żądaną datę.
- Można przeglądać wykres trendu w pionie i w poziomie. W poziomie dostępne są skróty do widoku danych za ostatnie 7, 14, 30 lub 90 dni.

Uwaga: Wszystkie dane dotyczące poziomu glukozy będą przechowywane w aplikacji, w dostępnej pamięci urządzenia przenośnego.

Opcje menu

Ikona Menu (☰) pojawia się w lewym górnym rogu wszystkich ekranów aplikacji i ułatwia przechodzenie między jej funkcjami. Są dostępne następujące opcje menu:

Opcje menu		Opis
	Moja glukoza	Ekran główny aplikacji, który pokazuje bieżący odczyt CGM, kierunek i szybkość zmian, wykres trendu, zdarzenia i alerty.
	Kalibruj	Wpisz wartości kalibracji pozyskane za pomocą glukometru przy użyciu próbki krwi z opuszki palca.
	Historia alertów	Umożliwia przeglądanie historycznych alertów i powiadomień. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Opisy alertów*.
	Dziennik zdarzeń	Umożliwia wprowadzenie informacji o zdarzeniach, takich jak: wartości poziomu glukozy, posiłki, podanie insuliny, stan zdrowia i ćwiczenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Dziennik zdarzeń*.
	Raporty	Umożliwia przeglądanie raportów wygenerowanych na podstawie danych CGM. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Raporty*.
	Udostępnij moje dane	Umożliwia innym wyświetlenie danych dotyczących glukozy poprzez aplikację mobilną Eversense NOW.

Opcje menu		Opis
	**Przewodnik umieszczania**	Umożliwia sprawdzenie łączności między inteligentnym nadajnikiem i czujnikiem. Ekran ten używany jest podczas mocowania inteligentnego nadajnika nad czujnikiem w celu zapewnienia jego prawidłowego umieszczenia.
	**Połącz**	Umożliwia nawiązanie lub sprawdzenie połączenia między inteligentnym nadajnikiem i urządzeniem przenośnym. Połączenie Bluetooth jest wymagane do przesyłania danych do aplikacji mobilnej.
	**Ustawienia**	Umożliwia dostosowanie ustawień, takich jak poziomy docelowe glukozy, poziomy alertów, dźwięki i profil tymczasowy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Dostosowywanie ustawień*.
	**Informacje**	Umożliwia wyświetlenie informacji o systemie CGM, łącznie z numerami identyfikacyjnymi czujnika i inteligentnego nadajnika. Pozwala na zmianę lub usunięcie zdjęcia profilowego i wylogowanie się z aplikacji.

8. Dostosowywanie ustawień

Rozdział opisuje sposób personalizowania ustawień systemu Eversense E3 CGM.

Obszary, których ustawienia można dostosować, to:

- **Glukoza –** poziomy glukozy i wskaźniki zmiany, które wygenerują alert.
- **Przypomnienia o kalibracji –** opcjonalnie można ustawić czasy przypomnienia o kalibracji.
- **System –** identyfikuje lub pozwala wprowadzić spersonalizowane informacje o systemie.
- **Ustawienia dźwięku –** umożliwiają zmianę dźwięków dla niektórych alertów glukozy, ustawienie czasów drzemki i trybu „Nie przeszkadzać".
- **Profil tymczasowy –** ustawia profil tymczasowy glukozy.

Poziomy glukozy

System Eversense E3 CGM umożliwia przesyłanie alertów do inteligentnego nadajnika i urządzenia przenośnego po przekroczeniu ustawionych alertów poziomu glukozy. Pacjent wprowadza ustawienia poziomów alertów oraz wartości docelowych oraz szybkość zmian poziomu glukozy na podstawie danych ustalonych z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenie: **Alerty wysokiego i niskiego stężenia glukozy mają pomóc użytkownikowi systemu w kontrolowaniu cukrzycy i nie powinny być używane wyłącznie do wykrywania hiperglikemii bądź hipoglikemii. Interpretacja alarmów zawsze powinna odbywać się w powiązaniu z pozostałymi danymi związanymi z: poziomem glukozy, trendem wykresem liniowym itp.**

WAŻNE:

- **Wartości alertów wysokiego i niskiego stężenia glukozy są inne od niskich i wysokich wartości docelowych.**
  - **Wartości alertów niskiego i wysokiego poziomu glukozy są wyświetlane na urządzeniu przenośnym i inteligentnym nadajniku po osiągnięciu określonej wartości: niskiej lub wysokiej.**
  - **Wartości docelowe poziomu glukozy są wykorzystywane w raportach i wykresach liniowych raz wskazują stan glukozy w porównaniu ze stanem docelowym. Po osiągnięciu poziomów docelowych poziomu glukozy użytkownik nie otrzymuje żadnych alertów.**
  - **Alerty niskiej i wysokiej wartości przewidywanej powiadamiają użytkownika na urządzeniu przenośnym i nadajniku inteligentnym, kiedy poziom glukozy prawdopodobnie osiągnie ustawione poziomy alertu niskiego i wysokiego poziomu glukozy.**

Na ekranie **Ustawienia glukozy** dotknij „symboli karatów” ⌄, aby rozwinąć i zwinąć opcje ustawień.



Ustawianie poziomów alertów glikemii


System Eversense E3 CGM alarmuje użytkownika o przekroczeniu ustawionych przez niego poziomów glukozy. Po przekroczeniu niskiego i wysokiego poziomu glukozy inteligentny nadajnik wibruje a aplikacja mobilna emituje alert dźwiękowy i wyświetla komunikat na ekranie.

Ustawienie domyślne	Niski: 65 mg/dl Wysoki: 250 mg/dl Wartości poziomów alertów ustalane są z pracownikiem służby zdrowia. Tylko i wyłącznie na tej podstawie użytkownik może wprowadzić odpowiednie dane. Wartość progowa alertu niskiego poziomu glukozy nie może być wyższa od wartości docelowej niskiego poziomu glukozy, zaś wartość progowa alertu wysokiego poziomu glukozy nie może być niższa od wartości docelowej wysokiego poziomu glukozy.
Ustawienie dopuszczalne	Niski: 60–115 mg/dl Wysoki: 125–350 mg/dl
Włączanie/wyłączanie ustawienia	Ustawienie alertu niskiego poziomu glukozy jest zawsze WŁ. Ustawienie alertu wysokiego poziomu glukozy można włączyć i wyłączyć. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, na inteligentnym nadajniku nie będą wyświetlane alerty wysokiego poziomu glukozy i nie będzie też generowana wibracja.
Notatki	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika odczuwalne na ciele użytkownika systemu.


WAŻNE:


- Ustawione poziomy alertów niskiego i wysokiego poziomu glukozy to te same poziomy, które są wykorzystywane do generowania alertów przewidywania. Patrz punkt *Ustawienia alertów przewidywania*.
- W przypadku systemu iOS w wersji 12 lub nowszej oraz Android w wersji 6 lub nowszej można zezwolić na nadpisywanie ustawień urządzenia przenośnego przez alerty Niski poziom glukozy i Poza zakresem niskiego stężenia glukozy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Ustawienia dźwięku*.

1. Dotknij **Menu** > **Ustawienia** > **Glukoza**, aby wyświetlić ekran **USTAWIENIA GLUKOZY**.

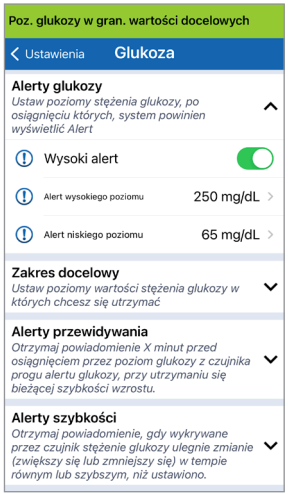

2. W polu **Poziomy alertu wartości glukozy** dotknij **Wysoki alert** i ustaw odpowiedni poziom alertu wysokiego poziomu glukozy.
   - Po zakończeniu dotknij **OK**.
   - Powtórz ten etap, aby dokonać wyboru **Niski alert**.

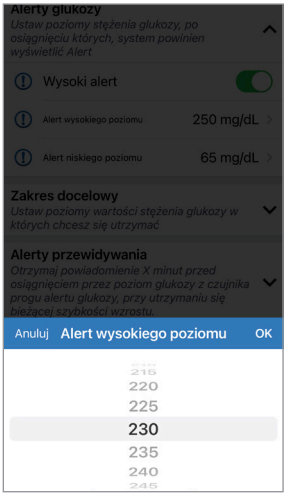

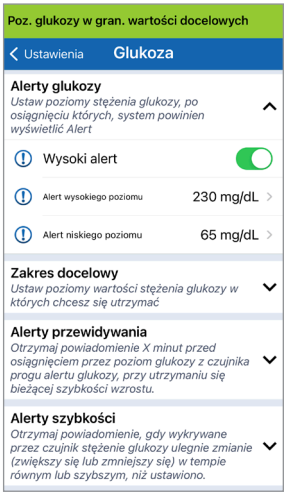


Ustawianie poziomów docelowych poziomu glukozy


Wartości docelowe stężenia glukozy to niskie i wysokie wartości progowe zakresu wskazanego dla użytkownika. Ustawienia wykorzystywane są przez aplikację do wskazania, czy zmierzone wartości poziomu glukozy mieszczą się w zakresie wartości docelowych.


Ustawienie domyślne	Niski: 70 mg/dl Wysoki: 180 mg/dl Wartości poziomów docelowych ustalane są z pracownikiem służby zdrowia, tylko i wyłącznie na tej podstawie pacjent może wprowadzić odpowiednie dane.
Ustawienie dopuszczalne	Niski: 65–120 mg/dl Wysoki: 120–345 mg/dl
Włączanie/wyłączanie ustawienia	Zawsze włączone (nie można go wyłączać)
Notatki	Używane w wykresach i tabelach aplikacji w celu przedstawienia czasu, przez jaki poziom glukozy mieścił się w zakresie docelowym.

1. Dotknij **Menu** > **Ustawienia** > **Glukoza**, aby wyświetlić ekran **USTAWIENIA GLUKOZY**.

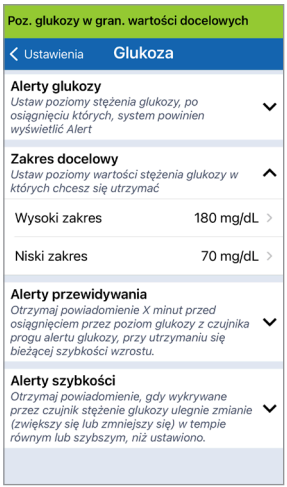

2. W polu **Poziomy wysokiego zakresu glukozy** dotknij **Wysoki zakres** i ustaw odpowiedni poziom wysokiego zakresu glukozy.
   - Po zakończeniu dotknij **OK**.
   - Powtórz ten etap, aby dokonać wyboru **Niski zakres**.

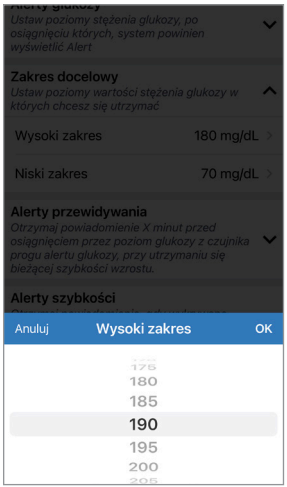

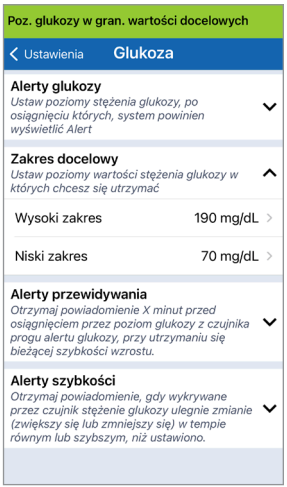


Ustawianie alertów przewidywania

Alerty przewidywania informują z wyprzedzeniem o prawdopodobnym wystąpieniu wysokiego lub niskiego poziomu glukozy w przypadku kontynuacji bieżącego trendu.

Alerty przewidywania wykorzystują ustawione wcześniej wartości wysokiego i niskiego poziomu glukozy do wczesnego ostrzegania użytkownika systemu. Należy ustawić czas wczesnego ostrzeżenia (10, 20 lub 30 minut), aby ostrzegał użytkownika przed osiągnięciem poziomów alertu, na podstawie aktualnych trendów glukozy. Po upłynięciu czasu wczesnego ostrzeżenia inteligentny nadajnik wibruje, zaś mobilna aplikacja emituje alert dźwiękowy i wyświetla komunikat na ekranie.


Ustawienie domyślne	WYŁ.
Ustawienie dopuszczalne	Z wyprzedzeniem 10, 20 lub 30 minut
Włączanie/wyłączanie ustawienia	Te alerty można włączyć i wyłączyć. Jeżeli funkcja nie zostanie włączona, alerty przewidywania nie będą generowane. Wartość domyślna to 20 minut.
Notatki	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika odczuwalne na ciele użytkownika systemu.


1. Aby włączyć opcję, dotknij **Menu > Ustawienia > Glukoza**, aby wyświetlić ekran **USTAWIENIA GLUKOZY**.

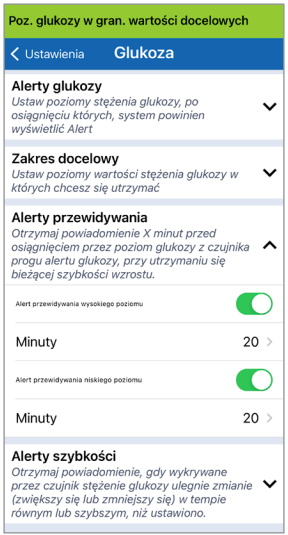

2. Obok pola **Alerty przewidywania wysokiego i niskiego poziomu glukozy** przesuń przycisk **WYŁ.** do **WŁ.**

3. Dotknąć **Minuty**, aby wybrać liczbę minut ostrzeżenia wyprzedzenia
   - Po zakończeniu dotknij **OK**.

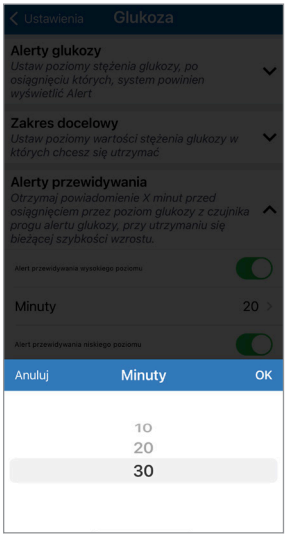

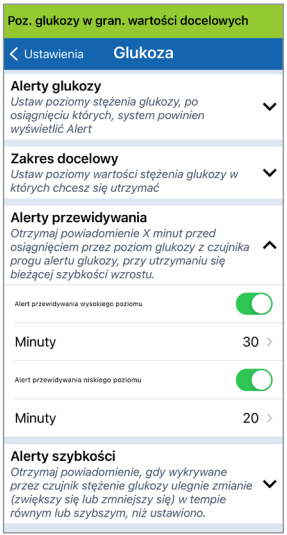


Ustawianie alertów o szybkości zmian

Alerty o szybkości zmian informują, czy stężenie glukozy spada lub rośnie szybciej, niż wynosi wartość ustawienia alertu szybkości zmian.


Ustawienie domyślne	WYŁ.
Ustawienie dopuszczalne	1,5–5 mg/dl na minutę
Włączanie/wyłączanie ustawienia	Te alerty można włączyć i wyłączyć. Jeżeli funkcja nie zostanie włączona, alerty szybkości zmian nie będą generowane.
Notatki	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika.


1. Aby włączyć opcję, dotknij **Menu** > **Ustawienia** > **Glukoza**, aby wyświetlić ekran **USTAWIENIA GLUKOZY**.

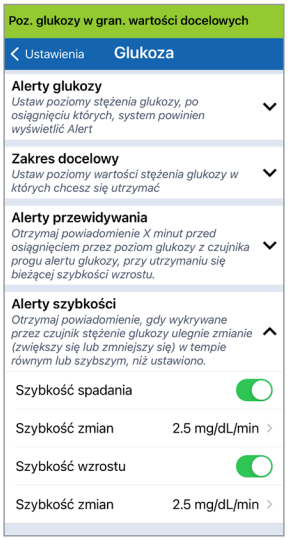

2. Obok pola **Alerty szybkości** przesuń przycisk **WYŁ.** do **WŁ.**

3. Dotknij **Szybkość zmian**, aby wybrać szybkość.
   - Po zakończeniu dotknij **OK**.

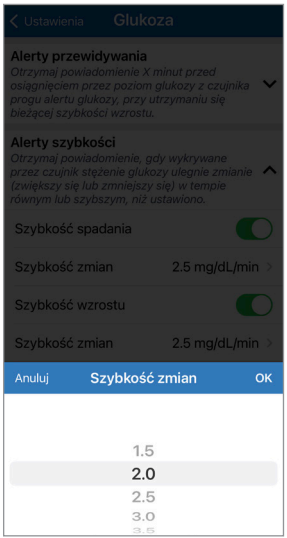

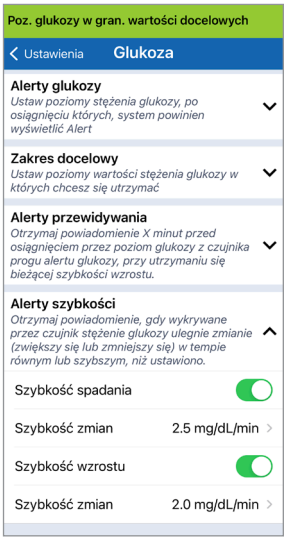

Ustawianie przypomnień o dziennej kalibracji

Opcjonalnie można ustawić przypomnienia o kalibracji w najwygodniejszych dla siebie porach. Użytkownik otrzyma wygenerowane przez system powiadomienia o kalibracji i alerty.

Ustawienie domyślne	WYŁ.
Ustawienie dopuszczalne	Pora dnia w przyrostach co 1 minutę
Włączanie/wyłączanie ustawienia	Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć. Jeżeli funkcja zostanie włączona, będą wyświetlane powiadomienia.
Notatki	Można ustawić jedno lub dwa dzienne przypomnienia. Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne tylko na ekranie telefonu – bez wibracji nadajnika. Jeśli użytkownik usunie aplikację mobilną i zainstaluje ją ponownie, te przypomnienia należy zresetować. Te przypomnienia nie są przechowywane w historii alertów. Jeśli sparuje się nowy nadajnik z istniejącą aplikacją, ustawienia pozostaną niezmienione. Patrz *„Nie przeszkadzać" w aplikacji Eversense i urządzeniach przenośnych*, aby uzyskać więcej informacji.

Ustawianie informacji o systemie

Ekran **SYSTEM** umożliwia przeglądanie i edytowanie innych ustawień w systemie Eversense E3 CGM.

1. **Dotknij Menu > Ustawienia > System, aby wyświetlić ekran SYSTEMS.**



2. **Na ekranie SYSTEMY można dotknąć każdej z opcji, aby ustawić:**

   - **Jednostki stężenia glukozy.** Jednostka miary odczytów stężenia glukozy. Aby edytować to ustawienie, należy ponownie zainstalować aplikację.
   - **Nazwa.** Numer seryjny inteligentnego nadajnika. Można wybrać wyświetlany numer seryjny i nadać nadajnikowi własną nazwę.
   - **Połączony czujnik.** Numer seryjny czujnika połączonego obecnie z inteligentnym nadajnikiem. Można dotknąć tej opcji, aby uzyskać dostęp do funkcji łączenia lub ponownego łączenia czujnika.

Ponownie łączenie czujnika


WAŻNE: Nie łączyć ponownie czujnika, chyba że zaleci to obsługa klienta. Ponowne połączenie czujnika powoduje powrót systemu do fazy inicjalizacji, która wymaga 4 kalibracji poziomu glukozy we krwi w badaniu z opuszki palca w ciągu 36 godzin.

1. Upewnij się w dziale obsługi klienta, czy należy ponownie połączyć czujnik.


2. Dotknij opcji **Połączony czujnik**.




3. Dotknij **Ponownie połącz wykryty czujnik.**

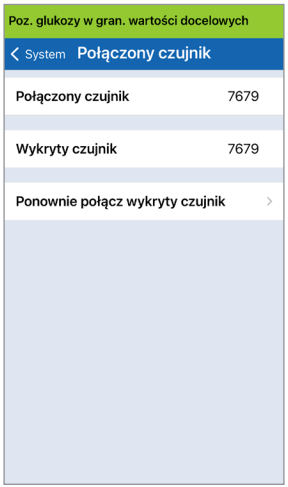


4. Dotknij **Anuluj** lub **OK**, aby kontynuować.




5. Dotknąć **Anuluj** lub **Ponownie połącz.**




6. Rozpocznie się proces łączenia. Po zakończeniu każdego etapu zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia. Proces łączenia trwa do 10 minut. NIE WOLNO zdejmować inteligentnego nadajnika znad miejsca wszczepienia czujnika do czasu wyświetlenia trzeciego symbolu zaznaczenia.

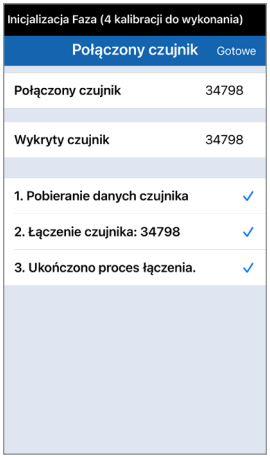



W przypadku zdjęcia inteligentnego nadajnika z miejsca wszczepienia czujnika system wyświetli powiadomienie.

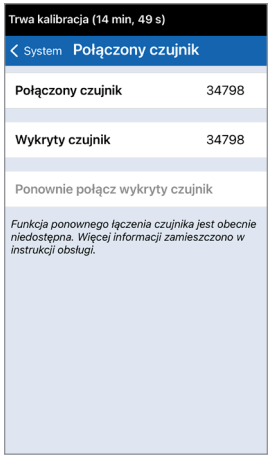


Uwaga: Przycisk ponownego łączenia nie będzie dostępny w następujących sytuacjach:

- Bateria inteligentnego nadajnika wymaga ładowania lub jest rozładowana.
- Kalibracja jest w toku.
- Przed połączeniem czujnika.
- Pewne alerty dotyczące wymiany czujnika.
- Jeśli którykolwiek z poniższych alertów jest aktywny:
  - Koniec okresu eksploatacji nadajnika
  - Błąd godziny w systemie
  - Czujnik wstrzymany


Ustawianie dźwięków

Ekran **USTAWIENIA DŹWIĘKU** wyświetla ustawienia dźwięku alertów dla niskiego i wysokiego poziomu glukozy. Ten ekran umożliwia również wprowadzenie ustawienia drzemki dla wymienionych alertów oraz opcję ustawienia alertów niskiego poziomu glukozy i poziomu poza zakresem, aby zastąpić ustawienia dźwięku telefonu (iOS 12 i nowsze oraz Android 6 i nowsze).

1. **Dotknij Menu > Ustawienia > Ustawienia dźwięku, aby wyświetlić ekran USTAWIENIA DŹWIĘKU.**

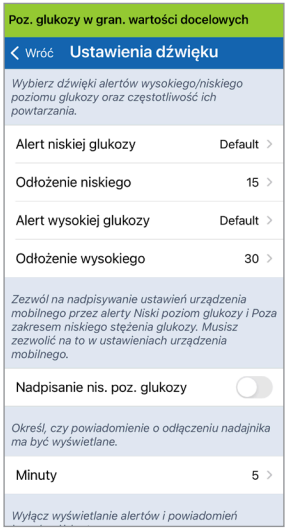

2. **Dotknij każdy alert, aby wybrać dźwięk alertu. Dotknij Wróć, aby powrócić do ekranu USTAWIENIA DŹWIĘKU.**

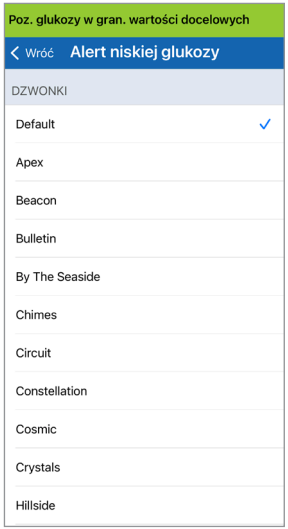


WAŻNE: należy się upewnić, że dźwięk w urządzeniu przenośnym jest włączony. Jeżeli dźwięk w urządzeniu przenośnym będzie wyłączony, dźwięk alertu generowanego przez aplikację nie zostanie wyemitowany.

Ustawiając częstotliwość powtarzania alertów, można wybrać częstotliwość powtarzania alertu niskiego lub wysokiego poziomu glukozy.

3. Wybierz każdą z opcji powtarzania alertu, aby ustawić jej częstotliwość.

- Po zakończeniu dotknij **OK**.

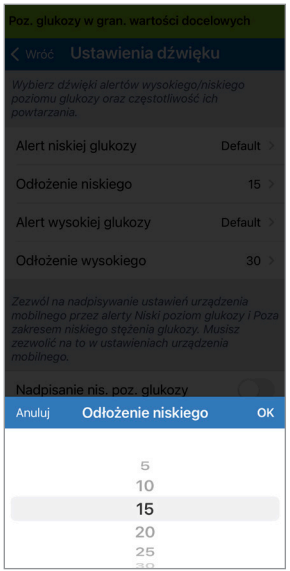


Ustawienie Nadpisanie nis. poz. glukozy


Jeśli na urządzeniu przenośnym działa system iOS 12 lub nowszy lub Android 6 lub nowszy, można opcjonalnie zezwolić, aby alerty niskiego poziomu glukozy i poza zakresem niskiego stężenia glukozy w systemie Eversense zawsze zastępowały ustawienia dźwięku urządzenia przenośnego. Po włączeniu alerty niskiego poziomu glukozy i poza zakresem niskiego stężenia glukozy będą odtwarzane przy maksymalnej głośności telefonu. Nie można zmienić poziomu dźwięku dla tego ustawienia nadpisania. Sprawia to, że użytkownik będzie nadal otrzymywał alerty niskiego poziomu glukozy i poza zakresem niskiego stężenia glukozy w telefonie, nawet jeśli w telefonie włączony jest tryb cichy lub opcja „Nie przeszkadzać". Należy to włączyć w ustawieniach urządzenia przenośnego.

Urządzenia iOS

1. Dotknij przycisku, aby włączyć nadpisywanie.

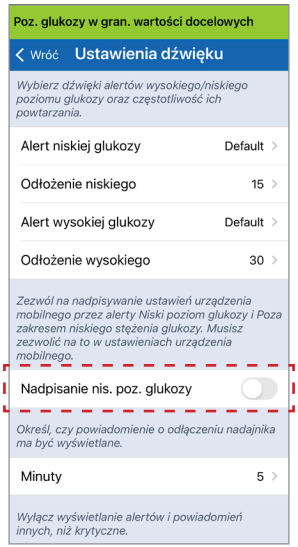

2. Dotknij **Ustawienia**.




3. Dotknij **Pozwalaj**.



4. Przełącznik nadpisania nis. poz. glukozy może teraz zostać włączony.


System będzie teraz ostrzegał użytkownika o alertach niskiego poziomu glukozy i poza zakresem niskiego stężenia glukozy przy maksymalnej głośności, nawet jeśli w urządzeniu firmy Apple włączony jest tryb cichy/wibracyjny lub tryb „Nie przeszkadzać".

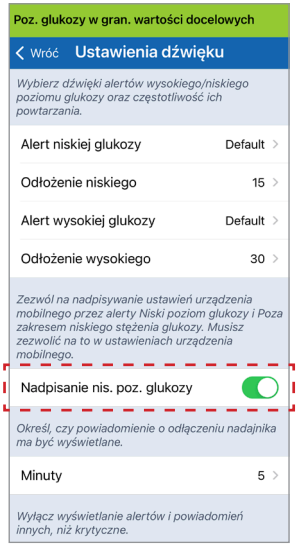



Uwaga: Ta funkcja działa podobnie do aplikacji z funkcją budzika, która zawsze wyemituje dźwięk, niezależnie od ustawień dźwięku telefonu.

Uwaga: jeśli dotkniesz **Nie zezwalaj** na etapie 3, nie można włączyć ustawienia Nadpisanie nis. poz. glukozy. Aby włączyć to ustawienie innym razem, po dotknięciu **Ustawienia** na etapie 2, zostaną wyświetlone ustawienia Eversense na stronie urządzenia przenośnego. Dotknij **Powiadomienia > Alerty krytyczne.** Następnie można włączyć opcję Nadpisanie nis. poz. glukozy w aplikacji Eversense.



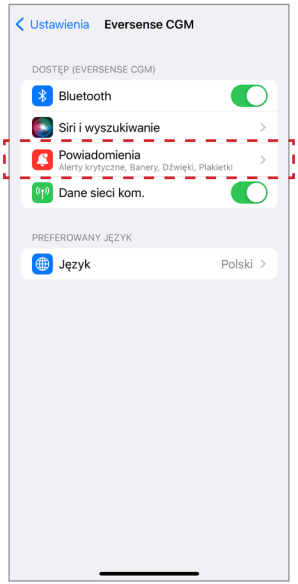

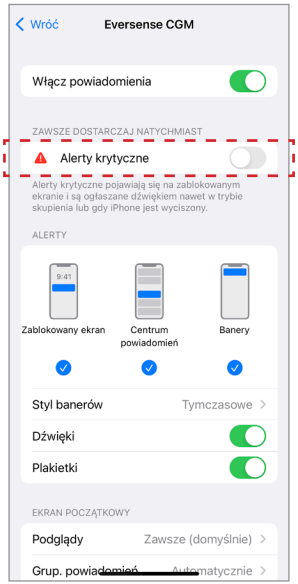


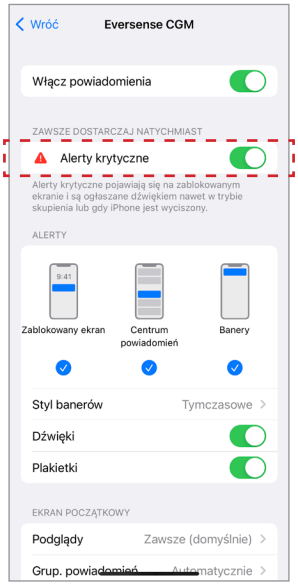


Urządzenia z systemem Android

W przypadku urządzeń z systemem Android 6 i nowszym:


1. Dotknij przycisku, aby włączyć nadpisywanie.

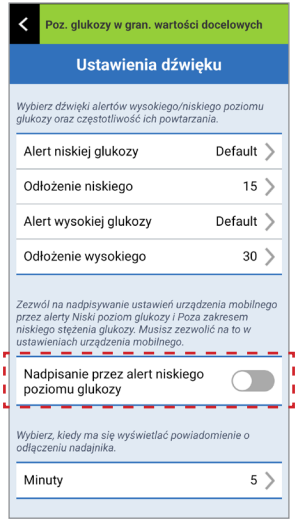


2. Dotknij **Ustawienia**.




3. Na stronie dostępu do opcji Nie przeszkadzać dotknij Eversense.

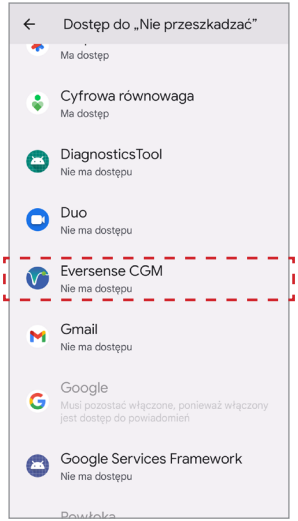

4. Dotknij **Zezwól**.




5. Dotknij przycisku obok Eversense, aby umożliwić aplikacji Eversense pominięcie ustawień Nie przeszkadzać.

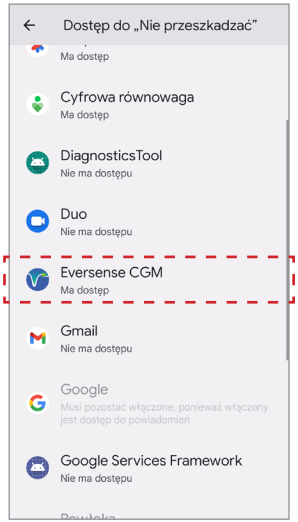

6. **Wróć do aplikacji mobilnej Eversense CGM.**


7. **Dotknij przełącznika Nadpisanie nis. poz. glukozy, aby włączyć alarmy niskiego poziomu glukozy i poza zakresem niskiego poziomu glukozy przy maksymalnej głośności, nawet jeśli w urządzeniu jest włączony tryb cichy, tryb wibracji lub tryb „Nie przeszkadzać”.**

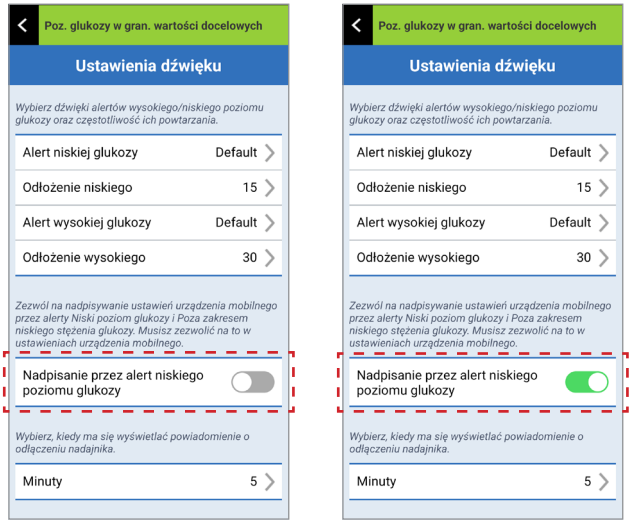

Uwaga: Ta funkcja działa podobnie do aplikacji z funkcją budzika, która zawsze wyemituje dźwięk, niezależnie od ustawień dźwięku telefonu.

Ustawienie „Nadajnik odłączony”


Może się zdarzyć, że połączenie Bluetooth między inteligentnym nadajnikiem a urządzeniem przenośnym zostanie przerwane. Może to być spowodowane tym, że urządzenia są poza zasięgiem, bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana lub funkcja Bluetooth jest wyłączona w ustawieniach telefonu. Można dostosować czas, po jakim system powiadomi o przerwie w komunikacji. Można ustawić czas ostrzegania od 5 do 30 minut po utracie połączenia. W przypadku braku komunikacji między inteligentnym nadajnikiem a aplikacją będziesz otrzymywać tylko alerty wibracyjne z inteligentnego nadajnika. Tryb „Nie przeszkadzać”, patrz kolejny punkt.

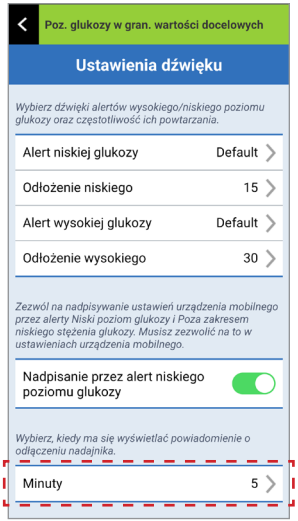

Ekran **USTAWIENIA DŹWIĘKU** umożliwia również włączenie i wyłączenie trybu „Nie przeszkadzać”.

- **Nie przeszkadzać.** Włącza tryb „Nie przeszkadzać” w aplikacji i na urządzeniu przenośnym.
- **WYŁ.** – WSZYSTKIE powiadomienia – alerty i powiadomienia – niezależnie od statusu krytycznego będą generowane przez inteligentny nadajnik i aplikację.
- **WŁ.** – aplikacja i inteligentny nadajnik będą wysyłać TYLKO krytyczne alerty i powiadamiać o nich przez wibracje odczuwalne na ciele pacjenta.

Uwaga: po włączeniu trybu „Nie przeszkadzać” na urządzeniu przenośnym użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych alertów ani powiadomień z aplikacji Eversense. Ikona DND pojawi się na ekranie głównym. Lista alertów, patrz *Opisy alertów*.

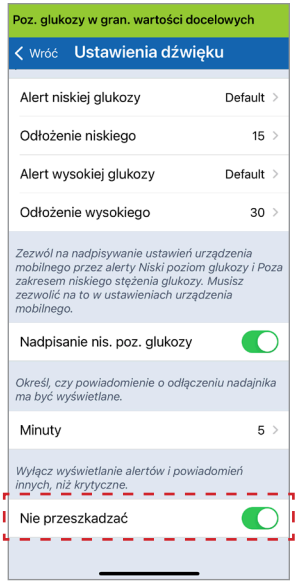

„Nie przeszkadzać” w aplikacji Eversense i urządzeniach przenośnych

	DND w aplikacji Eversense wył.; DND w urządzeniu przenośnym wył.	DND w aplikacji Eversense wł.; DND w urządzeniu przenośnym wył.	DND w aplikacji Eversense wył.; DND w urządzeniu przenośnym wł.	DND w aplikacji Eversense wł.; DND w urządzeniu przenośnym wł.
Wibracje nadajnika (niekrytyczne alerty i powiadomienia)	Tak	Nie	Tak	Nie
Wyświetlacz aplikacji Eversense, dźwięk telefonu i wibracja telefonu (niekrytyczne alerty i powiadomienia)	Tak	Nie	Nie	Nie
Wibracja nadajnika (alerty krytyczne)	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyświetlacz aplikacji Eversense, dźwięk telefonu i wibracja telefonu (alerty krytyczne)	Tak	Tak	Nie	Nie


	DND w aplikacji Eversense wył.; DND w urządzeniu przenośnym wył.	DND w aplikacji Eversense wł.; DND w urządzeniu przenośnym wył.	DND w aplikacji Eversense wył.; DND w urządzeniu przenośnym wł.	DND w aplikacji Eversense wł.; DND w urządzeniu przenośnym wł.
Przypomnienia o kalibracji (powiadomienie telefonu)	Tak	Tak	Nie	Nie
Alert niskiej glukozy (włączona funkcja nadpisania)	Tak	Tak	Tak	Tak

WAŻNE: w przypadku niektórych systemów operacyjnych telefonów można zezwolić na nadpisywanie ustawień urządzenia przenośnego przez alerty Niski poziom glukozy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Ustawienia dźwięku*.


Ustawianie profilu tymczasowego

W przypadku czynności lub warunków wykraczających poza rutynowe można ustawić wartości glukozy inne od standardowych wartości wprowadzonych do aplikacji. Ekran **PROFIL TYMCZASOWY** umożliwia tymczasową zmianę zakresu glukozy i ustawienia alertów na wybrany czas. Po upływie czasu trwania profilu tymczasowego automatycznie wznowione zostaną standardowe ustawienia glukozy, wprowadzone w **Ustawienia** > **Glukoza**.


1. **Dotknij Menu > Ustawienia > Profil tymczasowy, aby wyświetlić ekran PROFIL TYMCZASOWY.**

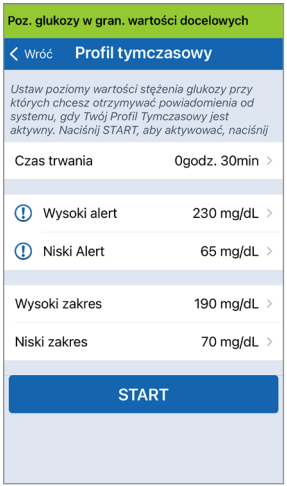


2. **Wybierz czas obowiązywania profilu. Czas obowiązywania profilu tymczasowego możesz ustawić na maksymalnie 36 godzin, z przyrostami co 30 minut.**

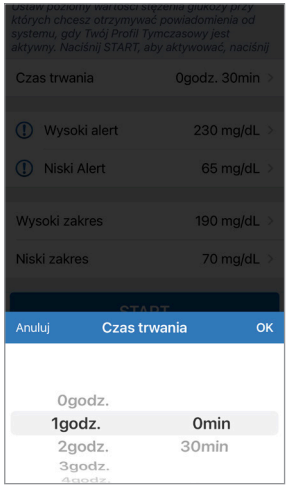

3. Ustaw pożądane alerty wysokiego i niskiego poziomu oraz wysoki i niski zakres. Dotknij **START**.

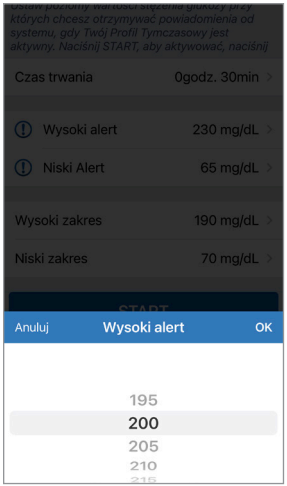


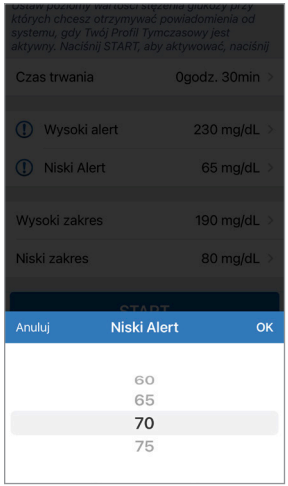

W trakcie obowiązywania profilu tymczasowego tych wartości nie będzie można zmienić.


Kiedy profil tymczasowy jest aktywny, na ekranie **MOJA GLUKOZA** wyświetlana jest ikona profilu tymczasowego.

Ikona profilu tymczasowego

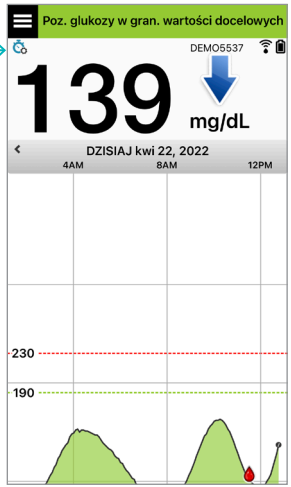


8

Po upływie czasu trwania profilu tymczasowego aplikacja wyświetla powiadomienie, a następnie ikona profilu tymczasowego nie jest już wyświetlana na ekranie **MOJA GLUKOZA**.



Aby zakończyć profil tymczasowy przed upływem ustawionego czasu, należy przejść do **Ustawienia** > **Profil tymczasowy** i dotknąć **STOP**.

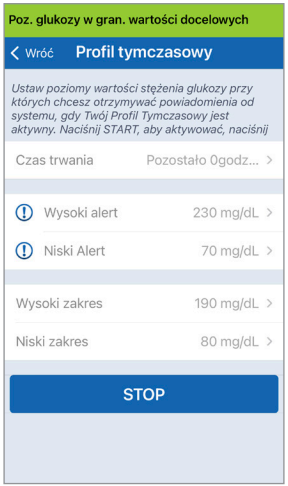

9. Opisy alertów

Rozdział opisuje różne komunikaty alertów i powiadomień wyświetlane na ekranie aplikacji Eversense wraz z opisem postępowania.

System Eversense CGM generuje alerty i powiadomienia odnoszące się do odczytów poziomu glukozy, stanu systemu zarówno w inteligentnym nadajniku oraz w urządzeniu przenośnym. Inteligentny nadajnik generuje alerty wibracyjne odczuwane na ciele użytkownika systemu po osiągnięciu ustawionej wartości progowej danego alertu. Aplikacja urządzenia przenośnego emituje alert dźwiękowy i wyświetla komunikaty na ekranie **MOJA GLUKOZA**. Tabela opisuje wzory wibracji generowanych przez inteligentny nadajnik oraz wskaźniki w aplikacji mobilnej.

Alerty i powiadomienia.	Wzór wibracji inteligentnego nadajnika	Wskaźniki alertów w aplikacji
Alerty informujące o braku możliwości wyświetlenia wartości poziomu glukozy W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	3 długie wibracje	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**
Ostrzeżenie o niskim poziomie glukozy W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	3 krótkie wibracje x 3	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**
Alert niskiej wartości przewidywanej lub niskiego poziomu glukozy poza zakresem W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	3 krótkie wibracje	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**

Alerty i powiadomienia.	Wzór wibracji inteligentnego nadajnika	Wskaźniki alertów w aplikacji
Alerty odnoszące się do odczytów wysokiego poziomu glukozy Alert wysokiego poziomu glukozy, wysokiej wartości predykcyjnej lub wysokiego poziomu poza zakresem. W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	1 długa wibracja i 2 krótkie wibracje	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**
Alerty odnoszące się do mniej krytycznych sytuacji Wymagają reakcji, ale nie muszą mieć charakteru krytycznego. Przykłady podano w kolejnym rozdziale.	1 krótka wibracja	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**
Alert o konieczności naładowania inteligentnego nadajnika Bateria inteligentnego nadajnika wyczerpuje się i należy ją naładować.	3 krótkie wibracje i 1 długa wibracja x 2	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE ŻÓŁTYM**
Powiadomienia Wymagają reakcji, ale nie mają charakteru krytycznego. Przykłady podano w kolejnym rozdziale.	1 krótka wibracja	**KOMUNIKAT WYŚWIETLANY W KOLORZE NIEBIESKIM**

Historia alertów

Ekran **HISTORIA ALERTÓW** wyświetla alerty i powiadomienia otrzymane przez użytkownika.

Wagę danego komunikatu wskazują następujące ikony.


Alerty



Powiadomienia


Alerty związane z glukozą


Alerty baterii


Uwaga: Kiedy użytkownik otrzyma 2 lub więcej alertów, które nie zostały potwierdzone, aplikacja wyświetli opcję **Odrzuć wszystkie**. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy urządzenie przenośne było poza zasięgiem nadajnika, a następnie zostało ponownie zsynchronizowane. Można sprawdzić każdy alert w polu **Historia alertów**.

1. **Dotknij Menu > Historia alertów.**
   - Ekran **HISTORIA ALERTÓW** wyświetli WSZYSTKIE alerty i powiadomienia w tym dniu.
   - Więcej informacji można uzyskać po wybraniu konkretnego komunikatu.

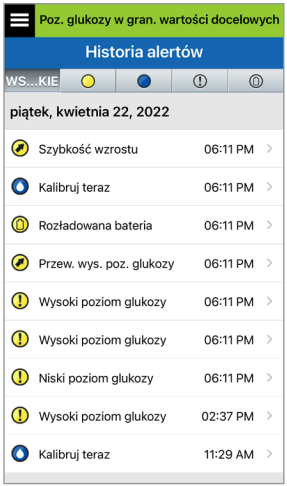

Przykładowy ekran WSZYSTKIE

2. **Można włączyć tylko niektóre wiadomości (alerty i powiadomienia itp.) do przeglądani, dotykając wybranych ikon alertów.**
   - Dotknij opcji **WSZYSTKIE**, a następnie dotknij ikon na górze ekranu, aby wybrać tylko te typy alertów, które mają zostać wyświetlone.
   - Po zakończeniu dotknij **Menu**.

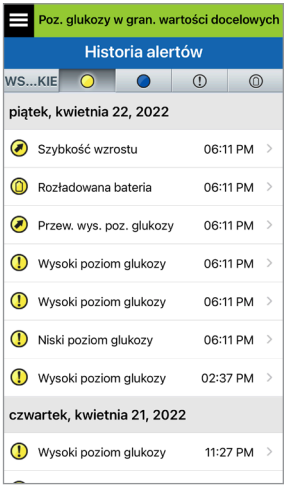



Przykładowy ekran samych alertów

Opisy alertów i wymagane działania

W poniższej tabeli przedstawiono alerty i powiadomienia, występujące w aplikacji Eversense.



WAŻNE: w aplikacji i w inteligentnym nadajniku nie można wyłączyć alertów wibracyjnych odczuwanych na ciele, oznaczonych *, przy użyciu trybu „Nie przeszkadzać” w ustawieniach aplikacji.

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Niski poziom glukozy*** Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub mniejsza od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy. Wartość domyślna częstotliwości powtarzania to 15 minut.	**Wysoki poziom glukozy** Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub większa od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy. Wartość domyślna częstotliwości powtarzania to 30 minut.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Poza zakresem niskiego stężenia glukozy*** Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość niższą niż 40 mg/dl. Nie można wyświetlić odczytu glukozy (tylko **NIS.** wyświetla się na ekranie **MOJA GLUKOZA**).	**Poza zakresem wysokiego stężenia glukozy*** Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość wyższą niż 400 mg/dl. Nie można wyświetlić odczytu glukozy (tylko **WYS.** wyświetla się na ekranie **MOJA GLUKOZA**).
Działania	Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru. Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub wyższą niż 40 mg/dl.	Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru. Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub niższą niż 400 mg/dl.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Przew. nis. poz. glukozy** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zniżkowy i osiągną wartość progową alertu niskiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.	**Przew. wys. poz. glukozy** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zwyżkowy i osiągną wartość progową alertu wysokiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika lub z tym, co wskazuje alert, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika lub z tym, co wskazuje alert, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Szybkość wzrostu** Pojawia się co 60 minut, wartości poziomu glukozy rosną w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.	**Szybkość spadania** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy spadają w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika lub z tym, co wskazuje alert, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika lub z tym, co wskazuje alert, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Nie wykryto czujnika*** Pojawia się, jeśli dojdzie do utraty połączenia między czujnikiem i nadajnikiem. Dane dotyczące glukozy nie są dostępne do momentu przywrócenia połączenia.	**Wymiana czujnika*** Pojawia się raz, gdy autotesty systemu wykryją, że czujnik nie może dłużej dostarczać wartości stężenia glukozy. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu wymiany czujnika.
Działania	Za pomocą Przewodnika umieszczania jako odniesienia umieścić inteligentny nadajnik nad czujnikiem, aż wskaże, że istnieje połączenie.	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu wymiany czujnika.


Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wymiana czujnika*** Pojawia się po upływie czasu eksploatacji czujnika. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu wymiany czujnika.	**Naładuj inteligentny nadajnik*** Pojawia się, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowany i będzie wkrótce wymagaćładowania.
Działania	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu wymiany czujnika.	Możliwie jak najszybciej naładuj baterię inteligentnego nadajnika.


Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Rozładowana bateria*** Pojawia się jednokrotnie, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana i wymaga naładowania. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu naładowania baterii inteligentnego nadajnika.	**Kalibruj teraz** Pojawia się, aby ostrzec o terminie kalibracji. Jeśli nie wykonasz kalibracji w ciągu 4 godzin, wartości poziomu glukozy nie będą już wyświetlane.
Działania	Niezwłocznie naładuj baterię nadajnika. Przed podłączeniem nadajnika do zasilania zdejmij go z ramienia.	Dotknij **Kalibruj**, aby wprowadzić wartość kalibracji.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Czujnik wstrzymany** Pojawia się, gdy autodiagnostyka systemu wykryje konieczność zrestartowania fazy inicjalizacji w celu wykonania dodatkowych kalibracji. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu drugiej skutecznej kalibracji.	**Minął termin wymaganej kalibracji** Pojawia się, gdy system jest po terminie kalibracji (16 godzin w fazie 2 dziennych kalibracji i 28 godzin w fazie 1 dziennej kalibracji). Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu przeprowadzenia kalibracji.
Działania	Ponowna inicjalizacja systemu rozpocznie się za 6 godzin. Wartości poziomu glukozy będą wyświetlane po upływie kilku minut od drugiej pomyślnej kalibracji w fazie inicjalizacji.	Wykonaj kalibrację przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca w celu przywrócenia wyświetlania wartości poziomu glukozy.

Opisy alertów i wymagane działania (cd.)



Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Kalibracja przeterminowana** Pojawia się, gdy kalibracja nie została wykonana w ciągu 24 godzin w fazie 2 dziennych kalibracji lub nie została wykonana w ciągu 40 godzin w fazie 1 dziennej kalibracji. System wraca do fazy inicjalizacji. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu przeprowadzenia kalibracji.	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika, dzień 366*** Pojawia się co 7 dni, jeśli nadajnik był używany przez 365 dni i nie jest objęty gwarancją. Po upływie 395 dni użytkowania nadajnik nie będzie już dostarczał odczytów poziomu glukozy.
Działania	W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 testy kalibracyjne przy użyciu pomiaru z opuszki palca w odstępie od 2 do 12 godzin. Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnym teście kalibracyjnym przy użyciu pomiaru z opuszki palca.	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.

Uwaga: W każdej fazie dziennej kalibracji, jeśli wpis kalibracji bardzo różni się od wartości poziomu glukozy z czujnika systemu, pojawi się monit o ponowną kalibrację. Jeśli kalibracja nie zostanie wykonana w ciągu 16 godzin, nie będą wyświetlane żadne wartości glukozy, a po 24 godzinach bez **kalibracji system** powraca do fazy inicjalizacji.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika 395*** Pojawia się, kiedy nadajnik pozostawał bez gwarancji przez 30 dni. Odczyty stężenia glukozy nie mogą być wyświetlane po dacie tego ostrzeżenia, dopóki nadajnik nie zostanie wymieniony.	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika 396*** Pojawia się, gdy nadajnik był używany przez 395 dni. Odczyty stężenia glukozy nie mogą być wyświetlane, dopóki nadajnik nie zostanie wymieniony. Jeśli minął okres eksploatacji nadajnika, nie można go połączyć z czujnikiem.
Działania	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Dużo światła w otoczeniu** Pojawia się co 60 minut, gdy czujnik otrzymuje za dużo światła z pomieszczenia, co skutkuje pogorszeniem jego komunikacji z inteligentnym nadajnikiem. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu zmniejszenia ilości światła.	**Wysoka temperatura inteligentnego nadajnika*** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura inteligentnego nadajnika jest zbyt wysoka. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, gdy temperatura robocza inteligentnego nadajnika wróci do normy.
Działania	Wykonaj jedną z poniższych czynności: • Przenieś się w mniej oświetlone miejsce. • Osłoń inteligentny nadajnik kawałkiem ciemnego materiału. • Noś nadajnik pod ubraniem.	Należy obniżyć temperaturę nadajnika, przenosząc go w chłodniejsze miejsce. Nadajnik wznowi wyświetlanie poziomu glukozy, gdy jego temperatura spadnie poniżej 42°C. Możesz zdjąć nadajnik na jakiś czas, aby go schłodzić. Pamiętaj, aby ponownie umieścić nadajnik nad czujnikiem, kiedy jego temperatura spadnie.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Niska temperatura czujnika*** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt niska. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, w którym temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.	**Wysoka temperatura czujnika*** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt wysoka. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, w którym temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.
Działania	Przejdź w cieplejsze miejsce, aby ogrzać czujnik. Pozostaw nadajnik inteligentny włączony, aby móc odbierać wyniki pomiarów glukozy, kiedy temperatura czujnika wróci do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F).	Przejdź w chłodniejsze miejsce, aby schłodzić czujnik. Na krótko zdejmij nadajnik, aż temperatura czujnika obniży się do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F). Następnie umieść nadajnik z powrotem na czujniku w celu wznowienia możliwości odbierania odczytów poziomu glukozy z czujnika.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Błąd inteligentnego nadajnika*** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd nadajnika. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu usunięcia błędu.	**Kontrola czujnika** Pojawia się jednorazowo, wtedy gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje brak stabilności czujnika, co wymaga powrotu do kalibracji w fazie inicjalizacji. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu wprowadzenia drugiej skutecznej kalibracji.
Działania	Aby zresetować inteligentny nadajnik, postępuj zgodnie z instrukcją w części Rozwiązywanie problemów. Jeżeli nie będziesz w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta.	W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 testy kalibracyjne przy użyciu pomiaru z opuszki palca w odstępie od 2 do 12 godzin. Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnym teście kalibracyjnym przy użyciu pomiaru z opuszki palca.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Silnik wibracji*** Pojawia się co 60 minut, gdy silnik wibracji w inteligentnym nadajniku nie może już generować alertów odczuwanych na ciele. Odczyty glukozy będą dostępne do odczytu na ekranie przez maksymalnie 72 godziny od pojawienia się tego komunikatu. Po upływie tego okresu komunikat alertu błędu nadajnika będzie pojawiał się co 20 minut do czasu jego wymiany.	**Błąd baterii*** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd związany z baterią nadajnika. Odczyty stężenia glukozy będą nadal wyświetlane, ale inteligentny nadajnik będzie wymagał wymiany.
Działania	Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu niezwłocznego przeprowadzenia wymiany nadajnika.	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Dane niedostępne** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd systemu. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu usunięcia błędu.	**Wykryto niekompatybilny nadajnik*** Pojawia się podczas łączenia, gdy system wykryje, że nadajnik jest niezgodny z czujnikiem.
Działania	Podłącz stację dokującą za pomocą kabla do gniazda ściennego lub portu USB. Umieść inteligentny nadajnik w stacji i usuń go. Jeżeli problem nie ustąpi, wykonaj czynności opisane w części *Rozwiązywanie problemów*, aby zresetować inteligentny nadajnik. Jeżeli nie będziesz w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Ponów próbę łączenia. Jeśli problem zostanie wyświetlony przy drugiej próbie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Błąd godziny w systemie** Pojawia się, gdy system wykryje niezgodność czasu między zegarem urządzenia przenośnego a zegarem systemowym.	**Błąd pliku czujnika*** Pojawia się, kiedy system wykryje problem podczas łączenia.
Działania	Ustaw godzinę w urządzeniu przenośnym na aktualny czas lokalny. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.	Ponów próbę łączenia. Jeśli problem zostanie wyświetlony przy drugiej próbie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wykryto nowe hasło** Pojawia się raz, gdy system wykryje, że hasło zostało zmienione za pośrednictwem konta Eversense DMS.	**Wymagane wylogowanie** Pojawia się co 24 godziny w przypadku użytkowników iOS, gdy system wykryje, że dane uwierzytelniające Eversense nie są dostępne za pośrednictwem funkcji pęku kluczy iOS.
Działania	Wyloguj się z aplikacji mobilnej i zaloguj się ponownie, używając nowego hasła.	Wyloguj się z aplikacji mobilnej i zaloguj się ponownie, używając istniejącej nazwy użytkownika i hasła.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wydajność aplikacji*** Pojawia się codziennie w systemach operacyjnych Android, kiedy system wykryje częste awarie aplikacji lub przerwy w komunikacji Bluetooth spowodowane uwzględnieniem aplikacji Eversense w ustawieniach optymalizacji baterii.	**Trwa kalibracja** Pojawia się, gdy wartość kalibracji różni się znacząco od wartości pokazywanej przez glukometr.
Działania	Przejdź do ustawień optymalizacji baterii w telefonie i wyłącz aplikację Eversense, aby nie dochodziło do opóźnienia alertów Eversense.	Nie usuwaj nadajnika przez 15 minut. Przeprowadź ponowną kalibrację po wyświetleniu stosownego monitu.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Niezgodne oprogramowanie nadajnika** Pojawia się, gdy oprogramowanie inteligentnego nadajnika nie jest zgodne z wersją aplikacji mobilnej Eversense CGM na urządzeniu przenośnym.	**Ostrzeżenie o wylogowaniu** Pojawia się, kiedy użytkownik podejmie próbę wylogowania się z aplikacji mobilnej. Jeśli użytkownik się wyloguje, nie będzie mógł przeglądać danych dotyczących glukozy w aplikacji mobilnej Eversense.
Działania	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Pozostań zalogowany w aplikacji mobilnej, aby kontynuować przeglądanie danych dotyczących poziomu glukozy. Jeśli użytkownik się wyloguje, musi ponownie zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła, aby kontynuować korzystanie z aplikacji.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

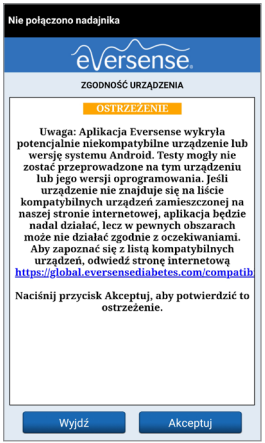Wyświetlacz aplikacji		
		
Opis	**Niezgodne urządzenie / system operacyjny** Pojawia się, gdy aplikacja używana jest z niezgodnym urządzeniem / systemem operacyjnym.	**Włącz funkcję Bluetooth i usługę lokalizacji Dotyczy wyłącznie urządzeń z systemem Android.** Wyjaśnia, że korzystanie z usług lokalizacji jest wymagane do włączenia połączenia Bluetooth i otrzymywania alertów.
Działania	Wykaz zgodnych urządzeń / systemów operacyjnych znajduje się na stronie **https://global.eversensediabetes.com**.	Dotknij **OK**, aby potwierdzić.


Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wykryto nowe hasło** Pojawia się raz, gdy system wykryje, że hasło zostało zmienione za pośrednictwem konta Eversense DMS.	**Nieprawidłowe hasło** Pojawia się, gdy system wykryje, że jedno lub dwa nieprawidłowe hasła zostały kolejno wprowadzone przez aplikację mobilną.
Działania	Wyloguj się z aplikacji mobilnej i zaloguj się ponownie, używając nowego hasła.	Użyj prawidłowego hasła, aby zalogować się do aplikacji mobilnej.


Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Alerty

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Konto zablokowane** Pojawia się po wprowadzeniu kolejno trzech błędnych haseł w aplikacji mobilnej.	**Usuń konto** Pojawia się po dotknięciu opcji „Usuń konto” na stronie logowania.
Działania	Zaczekaj 30 minut. Zaloguj się z użyciem prawidłowego hasła lub zresetuj hasło.	Aby kontynuować, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wykryto nowy czujnik** Pojawia się, gdy inteligentny nadajnik wykryje nowy czujnik. W celu nawiązania komunikacji wszczepiony czujnik i inteligentny nadajnik muszą zostać połączone.	**Kalibruj teraz** Pojawia się, gdy nadszedł czas na kalibrację, system jest w fazie inicjalizacji lub po wprowadzeniu kalibracji, która bardzo różni się od poziomu glukozy z czujnika.
Działania	Dotknij **Połącz czuj.**, aby wykonać proces łączenia i rozpocząć 24-godzinną fazę rozgrzewania. Nie musisz nosić nadajnika inteligentnego na ramieniu nad czujnikiem do czasu zakończenia fazy rozgrzewania.	Wykonaj test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca i wprowadź odczyt jako wartość kalibracji. Do kalibrowania systemu NIE WOLNO używać wartości poziomu glukozy z próbki krwi pobranej z innego miejsca (przedramię lub dłoń).



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Ponów kalibrację** Pojawia się, kiedy podczas kalibracji zebrano zbyt mało danych.	**Wymagana nowa kalibracja** Pojawia się, gdy wartość kalibracji różni się znacząco od wartości z czujnika glukozy. Po mniej więcej 1 godzinie pojawi się powiadomienie „Kalibruj teraz”.
Działania	Dotknij **Kalibruj**, aby wprowadzić nową wartość kalibracji.	Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.



Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**Wymiana czujnika** Pojawia się co 60, 30, 14, 7, 3 i 1 dzień przed zakończeniem okresu eksploatacji czujnika w celu przypomnienia o konieczności jego wymiany.	**1 dzienna kalibracja** Pojawia się, kiedy system wymaga kalibracji raz na 24 godziny.
Działania	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia terminu wymiany czujnika.	Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.

Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz aplikacji		
Opis	**2 dzienne kalibracje** Pojawia się, kiedy system wymaga kalibracji dwa razy w ciągu dnia.	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika, dzień 330** Pojawia się 35 dni przed upływem gwarancji nadajnika.
Działania	Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.

10. Dziennik zdarzeń

Rozdział opisuje sposób wyświetlania i rejestrowania zdarzeń na potrzeby usprawnienia monitorowania zmian poziomu glukozy.

Oprócz ciągłego monitorowania poziomów glukozy system Eversense E3 CGM umożliwia rejestrowanie i śledzenie zdarzeń. Zdarzenia można wprowadzać ręcznie. Będą się one pojawiały na wykresie trendu i w raportach poziomu glukozy. Rejestrowanie typu zdarzeń ma na celu zaobserwowanie prawidłowości w profilu poziomu glukozy.

Rodzaje zdarzeń:


Glukoza


Posiłek


Insulina



Zdrowie


Ćwiczenie

Uwaga: Dostęp do ekranu **DODAJ ZDARZENIE** można również uzyskać bezpośrednio z ekranu **MOJA GLUKOZA** za pomocą jednego dotknięcia w dowolnym miejscu na wykresie.

Przeglądanie zdarzeń

Istnieje możliwość wyświetlenia zdarzeń z przeszłości na ekranie **DZIENNIK ZDARZEŃ**.

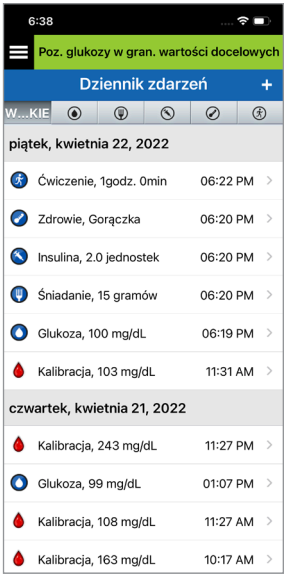

1. **Dotknij opcji Menu > Dziennik zdarzeń.**

   Wyświetli się ekran **DZIENNIK ZDARZEŃ**.

2. **Ekran zawiera wszystkie wprowadzone zdarzenia.**

   Można wybrać przeglądanie określonego rodzaju zdarzeń, wybierając określony typ zdarzenia.

   - Dotknij opcji **WSZYSTKIE**, a następnie dotknij ikon na górze ekranu, aby wybrać tylko te typy zdarzeń, które mają zostać wyświetlone.

Rejestrowanie określonych zdarzeń

Glukoza

Umożliwia wprowadzanie i monitorowanie wyników testów wykonanych przy użyciu glukometru (wyniki inne niż na potrzeby kalibracji).

1. Dotknij opcji **Menu** > **Dziennik zdarzeń**.


2. Dodaj zdarzenie za pomocą ikony zdarzenia **„+”** > **Glukoza**.


3. Dotknij opcji **Godzina**, aby wprowadzić prawidłową datę i godzinę.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

4. Dotknij opcji **Glukoza**, aby wprowadzić prawidłową wartość glukozy we krwi.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

   Uwaga: Można wprowadzić wartość stężenia glukozy w zakresie od 20 do 600 mg/dl. Na potrzeby obliczeń i wyświetlania wprowadzone wartości mniejsze od 20 mg/dl zostaną przekonwertowane na 20, zaś wprowadzone wartości większe od 600 mg/dl zostaną przekonwertowane na 600.


5. Dotknij opcji **Zapisz**.

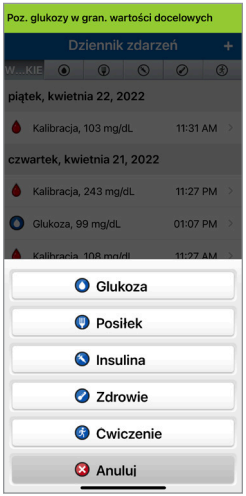

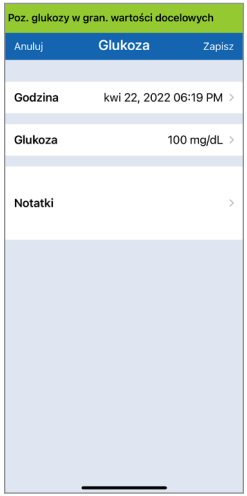


6. **W wyskakującym oknie Potwierdź poziom glukozy dotknij opcji Zatwierdź, aby potwierdzić zdarzenie dotyczące poziomu glukozy i powrócić do ekranu DZIENNIK ZDARZEŃ, lub dotknij opcji Anuluj, aby wyjść bez zapisywania zmian lub aby edytować informacje przed zapisaniem.**

Uwaga: Zdarzenia dotyczące poziomu glukozy nie zastępują pomiarów kalibracyjnych. Należy w dalszym ciągu wprowadzać wartości pomiarów kalibracyjnych.



iOS



Android

Posiłek

Zdarzenie opisujące rodzaj posiłku, datę i godzinę oraz ilość węglowodanów.

1. **Dotknij opcji Menu > Dziennik zdarzeń.**

2. **Dodaj zdarzenie za pomocą ikony zdarzenia „+” > Posiłki.**


3. **Dotknij opcji Godzina, aby wprowadzić prawidłową datę i godzinę.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

4. **Dotknij opcji Typ, aby wprowadzić typ posiłku.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

5. **Dotknij opcji Węglowodany, aby wprowadzić prawidłową ilość węglowodanów.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

6. **Wybierz opcję Notatki, aby wprowadzić uwagi.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

7. **Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać wpis i powrócić do ekranu DZIENNIK ZDARZEŃ. Dotknij opcji Anuluj, aby wyjść bez zapisywania zmian.**

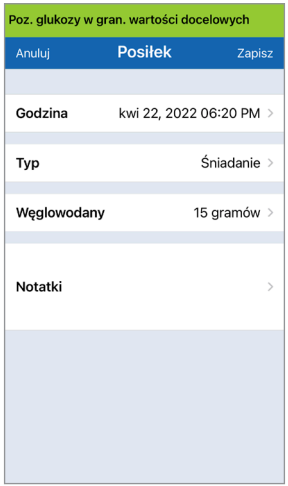

Insulina

Zdarzenie opisujące jednostki insuliny z uwzględnieniem godziny i typu insuliny.

1. **Dotknij opcji Menu > Dziennik zdarzeń.**

2. **Dodaj zdarzenie za pomocą ikony zdarzenia „+” > Insulina.**

3. **Dotknij opcji Godzina, aby wprowadzić prawidłową datę i godzinę.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.


4. **Dotknij opcji Jednostki, aby wprowadzić prawidłową liczbę jednostek.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

   Uwaga: Maksymalna liczba jednostek insuliny, jaką można wprowadzić, to 200 U.

5. Dotknij opcji **Typ**, aby wprowadzić typ insuliny.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

6. **Wybierz opcję Notatki, aby wprowadzić uwagi.**
   Dotknij opcji **Gotowe**.

7. **Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać wpis i powrócić do ekranu DZIENNIK ZDARZEŃ. Dotknij opcji Anuluj, aby wyjść bez zapisywania zmian.**

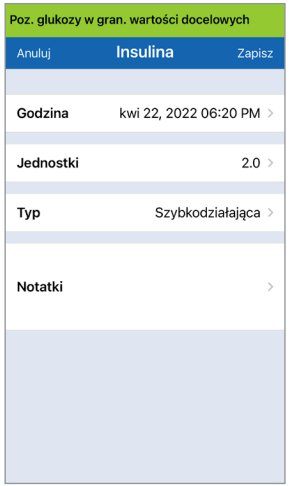

Zdrowie

Typ zdarzenia opisujący stan zdrowia, z uwzględnieniem daty i godziny.

1. Dotknij opcji **Menu** > **Dziennik zdarzeń**.

2. Dodaj zdarzenie za pomocą ikony zdarzenia „**+**” > **Zdrowie**.


3. Dotknij opcji **Godzina**, aby wprowadzić prawidłową datę i godzinę.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

4. Dotknij opcji **Nasilenie**, aby wybrać opcję Niskie, Średnie lub Wysokie.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

5. Dotknij opcji **Stan**, aby wprowadzić informacje o stanie zdrowia.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

7. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wpis i powrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Dotknij opcji **Anuluj**, aby wyjść bez zapisywania zmian.

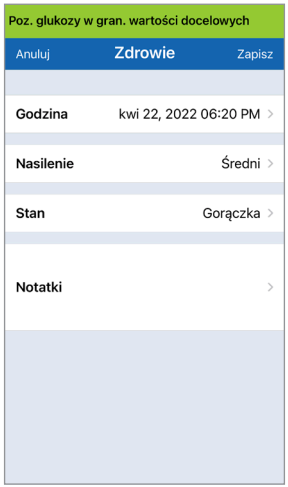



Ćwiczenie

Typ zdarzenia opisujący intensywność oraz czas trwania aktywności fizycznej.

1. Dotknij opcji **Menu** > **Dziennik zdarzeń**.

2. Dodaj zdarzenie za pomocą ikony zdarzenia „**+**” > **Ćwiczenie**.


3. Dotknij opcji **Godzina**, aby wprowadzić prawidłową datę i godzinę.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

4. Dotknij opcji **Intensywność**, aby wybrać opcję Niska, Średnia lub Wysoka.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

5. Dotknij opcji **Czas trwania**, aby wprowadzić czas trwania.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.
   Dotknij opcji **Gotowe**.

7. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wpis i powrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Dotknij opcji **Anuluj**, aby wyjść bez zapisywania zmian.

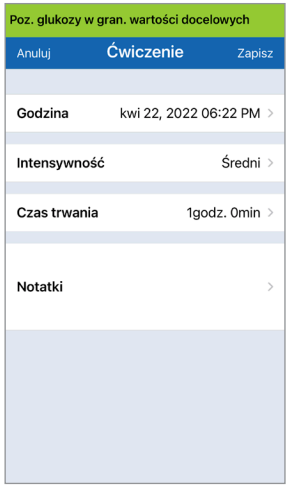

II. Raporty

Rozdział opisuje dostępne raporty poziomu glukozy obrazujące profil glukozy użytkownika systemu (na podstawie określonych dat i przedziałów czasowych). Użytkownik może wybrać określone daty lub zaprogramowane przedziały czasu.

Rodzaje raportów

- Tygodniowe zestawienie modalne.
- Wykres kołowy poziomu glukozy.
- Raport statystyk poziomu glukozy.


Uwaga: Należy się upewnić, że data i godzina ustawione w urządzeniu przenośnym są prawidłowe. Dokładność wykresów i raportów uzależniona jest od prawidłowości ustawionej daty i godziny.

Aby wyświetlić raporty poziomu glukozy, należy dotknąć opcji **Menu** > **Raporty** i przesunąć palcem w celu przełączania się między trzema różnymi raportami. Istnieje możliwość wysłania każdego z raportów na swój adres e-mail, wybierając ikonę raportu w prawym górnym rogu ekranu.

Tygodniowe zestawienie modalne

Ten raport zawiera odczyty pomiarów glukozy z ostatnich siedmiu dni, podsumowane w postaci 24-godzinnego wykresu liniowego, pomagającego w ustaleniu prawidłowości dobowych.


- **Niebieska linia** stanowi średnią z ostatnich siedmiu dni odczytów w bloku godzinowym.
- **Czerwone paski** przedstawiają najwyższe i najniższe odczyty rzeczywiste w tym samym bloku godzinowym.
- **Czerwone poziomie linie przerywane** stanowią wstępnie ustawione poziomy alertów wysokiego i niskiego stężenia glukozy.
- **Zielone poziomie linie przerywane** stanowią wstępnie ustawione poziomy docelowe wysokiego i niskiego stężenia glukozy.

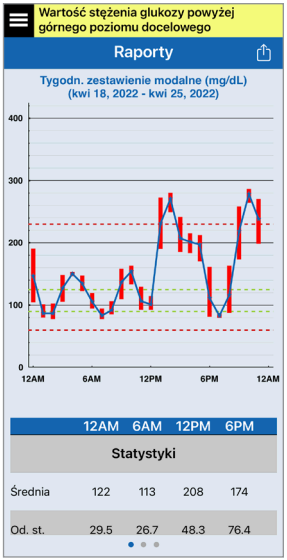


Ten raport oferuje także podsumowanie statystyczne (średnie odczyty, odchylenia standardowe odczytów), wartości docelowe poziomu glukozy (odsetek odczytów mieszczących się w zakresie poziomów docelowych glukozy oraz wykraczających poza górny i dolny zakres docelowy), oraz wysokie i niskie poziomy glukozy (odsetek odczytów mieszczących się w zakresie od niskiego do wysokiego poziomu docelowego). Informacje są wyświetlane na podstawie wyznaczonych 6-godzinnych przedziałów czasowych.

Wykres kołowy poziomu glukozy

Ten raport przedstawia w formie graficznej, jaki odsetek odczytów w danym okresie mieści się w docelowym zakresie poziomu glukozy i jaki odsetek odczytów wykracza poza górny i dolny docelowy zakres poziomu glukozy. Można wybrać okres obejmujący 1, 7, 14, 30 lub 90 ostatnich dni.

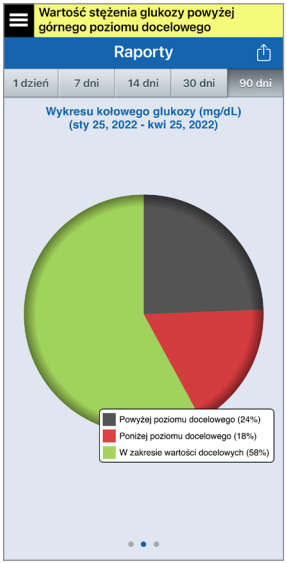


iOS

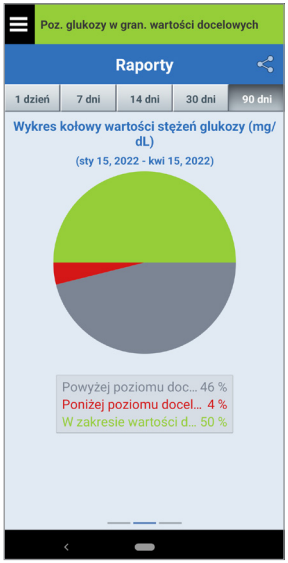

Android

Raport statystyk poziomu glukozy

Ten raport przedstawia średnie, niskie i wysokie odczyty poziomu glukozy, łącznie z odchyleniem standardowym w 6-godzinnych przedziałach czasowych. Można wybrać okres obejmujący 1, 7, 14, 30 lub 90 ostatnich dni.

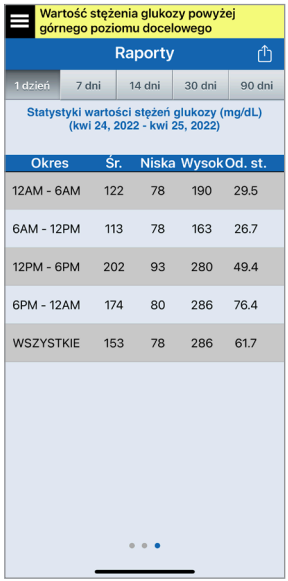

Okres	Śr.	Niska	Wysok	Od. st.
12AM - 6AM	122	78	190	29.5
6AM - 12PM	113	78	163	26.7
12PM - 6PM	202	93	280	49.4
6PM - 12AM	174	80	286	76.4
WSZYSTKIE	153	78	286	61.7

12. Udostępniane danych

Za pomocą systemu Eversense dane można udostępniać w różny sposób.

Oprogramowanie do zarządzania danymi Eversense DMS

Eversense DMS Program to aplikacja sieciowa umożliwiająca pacjentom, opiekunom i pracownikom służby zdrowia przeglądanie oraz analizowanie danych dotyczących poziomu glukozy przesyłanych z inteligentnego nadajnika Eversense E3 lub z aplikacji mobilnej systemu Eversense CGM.

To oprogramowanie jest oferowane bezpłatnie wszystkim użytkownikom systemu Eversense E3 CGM. Więcej informacji na temat programu Eversense DMS można znaleźć na stronie internetowej **https://global.eversensediabetes.com**. Po utworzeniu i zarejestrowaniu swojego konta podczas instalowania aplikacji mobilnej Eversense CGM konto Eversense DMS zostanie utworzone automatycznie. W części *Eversense NOW* znajduje się więcej informacji na temat zdalnego przeglądania danych dotyczących poziomu glukozy z systemu Eversense E3 CGM.

WAŻNE: SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH EVERSENSE E3 NIE DOSTARCZA PORAD MEDYCZNYCH. WSZELKIE ZMIANY W PLANIE LECZENIA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MOŻE WPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE PERSONEL MEDYCZNY ZAJMUJĄCY SIĘ PACJENTEM.


Udostępnij moje dane

Funkcja „Udostępnij moje dane” w aplikacji mobilnej Eversense CGM System umożliwia ręczną synchronizację danych z kontem Eversense DMS, zapraszanie znajomych i rodziny do zdalnego przeglądania danych CGM za pośrednictwem aplikacji mobilnej Eversense NOW oraz łączenie się z innymi kompatybilnymi aplikacjami medycznymi.


Synchr.


Jeżeli połączenie z Internetem jest aktywne, użytkownik jest zalogowany do aplikacji i funkcja automatycznej synchronizacji jest włączona, wyniki pomiarów glukozy będą synchronizowane z kontem Eversense DMS co ok. 5 minut. Funkcję automatycznej synchronizacji można wyłączyć.

Aby włączyć funkcję automatycznej synchronizacji, wybierz opcję **Synchr.** na ekranie **UDOSTĘPNIJ MOJE DANE**. Dotknij przycisku **Automatyczna synchronizacja**, aby wyłączyć tę funkcję.

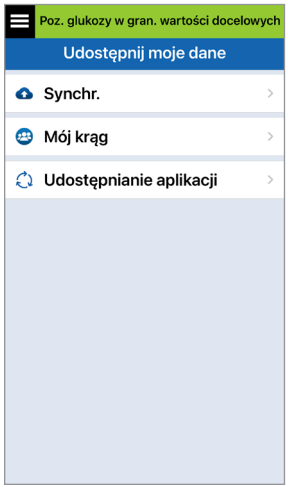

Aby ręcznie zsynchronizować dane, dotknij przycisku **ROZPOCZNIJ SYNCHRONIZACJĘ**. Dane z wybranej liczby dni zostaną zsynchronizowane. Można wybrać domyślną liczbę dni synchronizacji danych: 1, 3, 7, 14 lub 30 dni.

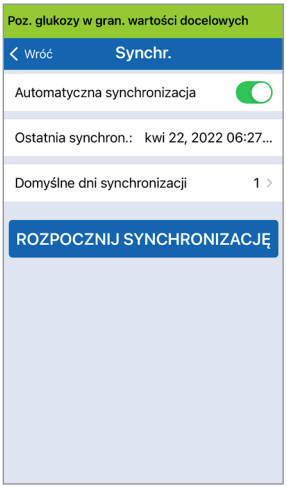


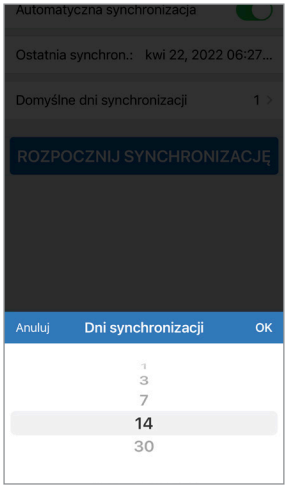

WAŻNE: Po wyłączeniu funkcji automatycznej synchronizacji dane nie będą wysyłane do osób używających aplikacji Eversense NOW do zdalnego monitorowania poziomu glukozy, a dane historyczne poziomu glukozy nie będą przechowywane na koncie DMS.


Mój krąg


Mój krąg to funkcja dodatkowa umożliwiająca aktywowanie zdalnego monitorowania Twoich danych Eversense E3 CGM. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w części *Mój krąg – Zdalne monitorowanie*.

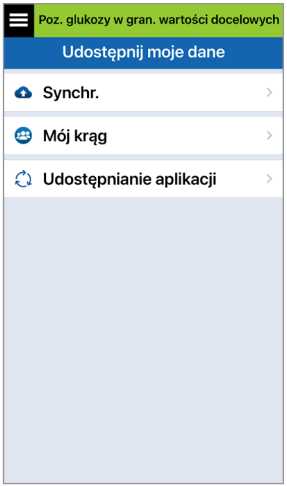


Udostępnianie aplikacji

„Udostępnianie aplikacji” to funkcja opcjonalna, która umożliwia udostępnianie niektórych danych Eversense innej kompatybilnej aplikacji medycznej. Dotknij aplikacji i włącz opcję **„Udostępnij dane”**. Może być również konieczne udzielenie zezwolenia na udostępnianie za pośrednictwem aplikacji medycznej.

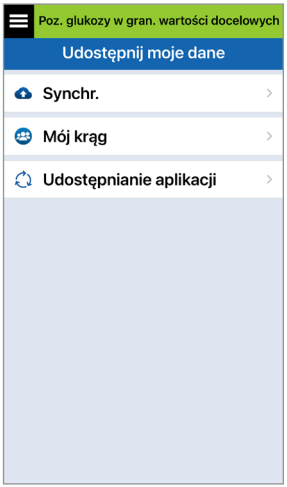

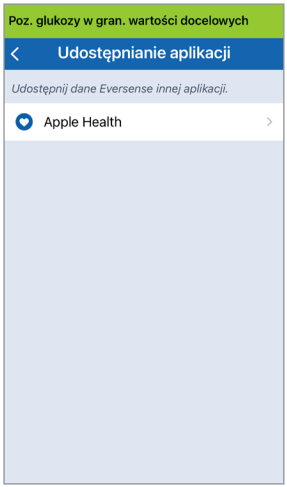

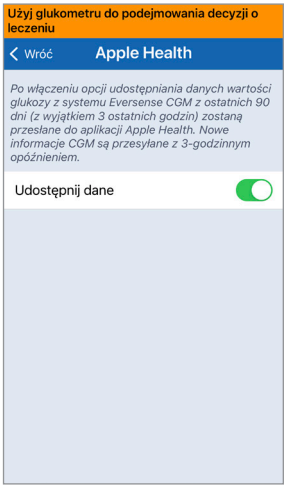


13. Informacje o produkcie i ogólne informacje o aplikacji


Rozdział opisuje informacje dostępne w sekcji Informacje w menu głównym.

Istnieje możliwość przeglądania informacji dotyczących inteligentnego nadajnika, czujnika i aplikacji mobilnej Eversense CGM.


1. Dotknij **Menu** > **Informacje**, a następnie dotknij **Mój nadajnik**, **Mój czujnik** lub **Informacje o produkcie**.

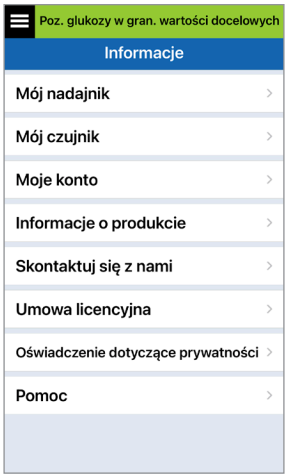


Na ekranie **Mój nadajnik** można znaleźć informacje, w tym numer seryjny, informacje o kalibracji oraz poziom baterii. Można również przetestować funkcję wibracji inteligentnego nadajnika.

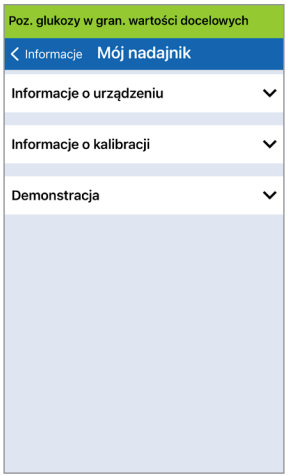

Na ekranie **Mój czujnik** można zobaczyć numer seryjny czujnika i szczegóły dotyczące wprowadzenia.

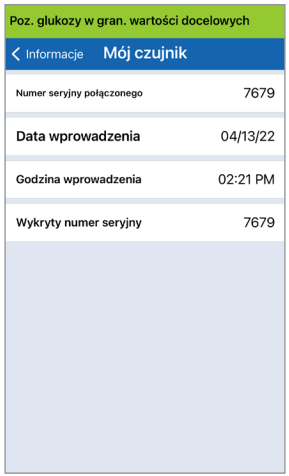

Na ekranie **Moje konto** można edytować swoje zdjęcie profilowe, wyświetlić adres e-mail użyty do utworzenia konta Eversense i wylogować się z aplikacji Eversense.

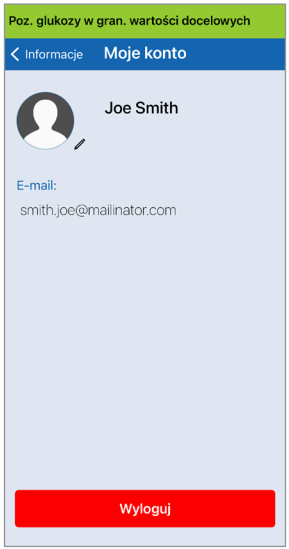



Zdjęcie profilowe

Można zaktualizować zdjęcie profilowe na koncie Eversense. Zdjęcie będzie wyświetlane w aplikacji mobilnej Eversense i na koncie Eversense DMS.

- Przejdź do **Informacje** > **Moje konto** i dotknąć zdjęcia. Można również dotknąć zdjęcia z poziomu menu głównego.
- Postępuj zgodnie z monitem, aby zaktualizować lub usunąć zdjęcie. Można zrobić nowe zdjęcie lub wybrać zdjęcie zapisane na urządzeniu.
- Wybrane zdjęcie będzie wyświetlane na ekranie **Menu główne**.

Uwaga: zdjęcie profilowe można również zmienić z poziomu konta Eversense DMS. Więcej informacji znajduje się w części *Eversense DMS*.

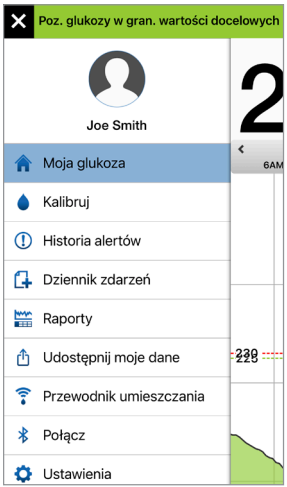

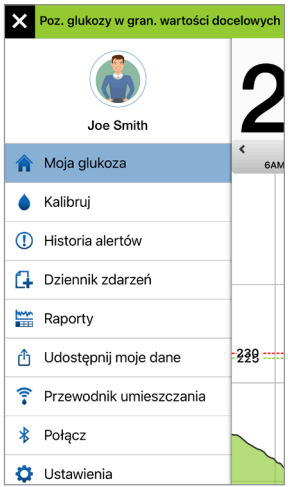


Na ekranie **Informacje o produkcie** można wyświetlić informacje o wersji oprogramowania aplikacji mobilnej i firmie Senseonics, Inc., producencie systemu Eversense E3 CGM.



W menu Informacje można też przesłać informacje zwrotne lub przejrzeć licencję dla użytkownika końcowego (EULA) i politykę prywatności.

- Dotknij **Skontaktuj się z nami**, aby wysłać wiadomość e-mail do lokalnego zespołu obsługi klienta.

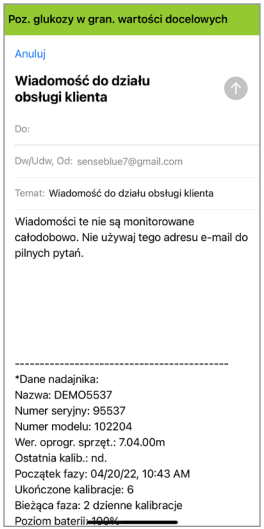

WAŻNE: komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest monitorowana całodobowo. **NIE** wolno używać tego adresu e-mail w sprawach związanych ze zdrowiem lub sprawach pilnych.


Aby przeczytać licencję dla użytkownika końcowego (EULA) i politykę prywatności, dotknij wybranej opcji.




Aby znaleźć dystrybutora lokalnego na naszej stronie, dotknij pozycji **Pomoc**.

Wylogowanie

Aby wylogować się z konta Eversense, dotknij **Moje konto** > **Wyloguj**.

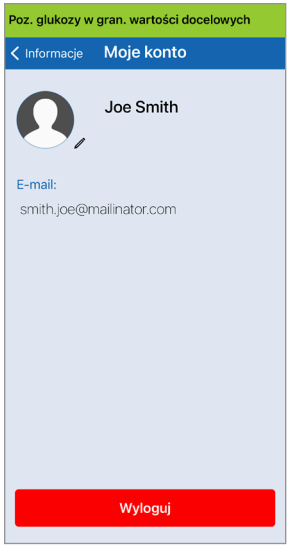



13

WAŻNE: po wylogowaniu się nie będzie można przeglądać w aplikacji danych dotyczących poziomu glukozy do czasu ponownego zalogowania. Ponowne zalogowanie do aplikacji wymaga wprowadzenia adresu e-mail oraz hasła, ustalonego podczas rejestracji konta.

14. Przeglądanie danych z systemu Eversense E3 na urządzeniu Apple Watch


Urządzenie Apple Watch umożliwia przeglądanie migawek danych z systemu Eversense E3 CGM. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Eversense CGM na urządzeniu przenośnym należy dodać aplikację do urządzenia Apple Watch, stosując się do zaleceń w jego instrukcji obsługi.

Apple Watch jest dodatkowym ekranem do wyświetlania danych z systemu Eversense E3 CGM i nie należy używać go zamiast ekranu głównego systemu Eversense E3 CGM.


Wszelkie problemy z urządzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu, połączeniem do transmisji danych, systemem zarządzania bazą danych Eversense (DMS), inteligentnym nadajnikiem użytkownika systemu CGM znajdującym się poza zasięgiem urządzenia przenośnego lub ładowanie inteligentnego nadajnika mogą spowodować, że dane będą wyświetlane z opóźnieniem lub nie będą wyświetlane.

Jeżeli w dowolnym momencie wystąpią objawy niskiego lub wysokiego poziomu glukozy LUB jeżeli objawy nie odpowiadają odczytom wartości wykrywanym przez czujnik, przed podjęciem decyzji dotyczącej leczenia należy zbadać poziom glukozy za pomocą glukometru.


Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji, dotknij ikony **Eversense** na ekranie **GŁÓWNYM**, aby otworzyć aplikację.




Ekran **Moja glukoza** wyświetla aktualny poziom glukozy ze strzałką trendu i wykres trendu z ostatnich trzech godzin danych CGM.



Ekranu **MOJA GLUKOZA** można również użyć, aby włączyć powiadomienia z systemu Eversense E3 w ustawieniach aplikacji Apple Watch. Po otrzymaniu powiadomienia można również dotknąć komunikatu na ekranie **MOJA GLUKOZA**.



Należy przesunąć palcem w lewo, przechodząc do kolejnego ekranu, który zawiera wykres kołowy całkowitego czasu, podczas którego odczyty mieściły się w zakresie wartości docelowych oraz poza nim na przestrzeni ostatnich 24 godzin.



Należy przesunąć palcem w górę, aby wyświetlić dane w wartościach procentowych.



Przesuń palcem w lewo do następnego ekranu pokazującego aktualny poziom glukozy ze strzałką trendu, termin następnej kalibracji, bieżącą fazę kalibracji systemu oraz poziom naładowania baterii inteligentnego nadajnika.





Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch

Apple Watch jest dodatkowym wyświetlaczem aplikacji mobilnej Eversense CGM. Wszelkie alerty lub powiadomienia otrzymane na urządzeniu Apple Watch należy potwierdzić w aplikacji mobilnej Eversense CGM przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Jeśli użytkownik anuluje alert na zegarku, wyświetlenie alertu zniknie z ekranu blokady telefonu. Po otwarciu aplikacji mobilnej zostanie wyświetlony alert ze wszystkimi informacjami.

W poniższej tabeli przedstawiono alerty i powiadomienia, występujące na urządzeniu Apple Watch z aplikacji Eversense. Na niektóre alerty i powiadomienia wpływają ustawienia dźwięku w aplikacji mobilnej oraz funkcja „Nie przeszkadzać" w aplikacji mobilnej. Patrz *Ustawianie dźwięków* oraz *Opisy alertów i wymagane działania*, aby uzyskać dalsze informacje.



Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Niski poziom glukozy** Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub mniejsza od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy.	**Wysoki poziom glukozy** Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub większa od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy.

Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji o leczeniu należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Poza zakresem niskiego stężenia glukozy** Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość niższą niż 40 mg/dl. Odczyty poziomu glukozy nie mogą być wyświetlane.	**Poza zakresem wysokiego stężenia glukozy** Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość wyższą niż 400 mg/dl. Odczyty poziomu glukozy nie mogą być wyświetlane.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zmierz poziom glukozy ręcznie, używając glukometru. Przed podjęciem decyzji o leczeniu należy zawsze potwierdzić poziom glukozy za pomocą glukometru. Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub wyższą niż 40 mg/dl.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zmierz poziom glukozy ręcznie, używając glukometru. Przed podjęciem decyzji o leczeniu należy zawsze potwierdzić poziom glukozy za pomocą glukometru. Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub niższą niż 400 mg/dl.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Przew. nis. poz. glukozy** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zniżkowy i osiągną wartość progową alertu niskiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.	**Przew. wys. poz. glukozy** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zwyżkowy i osiągną wartość progową alertu wysokiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji terapeutycznej należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji terapeutycznej należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Szybkość wzrostu** Pojawia się co 60 minut, wartości poziomu glukozy rosną w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.	**Szybkość spadania** Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy spadają w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji terapeutycznej należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika, przed podjęciem decyzji terapeutycznej należy potwierdzić wartość glukozy za pomocą glukometru.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Nie wykryto czujnika** Pojawia się, jeśli dojdzie do utraty połączenia między czujnikiem i nadajnikiem. Dane dotyczące glukozy nie są dostępne do momentu przywrócenia połączenia.	**Wymiana czujnika** Pojawia się raz, gdy autotesty systemu wykryją, że czujnik nie może dłużej dostarczać wartości stężenia glukozy.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Za pomocą Przewodnika umieszczania jako odniesienia umieścić inteligentny nadajnik nad czujnikiem, aż wskaże, że istnieje połączenie.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu wymiany czujnika.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Wymiana czujnika** Pojawia się po upływie czasu eksploatacji czujnika. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu wymiany czujnika.	**Naładuj nadajnik** Pojawia się, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowany i będzie wkrótce wymagać ładowania.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu wymiany czujnika.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Możliwie jak najszybciej naładuj baterię inteligentnego nadajnika.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Rozładowana bateria** Pojawia się jednokrotnie, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana i wymaga naładowania. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu naładowania baterii inteligentnego nadajnika.	**Kalibruj teraz** Pojawia się, aby ostrzec o terminie kalibracji. Jeśli nie wykonasz kalibracji w ciągu 4 godzin, wartości poziomu glukozy nie będą już wyświetlane.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Niezwłocznie naładuj baterię nadajnika. Przed podłączeniem nadajnika do zasilania zdejmij go z ramienia.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Dotknij **Kalibruj** na urządzeniu przenośnym, aby wprowadzić wartość kalibracji.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Czujnik wstrzymany** Pojawia się, gdy autodiagnostyka systemu wykryje konieczność zrestartowania fazy inicjalizacji w celu wykonania dodatkowych kalibracji. Wartości poziomu glukozy będą wyświetlane po upływie kilku minut od drugiej pomyślnej kalibracji w fazie inicjalizacji.	**Minął termin wymaganej kalibracji** Pojawia się wtedy, gdy minęła godzina zaplanowanej kalibracji. Odczyty poziomu glukozy nie mogą być wyświetlane do momentu wprowadzenia kalibracji w aplikacji mobilnej Eversense CGM.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Ponowna inicjalizacja systemu rozpocznie się za 6 godzin.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wykonaj kalibrację przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca w celu przywrócenia wyświetlania wartości poziomu glukozy.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Kalibracja przeterminowana** Pojawia się wtedy, gdy kalibracja nie została przeprowadzona w ciągu ostatnich 24 godzin. System wraca do fazy inicjalizacji. Odczyty poziomu glukozy nie mogą być wyświetlane do momentu wprowadzenia kalibracji w aplikacji mobilnej Eversense CGM.	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika 366** Pojawia się, jeśli nadajnik był używany przez 365 dni i nie jest objęty gwarancją. Po upływie 395 dni użytkowania nadajnik nie będzie już dostarczał odczytów poziomu glukozy.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 kalibracje przy użyciu próbek krwi pobranych z opuszki palca w odstępie od 2 do 12 godzin. Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnej kalibracji przy użyciu pomiaru z opuszki palca.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika 395** Pojawia się, kiedy nadajnik pozostawał bez gwarancji przez 30 dni. Odczyty stężenia glukozy nie mogą być wyświetlane po dacie tego ostrzeżenia, dopóki nadajnik nie zostanie wymieniony.	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika 396** Pojawia się, gdy nadajnik był używany przez 395 dni. Odczyty stężenia glukozy nie mogą być wyświetlane, dopóki nadajnik nie zostanie wymieniony.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty



Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Dużo światła w otoczeniu** Pojawia się co 60 minut, gdy czujnik otrzymuje za dużo światła z pomieszczenia, co skutkuje pogorszeniem jego komunikacji z inteligentnym nadajnikiem. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu zmniejszenia ilości światła.	**Wysoka temperatura nadajnika** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura inteligentnego nadajnika jest zbyt wysoka. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, gdy temperatura robocza inteligentnego nadajnika wróci do normy.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wykonaj jedną z poniższych czynności: • Przenieś się w mniej oświetlone miejsce. • Osłoń inteligentny nadajnik kawałkiem ciemnego materiału. • Noś nadajnik pod ubraniem.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Należy obniżyć temperaturę nadajnika, przenosząc go w chłodniejsze miejsce. Nadajnik wznowi wyświetlanie poziomu glukozy, gdy jego temperatura spadnie poniżej 42°C. Możesz zdjąć nadajnik na jakiś czas, aby go schłodzić. Pamiętaj, aby ponownie umieścić nadajnik nad czujnikiem, kiedy jego temperatura spadnie.

Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty



Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Niska temperatura czujnika** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt niska. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, w którym temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.	**Wysoka temperatura czujnika** Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt wysoka. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do momentu, w którym temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Przejdź w cieplejsze miejsce, aby ogrzać czujnik. Pozostaw nadajnik inteligentny włączony, aby móc odbierać wyniki pomiarów glukozy, kiedy temperatura czujnika wróci do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F).	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Przejdź w chłodniejsze miejsce, aby schłodzić czujnik. Na krótko zdejmij nadajnik, aż temperatura czujnika obniży się do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F). Następnie umieść nadajnik z powrotem na czujniku w celu wznowienia możliwości odbierania odczytów poziomu glukozy z czujnika.

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Błąd inteligentnego nadajnika** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd nadajnika. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu usunięcia błędu.	**Kontrola czujnika** Pojawia się jednorazowo, wtedy gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje brak stabilności czujnika, co wymaga powrotu do kalibracji w fazie inicjalizacji.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Aby zresetować inteligentny nadajnik, postępuj zgodnie z instrukcją w części *Rozwiązywanie problemów*. Jeżeli nie będziesz w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 kalibracje przy użyciu próbek krwi pobranych z opuszki palca w odstępie od 2 do 12 godzin. Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnej kalibracji przy użyciu pomiaru z opuszki palca.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Silnik wibracji** Pojawia się co 60 minut, gdy silnik wibracji w inteligentnym nadajniku nie może już generować alertów odczuwanych na ciele. Odczyty glukozy będą dostępne do odczytu na ekranie przez maksymalnie 72 godziny od pojawienia się tego komunikatu. Po upływie tego okresu komunikat alertu błędu nadajnika będzie pojawiał się co 20 minut do czasu jego wymiany.	**Błąd baterii** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd związany z baterią nadajnika. Odczyty stężenia glukozy będą nadal wyświetlane, ale inteligentny nadajnik będzie wymagał wymiany.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu niezwłocznego przeprowadzenia wymiany nadajnika.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Dane niedostępne** Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd systemu. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu usunięcia błędu.	**Błąd godziny w systemie** Pojawia się, gdy system wykryje niezgodność czasu między zegarem urządzenia przenośnego a zegarem systemowym.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Podłącz stację dokującą za pomocą kabla do gniazda ściennego lub portu USB. Umieść inteligentny nadajnik w stacji i usuń go. Jeżeli problem nie ustąpi, wykonaj czynności opisane w części *Rozwiązywanie problemów*, aby zresetować inteligentny nadajnik. Jeżeli nie będziesz w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Ustaw godzinę w urządzeniu przenośnym na aktualny czas lokalny. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Alerty

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Wykryto nowe hasło** Pojawia się raz, gdy system wykryje, że hasło zostało zmienione za pośrednictwem konta Eversense DMS.	**Wykryto nowy czujnik** Pojawia się, gdy inteligentny nadajnik wykryje nowy czujnik. W celu nawiązania komunikacji wszczepiony czujnik i inteligentny nadajnik muszą zostać połączone.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wyloguj się z aplikacji mobilnej i zaloguj się ponownie, używając nowego hasła.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** W aplikacji mobilnej dotknij **Połącz czuj.**, aby wykonać proces łączenia i rozpocząć 24-godzinną fazę rozgrzewania. Nie musisz nosić nadajnika inteligentnego na ramieniu nad czujnikiem do czasu zakończenia fazy rozgrzewania.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Kalibruj teraz** Pojawia się, gdy nadszedł czas na kalibrację, system jest w fazie inicjalizacji lub po wprowadzeniu kalibracji, która bardzo różni się od poziomu glukozy z czujnika.	**Ponów kalibrację** Pojawia się, kiedy podczas kalibracji zebrano zbyt mało danych.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wykonaj test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca i wprowadź odczyt jako wartość kalibracji. Do kalibrowania systemu NIE WOLNO używać wartości poziomu glukozy z próbki krwi pobranej z innego miejsca (przedramię lub dłoń).	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Dotknij **Kalibruj** na urządzeniu przenośnym, aby wprowadzić nową wartość kalibracji.



Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Powiadomienia


Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**Wymagana nowa kalibracja** Pojawia się, gdy wartość kalibracji różni się znacząco od wartości z czujnika glukozy. Po mniej więcej 60 minutach pojawi się powiadomienie „Kalibruj teraz”.	**Wymiana czujnika** Pojawia się co 60, 30, 14, 7, 3 i 1 dzień przed zakończeniem okresu eksploatacji czujnika w celu przypomnienia o konieczności jego wymiany.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia terminu wymiany czujnika.

Alerty i powiadomienia wyświetlane na urządzeniu Apple Watch (cd.)

Powiadomienia

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch		
Opis	**1 dzienna kalibracja** Pojawia się, kiedy system wymaga kalibracji raz na 24 godziny.	**2 dzienne kalibracje** Pojawia się, kiedy system wymaga kalibracji dwa razy w ciągu dnia.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Wprowadź nową wartość kalibracji po wyświetleniu monitu.

Powiadomienia

Wyświetlacz urządzenia Apple Watch	
Opis	**Koniec okresu eksploatacji nadajnika, dzień 330** Pojawia się 35 dni przed upływem gwarancji nadajnika.
Działania	**Potwierdź alert w aplikacji mobilnej Eversense CGM.** Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zamówić nowy nadajnik.

15. Mój krąg

Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense E3 CGM i aplikacji Eversense NOW

Aplikacja Eversense CGM jest wyposażona w dodatkową funkcję zdalnego monitorowania. Aplikacja Eversense CGM łączy się z aplikacją do zdalnego monitorowania poziomu glukozy Eversense NOW umożliwiając innym osobom wyświetlanie Twoich danych.

Zagrożenia

Mogą wystąpić sytuacje, gdy dane dotyczące poziomu glukozy nie będą mogły być przesłane do aplikacji Eversense NOW. Jeśli osoba z Twojego kręgu nie otrzymuje danych glukozy z Twojego systemu Eversense E3 CGM, nie będzie mogła Ci pomóc w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Dodatkowy ekran oraz powiadomienia aplikacji mobilnej Eversense NOW nie zastępują głównego ekranu aplikacji mobilnej systemu Eversense CGM.

Członkowie Twojego kręgu nie zawsze mogą mieć połączenie służące do przesyłania danych, np. połączenie z Internetem/Wi-Fi lub siecią 3G/4G/LTE. Jeśli Ty lub członek Twojego kręgu nie będzie dysponować połączeniem internetowym, dane o Twoim poziomie glukozy nie będą dostępne do wyświetlania na dodatkowym ekranie. Wszelkie problemy z urządzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu, połączeniem do transmisji danych i systemem zarządzania bazą danych Eversense (DMS) oraz znalezienie się inteligentnego nadajnika poza zasięgiem urządzenia przenośnego lub ładowanie inteligentnego nadajnika mogą uniemożliwić wyświetlanie danych członkom Twojego kręgu. Nie należy zakładać, że inne osoby mające dostęp do zdalnego monitorowania Twojego poziomu glukozy, będą w stanie udzielić Ci pomocy w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

Funkcja zdalnego monitorowania umożliwia dodatkowe wyświetlanie powiadomień i danych osobom w Twoim kręgu. Nie jest to system zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym.

Korzyści

System Eversense E3 CGM używany razem z aplikacją do zdalnego monitorowania Eversense NOW może dać użytkownikom systemu CGM dodatkową pewność, dzięki świadomości, że inne osoby również mogą wyświetlić ich dane z systemu CGM.

Ostrzeżenia

- **Informacje o poziomie glukozy wyświetlane w aplikacji Eversense NOW nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących terapii. Do podejmowania decyzji dotyczących terapii zawsze należy używać pomiaru poziomu glukozy we krwi wykonanego za pomocą glukometru. Podejmowanie decyzji dotyczących terapii na podstawie poziomu glukozy z czujnika może skutkować wystąpieniem podwyższonego lub obniżonego poziomu glukozy we krwi. Aplikacja Eversense NOW pomocniczo do wyświetlania danych z systemu Eversense E3 CGM i nie należy jej używać jako ekranu głównego systemu Eversense E3 CGM.**
- **Nie można zakładać, że osoby zdalnie monitorujące poziom Twojej glukozy poinformują Cię o zdarzeniach wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.**

Przestrogi

- **Aplikacja Eversense NOW zastępuje schematu monitorowania pomiarów wskazanego przez lekarza prowadzącego.**
- **Jeśli nie masz włączonej funkcji automatycznej synchronizacji (funkcja, która umożliwia automatyczne przesyłanie danych do aplikacji Eversense NOW), nie będzie możliwe udostępnianie danych osobom w kręgu. Osoby te nie zobaczą trendów i zdarzeń wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.**
- **Jeśli Ty i członkowie Twojego kręgu macie połączenia z Internetem lub urządzenie przenośne użytkownika wyłączy się z powodu rozładowanej baterii, dane z systemu Eversense E3 CGM nie będą wyświetlane w aplikacji Eversense NOW.**
- **Jeśli członkowie kręgu wyłączą dźwięk w swoich urządzeniach przenośnych, nie będą otrzymywać alertów dźwiękowych dotyczących Twoich danych CGM w swojej aplikacji Eversense NOW.**

Przestrogi (cd.)

- **Jeśli ustawisz stan „Offline” z którymkolwiek członkiem Kręgu, członkowie Kręgu nie będą otrzymywali Twoich danych CGM w swojej aplikacji Eversense NOW. NIE ustawiaj stanu „Offline”, jeśli chcesz, by członkowie kręgu widzieli Twoje dane CGM.**
- **Aplikacja Eversense NOW komunikuje się bezpośrednio z czujnikiem Eversense E3 ani z inteligentnym nadajnikiem Eversense E3.**
- **Aplikacja Eversense NOW może zmienić ustawień aplikacji systemu Eversense CGM.**
- **Jeśli użytkownik systemu Eversense NOW nie wyrazi zgody na otrzymywanie powiadomień z aplikacji Eversense NOW nie będzie możliwości otrzymywania danych odczytów poziomu glukozy od użytkowników.**
- **Jeśli w urządzeniu przenośnym zostanie ustawiony tryb „Nie przeszkadzać”, powiadomienia z aplikacji Eversense NOW będą odtwarzane.**

Z ekranu **MÓJ KRĄG** aplikacji mobilnej Eversense możesz zaprosić maksymalnie pięć osób do wyświetlania Twoich danych. Zaproszenie członka do Twojego kręgu zostanie wysłane na podany adres e-mail. Po przyjęciu zaproszenia i pobraniu aplikacji Eversense NOW kręgu będą mogli wyświetlać ostatnie dane dotyczące Twojego poziomu glukozy, zdarzeń i alertów.

15


WAŻNE: członkowie Twojego kręgu, którzy nie mają aplikacji Eversense NOW, nie będą mieć dostępu do Twoich danych.


Jeśli Twoja aplikacja systemu Eversense CGM oraz aplikacja Eversense NOW mają połączenie z Internetem, Twoje dane dotyczące glukozy są synchronizowane z aplikacją Eversense NOW co około 5 minut. Synchronizacja wartości kalibracji do aplikacji Eversense NOW może potrwać dłużej.

Uwaga: w przypadku wyłączenia funkcji Automatyczna synchronizacja dane dotyczące glukozy NIE będą dostępne w aplikacji do zdalnego monitorowania Eversense NOW.

1. **W menu głównym dotknij Udostępnij moje dane > Mój krąg, aby wyświetlić ekran MÓJ KRĄG.**


2. **Aby zaprosić nową osobę do wyświetlania Twoich danych glukozy, wybierz polecenie Zaproś do mojego kręgu.**

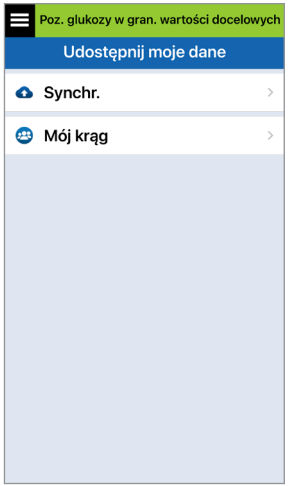

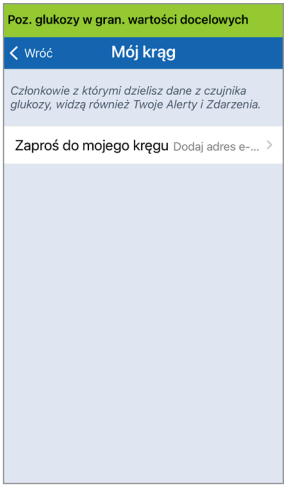


3. **Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do swojego kręgu, i wybierz przycisk Wyślij.**

Uwaga: możesz wybrać symbol „**+**” obok pola adresu e-mail, aby wybrać adres z listy kontaktów.

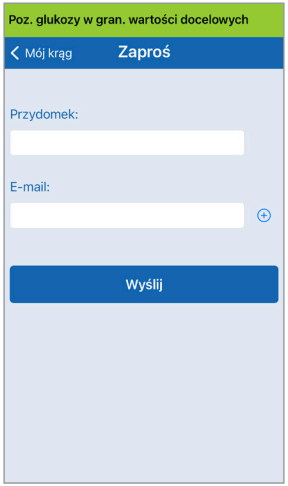


Porada: przydomki są opcjonalne i służą do łatwiejszego zarządzania członkami kręgu. Jeśli zdecydujesz się nie używać przydomku dla członka kręgu, zamiast niego wyświetlany będzie adres e-mail.

4. **Zostanie wyświetlony ekran Wysłano zaproszenie. Wybierz przycisk OK.**




Po zaakceptowaniu zaproszenia nazwa członka zostanie wyświetlona na liście członków na ekranie **MÓJ KRĄG** w Twojej aplikacji.

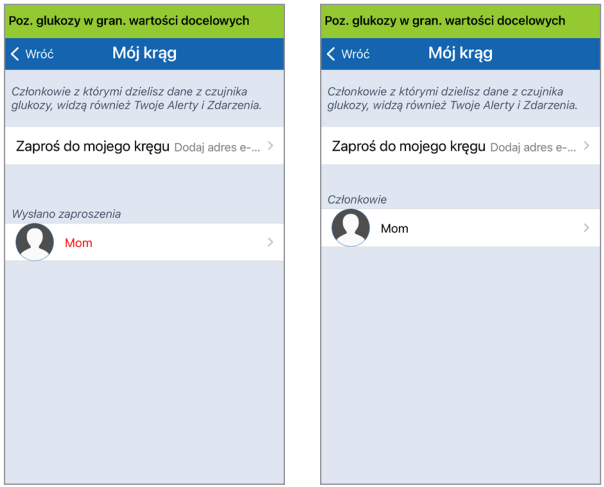


Uwaga: zdjęcia profilowe osób zdalnie wyświetlających Twoje dane glukozy muszą zostać skonfigurowane w koncie DMS przez właściciela konta. Nie możesz zmienić zdjęć profilowych osób zaproszonych do Twojego kręgu.

Usuwanie członka kręgu

1. Aby usunąć członka lub zaproszenie, wybierz nazwę członka kręgu na liście Członkowie lub liście Wysłano zaproszenia na ekranie **MÓJ KRĄG**.

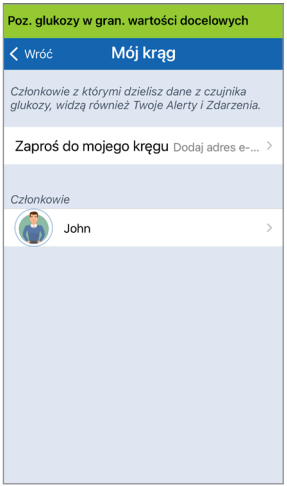

2. Dotknij **Usuń**, aby usunąć członka z kręgu. Po wyświetleniu monitu wybierz przycisk **Tak**.

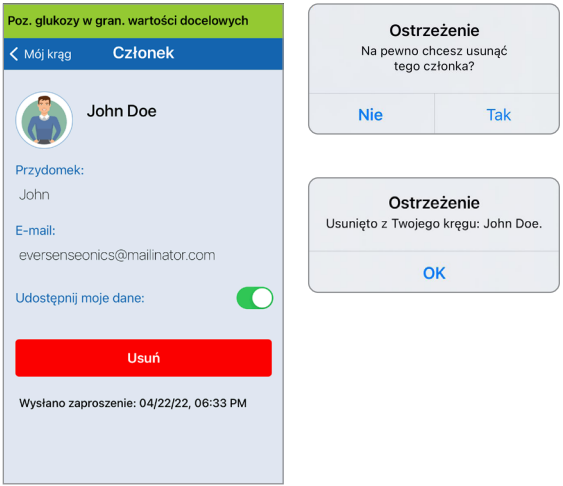


Członek, który został usunięty, otrzyma powiadomienie w swojej aplikacji Eversense NOW.


Czasowe przerwanie udostępniania danych

Możesz czasowo przerwać udostępnianie danych członkowi Twojego kręgu, nie usuwając go z kręgu.

1. **Wybierz nazwę członka na liście Mój krąg, aby wyświetlić ekran CZŁONEK.**

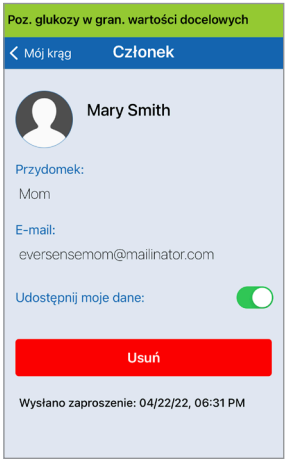

2. **Wybierz pozycję Udostępnij moje dane, aby włączyć/wyłączyć udostępnianie danych tej osobie.**

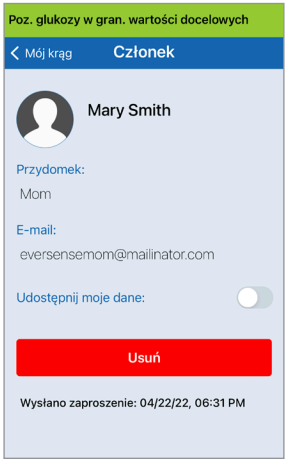

WAŻNE: w przypadku wyłączenia funkcji Udostępnij moje dane dla członka kręgu ta osoba nie będzie miała dostępu do żadnych danych glukozy z systemu Eversense E3 CGM, alertów i historii zdarzeń. Po wyłączeniu funkcji Udostępnij moje dane członkowie kręgu będą widzieć Twój status w aplikacji Eversense NOW Offline. Wyświetlenie zmiany w aplikacji Eversense NOW może zająć do 10 minut.

Uwaga: użytkownik Eversense NOW może też usunąć Ciebie ze swojej aplikacji. Wyświetlenie zmiany w Twojej aplikacji Eversense CGM może potrwać do 2 h.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o aplikacji Eversense NOW, patrz część *Eversense NOW*.

16. Informacje o czujniku

Rozdział opisuje czujnik Eversense E3 i metodę jego wszczepiania przez pracownika służby zdrowia.

Czujnik Eversense E3 to zminiaturyzowany fluorymetr, który wykorzystuje intensywność fluorescencji do pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym. Czujnik jest wszczepiany pod skórę, na ramieniu, tak aby żadna jego część nie wystawała ponad skórę. Czujnik pozostaje na miejscu przez maksymalnie 180 dni, dostarczając danych CGM.



Czujnik Eversense E3

Czujnik umieszczony jest w biozgodnym materiale i wykorzystuje unikalny polimer fluorescencyjny wykrywający glukozę. Wbudowana w czujnik dioda wzbudza polimer, który szybko sygnalizuje zmiany stężenia glukozy przez zmianę ilości wysyłanego światła. Wyniki pomiaru są następnie przekazywane do inteligentnego nadajnika. Pomiary są wykonywane automatycznie i nie wymagają żadnych działań użytkownika.

Czujnik ma wymiary 3,5 mm x 18,3 mm i jest wyposażony w silikonowy pierścień z niewielką ilością octanu deksametazonu, który jest lekiem sterydowym o działaniu przeciwzapalnym. Ogranicza on odpowiedź zapalną, bardzo zbliżoną do tej, którą wywołują powszechnie stosowane urządzenia medyczne, takie jak stymulatory pracy serca.

Etapy wszczepiania

Pracownik służby zdrowia objaśni użytkownikowi systemu i wykona wszystkie (proste i łatwe) kroki zabiegu wszczepiania czujnika. Zabieg wszczepiania, podczas której pacjent zachowuje pełną przytomność, zajmuje około 5 minut.

Miejsce wszczepienia:

Należy wybrać miejsce wszczepienia na ramieniu, które będzie wygodne do noszenia czujnika wraz z inteligentnym nadajnikiem przez okres maksymalnie 180 dni. Zalecane miejsce wszczepienia to tylna część ramienia. Umieszczenie czujnika i nadajnika w tym miejscu obniża ryzyko uderzenia nadajnika o drzwi, ścianę lub w wąskich przejściach. W miarę możliwości należy unikać miejsc, w których skóra jest luźna, miejsc z ranami lub tatuażami oraz miejsc z dużą liczbą naczyń krwionośnych, które mogłyby zostać przecięte w czasie wszczepiania. Zaleca się, aby kolejne wszczepienia czujnika przeprowadzać, zmieniając ramię.

Krok 1: **Przygotowanie miejsca wszczepienia –** miejsce wszczepienia należy wyczyścić i zdezynfekować, a następnie znieczulić za pomocą lidokainy.

Krok 2: **Nacięcie –** w miejscu wszczepienia należy wykonać małe nacięcie (mniejsze niż 1 centymetr).

Krok 3: **Wszczepianie czujnika –** należy utworzyć kieszeń podskórną pod skórą, w której zostanie umieszczony czujnik.

Krok 4: **Zamknięcie miejsca wszczepienia –** nacięcie należy zamknąć za pomocą opatrunku samoprzylepnego. Opatrunki Steri Strips™ są zazwyczaj stosowane do zamknięcia nacięcia.

Krok 5: **Łącznie czujnika i inteligentnego nadajnika –** czujnik i inteligentny nadajnik należy połączyć w celu rozpoczęcia 24-godzinnej fazy rozgrzewania.

Uwaga: **Po wszczepieniu należy połączyć i inteligentny nadajnik i czujnik, a następnie odczekać 24 godziny na zagojenie się rany przed założeniem nadajnika**.

Czujnik wymaga 24-godzinnego okresu stabilizacji w miejscu wszczepienia, zwanego fazą rozgrzewania. Po upływie 24 godzin od wszczepienia czujnika należy nad nim umieścić inteligentny nadajnik i upewnić się, że oba urządzenia są połączone (patrz rozdział *Codzienne noszenie nadajnika*). Następnie można przeprowadzić kalibrację w ramach fazy inicjalizacji, przy użyciu glukometru, wykonując 4 pomiary krwi pobrane z opuszki palca.

Etapy wyjmowania

Podobnie jak w przypadku zabiegu wszczepiania, pracownik służby zdrowia objaśni proste i szybkie kroki zabiegu usuwania czujnika. Podczas tego zabiegu usuwania trwającego (ok.) 5 minut pacjent zachowuje pełną przytomność.

Krok 1: **Przygotowanie miejsca wszczepienia –** miejsce wszczepienia czujnika należy wyczyścić i zdezynfekować, a następnie znieczulić za pomocą lidokainy.

Krok 2: **Nacięcie –** w miejscu wszczepienia czujnika należy wykonać małe nacięcie (mniejsze niż 1 centymetr).

Krok 3: **Usuwanie czujnika –** czujnik należy usunąć i zutylizować.

Krok 4: **Zamknięcie miejsca wszczepienia –** po usunięciu nacięcie należy zamknąć za pomocą opatrunku Steri Strips™ (w zależności od preferencji pracownika służby zdrowia można założyć szwy).

17. Podróże

Rozdział opisuje zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie podróży z czujnikiem i nadajnikiem Eversense E3.

W czasie podróży można bezpiecznie przechodzić przez bramki na lotnisku z założonym czujnikiem i nadajnikiem. Należy poinformować personel kontroli bezpieczeństwa o wszczepionym czujnika i założonym na ramieniu nadajniku.

Inteligentny nadajnik wykonuje automatyczną synchronizację daty i godziny z urządzeniem przenośnym po zmianie strefy czasowej.

Można bezpiecznie korzystać z systemu Eversense E3 CGM w samolotach linii lotniczych Stanów Zjednoczonych. Inteligentny nadajnik Eversense E3 to przenośne urządzenie medyczne (M-PED), którego poziomy emisji spełniają wymagania FAA dotyczące wszystkich trybów pracy w czasie lotu. (Zob. FAA Advisory, okólnik nr 21-16G, z dnia 22.06.2011 r.). Aby używać systemu, należy ustawić tryb offline w urządzeniu przenośnym, a następnie włączyć funkcję Bluetooth. W przypadku lotów poza USA należy stosować się do lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących używania urządzeń medycznych w czasie lotu.

18. Rozwiązywanie problemów

Rozdział opisuje rozwiązywanie problemów z systemem Eversense E3 CGM oraz zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Inteligentny nadajnik

P: W jaki sposób mogę wyłączyć inteligentny nadajnik?

O: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nadajnika przez 5 sekund. Zwolnij przycisk, gdy nadajnik zawibruje.

P: W jaki sposób mogę włączyć inteligentny nadajnik?

O: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nadajnika przez 5 sekund. Zwolnij przycisk, gdy nadajnik zawibruje.

P: W jaki sposób prawidłowo umieścić inteligentny nadajnik nad czujnikiem?

O: Istnieją dwie metody zapewniające prawidłowe umieszczenie nadajnika:

1. W przypadku korzystania z przylepca do mocowania nadajnika upewnij się, że symbol przycisku zasilania i kontrolka LED są ustawione równolegle do ramienia.
2. Użyj ekranu **PRZEWODNIK UMIESZCZANIA** w aplikacji, aby potwierdzić połączenie między czujnikiem i nadajnikiem.
   - Dotknij opcji **Przewodnik umieszczania**.
   - Umieść inteligentny nadajnik nad czujnikiem, aby potwierdzić połączenie.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat siły sygnału i pozycjonowania nadajnik, należy zapoznać się z częścią *Ekran Przewodnik umieszczania – Pokaż więcej szczegółów* w rozdziale *Łączenie czujnika*.

P: Inteligentny nadajnik nie wibruje. Dlaczego?

O: Jeżeli inteligentny nadajnik nie wibruje, wypróbuj poniższe rozwiązania:

- Sprawdź, czy inteligentny nadajnik jest sparowany z urządzeniem przenośnym.
- Sprawdź, czy tryb **Nie przeszkadzać** jest wyłączony poprzez dotknięcie opcji **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia dźwięku**.

- Sprawdź, czy bateria nadajnika ma wystarczającą ilość energii, i naładuj ją w razie potrzeby.

Jeżeli inteligentny nadajnik w dalszym ciągu nie wibruje, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem.

P: Czy mogę zdjąć i założyć ten sam przylepiec częściej niż raz dziennie?

O: Wielokrotne usuwanie i zakładanie może zmniejszyć siłę przylegania.

P: Jaki jest numer seryjny i numer modelu nadajnika?

O: Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na tylnej ściance nadajnika. Po sparowaniu inteligentnego nadajnika i urządzenia przenośnego można wyświetlić numer seryjny i model poprzez dotknięcie opcji **Menu** > **Informacje** > **Mój nadajnik**.

P: W jaki sposób mogę zmienić nazwę nadajnika?

O: Dotknij opcji **Menu** > **Ustawienia** > **System** > **Nazwa nadajnika**. Wpisz żądaną nazwę. Zaktualizowana nazwa nadajnika pojawi się na ekranie stanu połączenia.

P: Dlaczego kontrolka nadajnika świeci stale na pomarańczowo?

O: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Upewnij się, że nadajnik jest sparowany z urządzeniem przenośnym.
2. Upewnij się, że bateria nadajnika jest naładowana.
3. Sprawdź alerty i powiadomienia w aplikacji.
4. Zdejmij nadajnik z ramienia i poczekaj kilka minut. Gdy wyświetli się komunikat **Nie wykryto czujnika**, inteligentny nadajnik powinien wibrować częściej niż zwykle, ponieważ wyszukuje czujnika. Jeśli inteligentny nadajnik nie wibruje lub jeśli aplikacja nie wyświetla komunikatu **Nie wykryto czujnika**, skontaktuj się z działem obsługi klienta w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy spoza USA powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Umieść inteligentny nadajnik z powrotem nad czujnikiem, aby sprawdzić, czy pomarańczowa kontrolka zgaśnie, obserwuj powiadomienia w aplikacji.

Jeżeli pomarańczowa kontrolka świeci dalej, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Bateria inteligentnego nadajnika i jej ładowanie

P: Jak długo działa w pełni naładowana bateria?

O: W pełni naładowana bateria inteligentnego nadajnika działa przez mniej więcej 24–36 godzin.

P: Jak długo trwa naładowanie baterii inteligentnego nadajnika?

O: Całkowite naładowanie baterii trwa około 15 minut od momentu podłączenia kabla do gniazda ściennego. W przypadku ładowania z portu USB komputera lub jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany może to potrwać dłużej.

P: Co się stanie po całkowitym rozładowaniu baterii nadajnika?

O: Nie będą wyświetlane odczyty poziomu glukozy. Po stwierdzeniu rozładowania baterii należy natychmiast rozpocząć jej ładowanie.

P: Jak mogę sprawdzić stan baterii nadajnika?

O: Istnieją trzy sposoby sprawdzania stanu baterii nadajnika:

1. Dotknij opcji **Menu** > **Informacje** > **Mój nadajnik**. Przewiń ekran w dół, do wiersza Poziom baterii, który pokazuje ilość energii pozostałą w baterii.
2. Sprawdź symbol baterii w prawym górnym rogu na ekranie **MOJA GLUKOZA**. Czerwona ikona baterii wskazuje, ze poziom naładowania baterii jest niski.
3. Włącz inteligentny nadajnik. Wciśnij i zwolnij przycisk zasilania nadajnika. Pomarańczowa kontrolka wskazuje na niski poziom naładowania baterii nadajnika. Zielona kontrolka wskazuje, że w baterii pozostało przynajmniej 10% energii.

P: Na ekranie Informacje > Mój nadajnik wskaźnik poziomu naładowania baterii pokazuje 65%, a następnie 35%. Dlaczego tak się dzieje?

O: Szybkość rozładowywania baterii różni się w zależności od stylu jej użytkowania; taka sama bateria będzie się rozładowywała inaczej w dwóch różnych urządzeniach. Dlatego też wskaźniki poziomu naładowania opisane są z dużymi przyrostami: 100%, 65%, 35%, 10% i 0%. Z naszych badań wynika, że alert „Niski poziom baterii" jest wyzwalany niezmiennie w punkcie, w którym pozostała ilość energii pozwala na mniej więcej 2 godziny pracy nadajnika (ok. 10%). Po otrzymaniu alertu „Niski poziom baterii" należy niezwłocznie rozpocząć ładowanie.

Łączenie z inteligentnym nadajnikiem

P: W jaki sposób mogę po raz pierwszy sparować urządzenie przenośne z inteligentnym nadajnikiem?

O: Aby sparować urządzenie przenośne z nadajnikiem, wykonaj poniższą procedurę. Szczegółowe informacje zamieszczono w niniejszej instrukcji użytkownika.

1. Uruchom aplikację Eversense.
2. Naciśnij trzykrotnie przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika, aby przejść do trybu „Widoczny".
3. Gdy inteligentny nadajnik miga na zielono i pomarańczowo, dotknij identyfikatora inteligentnego nadajnika na ekranie **POŁĄCZ**. Aplikacja rozpocznie proces wyszukiwania.
   - Identyfikator inteligentnego nadajnika jest identyczny z numerem seryjnym na jego tylnej ściance.
4. Gdy aplikacja wykryje inteligentny nadajnik, wyświetli się wyskakujący ekran **ŻĄDANIE PAROWANIA BLUETOOTH**.
5. Dotknij opcji **Połącz**, aby potwierdzić parowanie.
6. Po zakończeniu parowania aplikacja wyświetli komunikat **Połączono** obok identyfikatora inteligentnego nadajnika.

P: Mam wrażenie, że inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały połączone.

O: Brak połączenia może wynikać z wielu przyczyn.

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest włączona oraz że nazwa lub numer seryjny inteligentnego nadajnika pojawiły się na liście urządzeń.
- Taki stan może być tylko przejściowy. Dotknij opcji **Menu** > **Połącz**. Jeśli przy nazwie inteligentnego nadajnika wyświetlany jest status **Odłączono**, dotknij nazwy inteligentnego nadajnika w celu ręcznego nawiązania połączenia.
- Nadajnik może być poza zasięgiem połączenia bezprzewodowego urządzenia przenośnego. Przesuń urządzenie przenośne bliżej nadajnika.
- Inteligentny nadajnik może być wyłączony, a jego bateria może być rozładowana lub właśnie się ładować. Może wystąpić konieczność ponownego włączenia funkcji Bluetooth (BLE) inteligentnego nadajnika przez wykonanie poniższych czynności.

  1. Wyłącz inteligentny nadajnik – naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund i poczekaj, aż wyłączenie nadajnika zostanie potwierdzone przez wibracje.
  2. Aby ponownie włączyć funkcję BLE, poczekaj 2 sekundy i naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania. (**Uwaga: Podczas ponownego włączania funkcji BLE nie wolno usuwać sparowanego urządzenia / zapominać go w ustawieniach Bluetooth urządzenia przenośnego.)**
  3. Ponownie naciśnij trzykrotnie przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika, aby ustawić go w trybie „Widoczny" i sparować z urządzeniem przenośnym. Dotknij opcji **Menu** > **Połącz**, aby sprawdzić, czy inteligentny nadajnik jest podłączony. W przypadku braku połączenia dotknij nazwy inteligentnego nadajnika na liście.

  Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, można przejść do ustawień Bluetooth urządzenia mobilnego i anulować parowanie lub zapomnieć nadajnik, a następnie trzykrotnie wcisnąć przycisk zasilania w celu sparowania urządzenia. Jeżeli problem się powtarza, może wystąpić konieczność zrestartowania nadajnika.

P: W jaki sposób mogę zresetować inteligentny nadajnik?

O: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Umieść inteligentny nadajnik w stacji dokującej i podłącz kabel USB. Podłącz kabel do gniazda ściennego. (Możesz też podłączyć kabel USB do gniazda w USB w komputerze).

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (przez mniej więcej 14 sekund) na inteligentnym nadajniku po podłączeniu kabla USB. Zwolnij przycisk zasilania.
3. Dioda LED zacznie migać po mniej więcej dwóch sekundach, informując o tym, że inteligentny nadajnik przeprowadza ostatnią sekwencję testu autodiagnostycznego. Dioda LED zacznie migać w różnych kolorach. Po zakończeniu testu autodiagnostycznego inteligentny nadajnik zawibruje, a kontrolka LED będzie świecić stałym światłem na zielono lub pomarańczowo.
4. Jeżeli test autodiagnostyczny nie zostaną ukończone, powtórz kroki od 1 do 3.
5. Jeśli krok 3 zostanie wykonany pomyślnie, inteligentny nadajnik jest gotowy do użycia.
6. Odłącz inteligentny nadajnik od kabla USB i kontynuuj procedurę parowania. Po sparowaniu system przejdzie do fazy inicjalizacji. Jeżeli nie będziesz w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

P: Czy ktoś inny może się podłączyć do mojego nadajnika?

O: System Eversense E3 CGM wykorzystuje bezpieczne połączenie Bluetooth i nie umożliwi połączenia innej osobie.

P: Co się stanie, gdy inteligentny nadajnik zostanie odłączony od urządzenia przenośnego lub aplikacji?

O: Inteligentny nadajnik będzie wibrował, zaś aplikacja, na podstawie ustawień dźwięku, będzie wyświetlała powiadomienie „Nadajnik odłączony" co 5–30 minut do momentu jej wyłączenia lub ponownego podłączenia nadajnika. Po ponownym nawiązaniu połączenia pobrane dane zostaną zsynchronizowane z aplikacją mobilną.

P: Dlaczego nie mogę połączyć urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem (na pasku zadań wyświetlany jest komunikat „Nie połączono nadajnika")?

O: Inteligentny nadajnik może się nie łączyć z urządzeniem przenośnym z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane lub cofnięto sparowanie. Należy sparować oba urządzenia.

P: Dlaczego na ekranie POŁĄCZ jest wyświetlany komunikat Wyszukiwanie?

O: Aplikacja będzie wyświetlała komunikat **Wyszukiwanie** z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane lub cofnięto sparowanie. Należy sparować oba urządzenia.

P: Na czym polega tryb„Widoczny” (parowania)?

O: Tryb „Widoczny” to taki tryb pracy inteligentnego nadajnika, w którym może on zostać wykryty przez urządzenie przenośne (jest dla niego „widoczny”) na potrzeby parowania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Rozpoczynanie pracy*.

P: Dlaczego mój inteligentny nadajnik nie jest wymieniony na ekranie POŁĄCZ?

O: Inteligentny nadajnik nie znajduje się na liście na ekranie **POŁĄCZ** z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika przez kabel USB.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane lub cofnięto sparowanie. Należy sparować oba urządzenia.

P: Dlaczego na ekranie POŁĄCZ są wyświetlane inne inteligentne nadajniki?

O: Jeżeli w pobliżu są inni użytkownicy systemu Eversense E3 CGM, aplikacja może znaleźć te urządzenia. Aplikacja połączy się jednak tylko z inteligentnym nadajnikiem, który został sparowany z urządzeniem przenośnym. NIE WOLNO podejmować próby parowania z innymi nadajnikami.

P: Właśnie odebrałem(-am) nowy inteligentny nadajnik. W jaki sposób mogę usunąć parowanie starego nadajnika i połączyć system z nowym nadajnikiem?

O: W menu głównym dotknij opcji **Połącz**. Dotknij i przytrzymaj nazwę swojego starego nadajnika. Dotknij opcji **OK**, aby uniemożliwić aplikacji automatyczne nawiązanie połączenia ze starym inteligentnym nadajnikiem. Zapomnij stary inteligentny nadajnik z ustawień Bluetooth telefonu. Wykonaj procedury parowania nowego inteligentnego nadajnika z aplikacją oraz powiązania go z czujnikiem, opisane w Instrukcji użytkownika.

Kalibracja

P: Jaką godzinę muszę wprowadzić na ekranie KALIBRUJ, kiedy otrzymam powiadomienie o konieczności przeprowadzenia kalibracji?

O: Godzinę wykonania badania glukometrem. Wynik musisz wprowadzić w ciągu 10 minut od wykonania badania glukometrem.

P: Dlaczego kalibracja została odrzucona?

O: System może odrzucić kalibrację z poniższych przyczyn:

- Wprowadzona wartość odczytu poziomu glukozy jest mniejsza niż 40 mg/dl.
- Wprowadzona wartość odczytu poziomu glukozy jest większa niż 400 mg/dl.

Jeśli wymagana będzie kolejna kalibracja, system wyświetli monit.

P: Dlaczego nie mogę wykonać kalibracji?

O: Brak możliwości wykonania kalibracji może wynikać z poniższych przyczyn:

- Nie zabrano wystarczającej ilości danych poziomu glukozy z czujnika, co może zająć do 5 minut.
- Wartości glukozy z czujnika zmieniają się szybko, np. po posiłku lub po podaniu insuliny.
- Wartość odczytu poziomu glukozy jest mniejsza niż 40 mg/dl.
- Wartość odczytu poziomu glukozy jest większa niż 400 mg/dl.
- Wartość poziomu glukozy została zmierzona ponad 10 minut przed jej wprowadzeniem do aplikacji Eversense.
- Ostatnia wartość wskazania czujnika różni się znacznie od wprowadzonego wskazania glukometru.
- Kalibracja jest w toku.
- Minęła mniej niż 1 godzina od ostatniej pomyślnej kalibracji.
- Nadajnik jest odłączony.
- Nadajnik nie jest połączony z czujnikiem.
- Czujnik wymaga wymiany.

P: Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje o fazie kalibracji, liczbie kalibracji oraz ostatnim dniu i godzinie kalibracji?

O: Szczegóły kalibracji można wyświetlić poprzez naciśnięcie opcji **Menu** > **Informacje** > **Mój nadajnik**.

P: Jakie są różne fazy kalibracji?

O: W systemie Eversense E3 CGM występują trzy fazy kalibracji: faza inicjalizacji, 2 kalibracja dzienna i 1. kalibracja dzienna. Faza inicjalizacji rozpoczyna się 24 godziny po wszczepieniu czujnika i wymaga wprowadzenia 4 wyników badania próbek krwi glukometrem w celu skalibrowania urządzenia. System powiadomi pacjenta, gdy 1. lub 2. kalibracja w ciągu dnia będzie potrzebna.

Alerty i powiadomienia.

P: Czy mogę zmienić wzór alertu wibracyjnego generowanego przez nadajnik?

O: Wzory wibracji inteligentnego nadajnika są stałe i nie można ich zmieniać. W przypadku niektórych alertów można zmienić częstotliwość w obszarze **Ustawienia** > **Ustawienia dźwięku**.

P: Czy mogę zwiększyć głośność dźwięków generowanych przez aplikację na urządzeniu przenośnym?

O: Możesz zwiększyć głośność dźwięków aplikacji na urządzeniu przenośnym, podłączając je do zewnętrznego wzmacniacza.

P: Czy mogę zmienić liczbę odbieranych alertów?

O: Jeżeli uznasz, że otrzymujesz zbyt wiele alertów, musisz najpierw ustalić z pracownikiem służby zdrowia, jakie ustawienia alertów będą najbardziej wskazane. Jeśli chcesz zmienić ustawienia alertów dotyczących poziomu glukozy, dotknij opcji **Menu** > **Ustawienia** > **Glukoza**.

P: Czym są alerty o szybkości zmian?

O: Alerty o szybkości zmian powiadamiają użytkownika, gdy poziom glukozy spada lub rośnie szybciej niż ustawienie wybrane w obszarze **Ustawienia** > **Glukoza**.

P: Jaka jest różnica między alertem i powiadomieniem?

O: Powiadomienie to komunikat niekrytyczny, o niskim priorytecie (np. przypomnienie o kalibracji).

Alert to ważny komunikat, na który należy zwrócić uwagę i zareagować lub ewentualnie wykonać zalecane czynności.

P: Czym są alerty przewidywania?

O: Alerty przewidywania informują z wyprzedzeniem o zdarzeniu, które prawdopodobnie wystąpi, jeśli obecne trendy zostaną utrzymane. Alerty przewidywania wykorzystują wartości graniczne wysokiego i niskiego poziomu glukozy, ustalane w celu określenia, kiedy mają być generowane alerty przewidywania. Alerty można ustawić z 10-, 20- lub 30-minutowym wyprzedzeniem przed przewidzianym przez system CGM osiągnięciem ustawionych poziomów alertów. Inteligentny nadajnik zawibruje, a aplikacja wygeneruje alert i wyświetli komunikat na ekranie **MOJA GLUKOZA**, aby powiadomić użytkownika o przewidywanym wysokim lub niskim poziomie glukozy. Jeśli objawy nie są zgodne z wartością poziomu glukozy z czujnika lub ze wskazaniami alertów, przed podjęciem decyzji o leczeniu pacjent powinien wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca.

P: Czym są alerty o szybkości zmian?

O: Alerty o szybkości zmian powiadamiają użytkownika, gdy poziom glukozy spada lub rośnie szybciej niż ustawienie wybrane w obszarze **Ustawienia** > **Glukoza**.

P: Dlaczego nie mogę zobaczyć powiadomień, kiedy aplikacja pracuje w tle?

O: Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego, w jaki sposób włączyć powiadomienia w tle.

P: Co się dzieje z powiadomieniami, kiedy aplikacja zostanie odłączona od nadajnika?

O: Jeżeli aplikacja zostanie odłączona od nadajnika, ale bez zdejmowania nadajnika z ramienia, alerty odbierane w tym czasie będą przesyłane do aplikacji po jej ponownym podłączeniu i zsynchronizowaniu z nadajnikiem.

P: W jaki sposób mogę posortować powiadomienia na ekranie HISTORIA ALERTÓW?

O: Na górze ekranu **HISTORIA ALERTÓW** znajduje się filtr do sortowania. Możesz sortować alerty wg ich znaczenia (żółty i niebieski) oraz wg typu. Wybierz odpowiednią ikonę filtra.

P: Jak wyciszyć alerty poziomu glukozy?

O: Alerty poziomu glukozy można wyciszyć, potwierdzając je na urządzeniu przenośnym i podejmując wymagane działania.

Odczyty poziomu glukozy

P. Dlaczego odczyt z czujnika różni się od odczytu z glukometru?

O: System Eversense E3 CGM dokonuje pomiaru glukozy w płynie tkankowym (ISF) wypełniającym przestrzeń pomiędzy komórkami ciała. Fizjologiczne różnice pomiędzy ISF i krwią pobraną z opuszki mogą być powodem różnic w pomiarach glukozy. Różnice te są szczególnie widoczne w okresach gwałtownych zmian stężenia glukozy we krwi (np. po jedzeniu, podaniu insuliny lub ćwiczeniach) oraz u niektórych osób w ciągu pierwszych kilku dni po wszczepieniu, z powodu stanu zapalnego, który może wynikać z zabiegu wszczepienia. Najczęściej wartości stężenia glukozy w ISF zmieniają się z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wartości stężenia glukozy we krwi. Jeśli użytkownik nie jest świadomy różnic, powinien potwierdzić odczyty z czujnika za pomocą testu glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca. Jeśli objawy nie są zgodne z odczytami czujnika glukozy, użytkownik również powinien wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszki palca.

P: Aplikacja wyświetla „-- -- --” zamiast odczytu czujnika glukozy.

O: Odczyty czujnika glukozy mogą nie zostać wyświetlone w przypadku braku połączenia między czujnikiem lub inteligentnym nadajnikiem i urządzeniem przenośnym.

Może to również mieć miejsce, gdy został aktywowany jeden z poniższych alertów:

- Nie wykryto czujnika.
- Odczyt z czujnika wykraczający poza górny lub dolny zakres.
- Niska temperatura czujnika.
- Dużo światła w otoczeniu.
- Kontrola czujnika.
- Wysoka temperatura inteligentnego nadajnika.
- Wysoka temperatura czujnika.
- Bateria rozładowana.
- Minął termin wymaganej kalibracji.
- Wykryto nowy czujnik.
- Wymiana czujnika.
- Kalibracja przeterminowana.
- Błąd inteligentnego nadajnika.
- Alert dotyczący wymiany nadajnika.
- Alert wstrzymania czujnika.

Aby skasować alert, należy wykonać polecenia wymienione w komunikacie powiadomienia.

Podejmowanie decyzji o leczeniu

P: Jakie informacje należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o leczeniu?

O: Przed podjęciem decyzji o leczeniu pacjenci powinni wziąć pod uwagę wartość stężenia glukozy z czujnika, wykres trendu, strzałkę trendu i wszelkie alerty z systemu Eversense E3 CGM. Jeśli strzałka trendu nie jest wyświetlana, system nie ma wystarczającej ilości danych, aby wyświetlić kierunek i szybkość zmian. Nie wolno podejmować decyzji o leczeniu wyłącznie na podstawie wartości poziomu glukozy z czujnika.

P: Dlaczego wartość poziomu glukozy jest oznaczona na szaro?

O: Gdy system nie ma wystarczającej ilości danych do wygenerowania strzałki trendu, wartość poziomu glukozy z czujnika może być wyświetlana na szaro. Nie wolno podejmować decyzji o leczeniu wyłącznie na podstawie wartości poziomu glukozy z czujnika.

P: Kiedy należy wykonać badanie próbki krwi glukometrem?

O: Badanie glukometrem należy wykonywać, gdy:

- Wykonywana jest zaplanowana kalibracja.
- Wartość poziomu glukozy nie jest wyświetlana.
- Strzałka trendu nie jest wyświetlana.
- Objawy nie są zgodne z wyświetlanymi informacjami o poziomie glukozy.
- Bieżąca wartość poziomu glukozy z czujnika jest wyświetlana na szaro.
- Pasek stanu jest wyświetlany na pomarańczowo.
- Pacjent przyjmuje leki z klasy tetracyklin.

Strzałki trendu

P: Strzałki trendu i alerty poziomu glukozy nie są zgodne.

O: Strzałki trendu wskazują tempo i kierunek zmian poziomu glukozy. Na przykład strzałka trendu może być skierowana do góry lub do dołu (wskazując wolne lub szybkie tempo zmian). Alerty poziomu glukozy informują o osiągnięciu ustawionej wartości alertu poziomu glukozy, niezależnie od tempa i kierunku zmiany.

P: Strzałka trendu nie jest wyświetlana.

O: Aby wykonać obliczenia i wyświetlić strzałkę trendu, system CGM wykorzystuje **dane dotyczące stałego monitorowania poziomu glukozy z ostatnich 20 minut**. W przypadku braku wystarczającej liczby wartości wskazań czujnika do obliczeń strzałka nie jest wyświetlana. Pacjent nie powinien podejmować decyzji o leczeniu, jeśli wartość poziomu glukozy i strzałka trendu nie są wyświetlane oraz jeśli nie wziął pod uwagę ostatnich trendów i alertów.

Aplikacja

P: Co się stanie, gdy przeinstaluję aplikację?

O: Po przeinstalowaniu aplikacja pobierze dane historyczne tylko z ostatnich 3 dni.

P: Jak sprawdzić wersję aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym?

O: Wersję aplikacji można wyświetlić poprzez dotknięcie opcji **Menu** > **Informacje** > **Informacje o produkcie**.

P: W jaki sposób aplikacja będzie aktualizowana?

O: Postępuj zgodnie z procesem aktualizacji aplikacji mobilnej, korzystając ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.

P: Z jakimi urządzeniami aplikacja Eversense jest zgodna?

O: Listę zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie **https://global.eversensediabetes.com/compatibility**.

P: Czy mogę używać tego samego nadajnika po zmianie urządzenia przenośnego?

O: Konieczne będzie zainstalowanie aplikacji na nowym urządzeniu przenośnym i sparowanie urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem. Aplikacja na nowym urządzeniu mobilnym zsynchronizuje dane historyczne tylko z ostatnich 3 dni.

P: Czy mogę usunąć swoje konto Eversense?

O: Jeśli usuniesz swoje konto, czynność ta jest trwała. Utracisz dostęp do swoich danych CGM w aplikacji mobilnej Eversense oraz na koncie Eversense DMS. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Eversense NOW, nie będziesz już mógł zdalnie przeglądać CGM Eversense. Nie możesz użyć tego samego adresu e-mail do utworzenia nowego konta. Aby zainicjować proces usuwania konta, naciśnij opcję **Usuń konto** na stronie logowania.

P: Na czym polega funkcja Nie przeszkadzać?

O: Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać w aplikacji Eversense aplikacja mobilna przestanie wyświetlać alerty niekrytyczne. Inteligentny nadajnik przestanie również przesyłać powiadomienia wibracyjne dotyczące alertów niekrytycznych. Alerty krytyczne będą w dalszym ciągu dostarczane za pośrednictwem inteligentnego nadajnika i aplikacji mobilnej.

Funkcja Nie przeszkadzać w smartfonie ma priorytet nad funkcją Nie przeszkadzać w aplikacji. Dlatego też jeśli w smartfonie włączono funkcję Nie przeszkadzać, nie będziesz odbierać alertów nadajnika w aplikacji. Jednak w przypadku niektórych systemów operacyjnych telefonów można zezwolić na nadpisywanie ustawień urządzenia przenośnego przez alerty Niski poziom glukozy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Ustawienia dźwięku*. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą automatycznie włączać w telefonie tryb „Nie przeszkadzać".

P: Dlaczego na pasku stanu wyświetlany jest komunikat „Synchronizacja"?

O: Komunikat „Synchronizacja" wyświetli się na pasku stanu, gdy aplikacja na urządzeniu przenośnym zostanie połączona z inteligentnym nadajnikiem.

P: Ustawienia mojej glukozy i ustawienia profilu tymczasowego są wyszarzone i nie mogę ich dostosować.

O: Aplikacja musi zostać sparowana z inteligentnym nadajnikiem, aby dostosowanie ustawień glukozy i profilu tymczasowego było możliwe.

P: Czy mogę edytować ręczne zdarzenie glukozy we krwi?

O: Ręczne wpisy dotyczące glukozy we krwi i kalibracji nie mogą być edytowane.

P: Czy jeśli ukryję zdarzenie, mogę je później przywrócić?

O: Wpisów zdarzeń, które zostały ukryte nie można przywrócić.

P: Jakie odstępy powtarzania można ustawić dla wysokiego i niskiego poziomu glukozy?

O: W przypadku wysokiego poziomu glukozy odstęp powtarzania można ustawić na czas od 15 do 180 minut, w krokach co 15 minut. W przypadku niskiego poziomu glukozy odstęp powtarzania można ustawić na czas od 5 do 30 minut w krokach co 5 minut.

Czujnik

P: Czy czujnik można wszczepić w inną część ciała niż górna część ramienia?

O: Podczas badań klinicznych system Eversense E3 CGM był testowany wyłącznie w górnej części ramienia, w związku z czym nie należy go wszczepiać w inne miejsca.

P: Kiedy muszę wymienić czujnik?

O: Czujnik działa przez maksymalnie 180 dni. Będziesz otrzymywać okresowe przypomnienia o terminie wymiany czujnika (na 60, 30, 14, 7, 3 i na 1 dzień przed terminem wymiany). Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu zaplanowania wymiany czujnika.

P: Czy mogę przedłużyć okres użytkowania czujnika?

O: Po upłynięciu limitu czasu noszenia czujnik nie będzie zapewniał odczytów poziomu glukozy.

P: Gdzie mogę znaleźć numer seryjny czujnika?

O: Numer seryjny czujnika można wyświetlić poprzez dotknięcie opcji **Menu** > **Informacje** > **Mój czujnik**.

P: Właśnie udało mi się po raz pierwszy połączyć czujnik z nadajnikiem, ale po dotknięciu pozycji Informacje > Mój czujnik data i/lub godzina wszczepienia czujnika nie są wyświetlane.

O: Cały proces łączenia może zająć maksymalnie 10 minut. Upewnij się, że nadajnik znajduje się nad czujnikiem. Sprawdź, czy na ekranie **POŁĄCZONY CZUJNIK** wyświetlany jest symbol zaznaczenia obok komunikatu Ukończono proces łączenia. Przejdź do ekranu **MOJA GLUKOZA** i odczekaj około 2 minuty. Wróć do ekranu **MÓJ CZUJNIK**.

Jeżeli prawidłowe informacje o dacie i godzinie wszczepienia czujnika nie są w dalszym ciągu wyświetlane, wykonaj poniższe czynności:

1. Zdejmij inteligentny nadajnik z ramienia. Podłącz kabel ładowania do nadajnika i źródła zasilania. Podłącz wtyczkę do gniazda ściennego, a następnie wyciągnij wtyczkę i odłącz kabel od nadajnika.
2. Umieść inteligentny nadajnik ponownie nad czujnikiem. Przejdź do obszaru **Informacje** > **Mój czujnik** i potwierdź prawidłową datę i godzinę wszczepienia. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

P: Dlaczego widzę powiadomienie „Wykryto nowy czujnik”?

O: Komunikat ten pojawia się, gdy inteligentny nadajnik wykryje nowy czujnik, umożliwiając połączenie go z nadajnikiem. Inteligentny nadajnik można jednocześnie powiązać wyłącznie z jednym czujnikiem. W przypadku wyświetlenia komunikatu **Wykryto nowy czujnik**, gdy czujnik został już wszczepiony i połączony z inteligentnym nadajnikiem, dotknij opcji **Nie teraz**. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi klienta.

P: Dlaczego system CGM wrócił do fazy inicjalizacji?

O: System wraca do fazy inicjalizacji z jednej z poniższych przyczyn:

- Okres kalibracji wygasł przed wprowadzeniem odczytu z glukometru.
- Wystąpiły znaczące różnice między 3 lub więcej odczytami poziomu glukozy z glukometru i bieżącym odczytem czujnika glukozy.
- Bateria inteligentnego nadajnika nie została naładowana w ciągu 16 godzin od otrzymania alertu o rozładowanej baterii.
- W przypadku ręcznej zmiany godziny na urządzeniu przenośnym inteligentny nadajnik zsynchronizuje się i ponownie zainicjuje połączenie z urządzeniem przenośnym.
- Nowy nadajnik został połączony z istniejącym czujnikiem. Na przykład w przypadku wymiany istniejącego nadajnika.
- Gdy pacjent został poinstruowany o konieczności ponownego połączenia czujnika przez dział obsługi klienta.

P: Czy technik MRI może nosić system Eversense E3 CGM?

O: Tak, technicy MRI mogą nosić system Eversense E3 CGM. Jednak w przypadku pacjentów poddających się badaniu MRI ze statycznym polem magnetycznym wynoszącym 1,5 T lub 3,0 T, czujnik może pozostać pod skórą, lecz konieczne jest zdjęcie inteligentnego nadajnika i zostawienie go poza pracownią rezonansu magnetycznego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI*.

Zdarzenia

P: W jaki sposób mogę posortować zdarzenia na ekranie DZIENNIK ZDARZEŃ?

O: Na górze ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ** znajduje się filtr do sortowania. Dotknij wybranej ikony filtra, aby wyświetlić wybrane rodzaje zdarzeń. Domyślnie są wyświetlane wszystkie zdarzenia.

Synchr.

P: Dlaczego czasami w górnej części ekranu widzę niebieski i biały pasek postępu?

O: Pasek postępu synchronizacji może być wyświetlany z wielu przyczyn:

- Inteligentny nadajnik był przez jakiś czas poza zasięgiem czujnika i teraz ponownie synchronizuje dane.
- Zamknięto aplikację Eversense i uruchomiono ją ponownie.
- Bateria urządzenia przenośnego rozładowała się i była ładowana.

Skróty

P: Czy istnieje jakiś sposób na wybranie danych wyświetlanych na ekranie MOJA GLUKOZA zamiast przewijania wstecz?

O: Tak, dotknij paska **„**Dzisiaj**”** znajdującego się tuż nad wykresem. Pojawi się wyskakujące okno wybranie danych wyświetlanych na wykresie.

P: Kiedy przeglądam dane historyczne dla określonej daty/godziny na ekranie MOJA GLUKOZA, czy mogę skorzystać z jakiegoś skrótu, aby przejść do bieżącej daty i godziny?

O: Tak, dotknij wartości poziomu glukozy/strzałki trendu, aby powrócić do bieżącej daty/godziny na ekranie **MOJA GLUKOZA**.

P: Czy istnieje skrót do ekranu HISTORIA ALERTÓW?

O: Jeśli inteligentny nadajnik jest połączony z aplikacją, można dotknąć paska stanu na górze ekranu, aby wyświetlić ekran **HISTORIA ALERTÓW**.

P: Czy istnieje skrót do ekranu POŁĄCZ?

O: Jeśli inteligentny nadajnik nie jest połączony z aplikacją, można dotknąć paska stanu na górze ekranu, aby wyświetlić ekran **POŁĄCZ**.

P: Czy istnieje skrót do wprowadzania zdarzeń, takich jak posiłki lub ćwiczenie?

O: Na ekranie **MOJA GLUKOZA** dotknij wykresu, aby wyświetlić ekran **WPROWADZANIE ZDARZEŃ**.

19. Działanie urządzenia

Niniejsza część zawiera dane na temat działania urządzenia.

Parametry pracy urządzenia w trakcie badania klinicznego

Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność systemu Eversense E3 CGM zostały ocenione w badaniu klinicznym PROMISE w Stanach Zjednoczonych. Dane przedstawione w rozdziale Działanie urządzenia są oparte na danych zebranych w ramach badania PROMISE z wykorzystaniem nowego algorytmu (SW604) i niewielkiej modyfikacji konstrukcji czujnika (czujnik E3). Oceny dokładności dokonywano w różnych punktach w trakcie badań. Uczestników proszono o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych występujących w czasie trwania badań. Rozdział Bezpieczeństwo uwzględnia wszystkich uczestników (n = 181) z badania.

Badanie PROMISE

Badanie PROMISE było wieloośrodkowym, prospektywnym, nierandomizowanym, kluczowym badaniem klinicznym. Stu osiemdziesięciu jeden (181) dorosłych (18 lat i więcej) z cukrzycą typu 1 lub typu 2 wzięło udział w badaniu w 8 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Dziewięćdziesięciu sześciu (96) uczestników miało wszczepione dwa czujniki, po jednym w każdym ramieniu. Czterdzieści trzy (43) dodatkowe czujniki były czujnikami SBA. Uczestnicy mieli interakcję z systemem w zakresie kalibracji i reakcji na powiadomienia niezwiązane z danymi dotyczącymi poziomu glukozy. Wszystkie decyzje dotyczące leczenia cukrzycy były podejmowane na podstawie wartości poziomu glukozy i klinicznego standardu opieki. Dokładność była mierzona podczas całodniowych wizyt w klinice. Wizyty te odbywały się w dniach 1, 7 lub 14, 22, 30, 60, 90, 120, 150 i 180. Podczas każdej wizyty dokładność czujnika była oceniana za pomocą standardowego analizatora laboratoryjnego znanego jako YSI. Odczyty poziomu glukozy zostały porównane w tym samym czasie między analizatorem referencyjnym i urządzeniem do ciągłego monitorowania. Kolejna wizyta kontrolna nastąpiła 10 dni po usunięciu czujnika.

Tabela 1 – Dokładność względem analizatora YSI w ramach badania PROMISE*

Łączna liczba sparowanych wartości CGM i YSI	Wartość procentowa odczytów z systemu CGM w poszczególnych zakresach				MARD
	Wartość procentowa 15/15% odniesienia	Wartość procentowa 20/20% odniesienia	Wartość procentowa 30/30% odniesienia	Wartość procentowa 40/40% odniesienia	
12 034	87,3	93,9	98,6	99,6	8,5%

*Wartości glukozy w zakresie od 40 do 400 mg/dl.

Dokładność czujnika Eversense E3 względem analizatora YSI w ramach badania PROMISE

Dokładność została zmierzona poprzez porównanie wartości poziomu glukozy z czujnika Eversense E3 z wartościami poziomu glukozy we krwi z analizatora YSI. W przypadku wartości poziomu glukozy we krwi mniejszych lub równych 80 mg/dl obliczane było średnie odchylenie bezwzględne między dwoma wynikami. W przypadku wartości większych niż 80 mg/dl obliczane było średnie odchylenie względne.

Tabela 2 – Dokładność względem analizatora YSI w ramach badania PROMISE

Zakresy poziomu glukozy z analizatora YSI (mg/dl)	Liczba sparowanych wartości CGM-YSI	Średnie odchylenie bezwzględne (%)
Ogółem	12 034	8,5
< 40*	0	--
40–60*	592	7,5
61–80*	1 221	7,7
81–180	5 067	8,6
181–300	3 300	7,4
301–350	1 457	6,9
351–400	375	6,4
> 400	25	9,5

* W przypadku wartości ≤ 80 mg/dl z analizatora YSI uwzględniono różnice w jednostkach mg/dl zamiast różnicy procentowej (%).

Wydajność została również zmierzona poprzez obliczenie wartości procentowej odczytów czujnika glukozy w zakresie 15 mg/dl lub 15% wartości referencyjnej YSI. Tabele te przedstawiają zgodność procentową na wielu poziomach, w różnych zakresach poziomu glukozy oraz w różnych dniach noszenia czujnika. Wyniki w zakresach poziomu glukozy 80 mg/dl lub mniejszych odzwierciedlają wartości procentowe w jednostkach mg/dl, a wyniki w zakresach poziomu glukozy powyżej 80 mg/dl odzwierciedlają wartość procentową dotyczącą odniesienia. Na przykład wartości poziomu glukozy od 40 do 60 mg/dl mieściły się w zakresie 15 mg/dl wartości odniesienia przez 91,6% czasu.

Tabela 3 – Wartość procentowa odczytów z czujnika Eversense E3 w zakresie ogólnej zgodności w ramach badania PROMISE

Zakres poziomu glukozy w przypadku czujnika CGM (mg/dl)	Sparowane wartości z czujnika CGM i wartości referencyjne z analizatora YSI	Wartość procentowa odczytów z systemu CGM w poszczególnych zakresach				
		Wartość procentowa 15/15% odniesienia	Wartość procentowa 20/20% odniesienia	Wartość procentowa 30/30% odniesienia	Wartość procentowa 40/40% odniesienia	Wartość procentowa > 40/40% odniesienia
Ogółem	12 034	87,3	93,9	98,6	99,6	0,4
40–60	574	91,6	96,5	98,6	99,3	0,7
61–80	1 178	89,7	93,8	98,9	99,8	0,2
81–180	5 078	85,1	93,2	98,5	99,6	0,4
181–300	3 493	87,0	93,7	98,4	99,6	0,4
301–350	1 191	93,3	96,8	99,2	99,6	0,4
351–400	520	87,3	93,8	98,7	99,6	0,4

Tabela 4 – Dokładność systemu Eversense E3 według dnia

Dzień	Średnie odchylenie bezwzględne (%)	Wartość procentowa odczytów z systemu CGM w poszczególnych zakresach				
		Wartość procentowa 15/15% odniesienia	Wartość procentowa 20/20% odniesienia	Wartość procentowa 30/30% odniesienia	Wartość procentowa 40/40% odniesienia	Wartość procentowa > 40/40% odniesienia
Dzień 1	11,2	78,6	87,4	96,5	99,3	0,7
Dzień 7	10,0	81,9	88,0	94,7	98,5	1,5
Dzień 14	7,4	87,4	95,0	99,0	100,0	0,0
Dzień 22	8,4	88,9	95,7	99,2	99,9	0,1
Dzień 30	8,2	85,8	93,4	98,2	99,3	0,7
Dzień 60	8,6	87,9	94,2	98,6	99,8	0,2
Dzień 90	7,0	93,1	97,1	99,8	99,9	0,1
Dzień 120	8,4	89,2	96,1	99,6	99,9	0,1
Dzień 150	8,8	84,0	91,9	99,5	99,9	0,1
Dzień 180	7,4	93,1	98,0	99,3	99,7	0,3

Skuteczność alertów Eversense E3

Tabele w tym rozdziale przedstawiają ocenę skuteczności alertów. Wskaźnik wykrywania potwierdzonych zdarzeń przedstawia w procentach, ile razy system Eversense E3 CGM potwierdził wartość referencyjną poprzez wygenerowanie alertu w ciągu 15 minut, przez które wartość referencyjna znajdowała się poza ustawionym progiem alertu. Wskaźnik wykrywania pominiętych zdarzeń przedstawia w procentach, ile razy system Eversense E3 CGM nie wygenerował alertu w ciągu 15 minut, przez które wartość referencyjna znajdowała się poza ustawionym progiem alertu. Wskaźnik prawdziwych alertów przedstawia w procentach, ile razy alert z systemu CGM został potwierdzony przez wartość referencyjną w ciągu 15 minut od wygenerowania alertu. Wskaźnik fałszywych alertów przedstawia w procentach, ile razy alert z systemu CGM nie został potwierdzony przez wartość referencyjną w ciągu 15 minut od wygenerowania alertu.

Poniższa tabela przedstawia ocenę zdolności systemu Eversense E3 CGM do wykrywania wysokich i niskich poziomów glukozy oraz do weryfikowania alertów prawdziwie dodatnich i fałszywie dodatnich. Informacje te są przedstawione jako wartości procentowe alertów porównane z wartościami referencyjnymi z analizatora YSI w zakresie różnych progów.

Tabela 5 – Skuteczność alertów wysokiego i niskiego poziomu glukozy z systemu Eversense E3 (tylko próg) w ramach badania PROMISE

Ustawienie alertu (mg/dl)		Wskaźnik wykrywania potwierdzonych zdarzeń	Wskaźnik wykrywania pominiętych zdarzeń	Wskaźnik prawdziwych alertów	Wskaźnik fałszywych alertów
Alert niskiego poziomu	60	76%	24%	82%	18%
	70	89%	11%	90%	10%
	80	93%	7%	92%	8%
	90	96%	4%	93%	7%
Alert wysokiego poziomu	120	99%	1%	97%	3%
	140	99%	1%	96%	4%
	180	98%	2%	95%	5%
	200	97%	3%	95%	5%
	220	97%	3%	95%	5%
	240	97%	3%	94%	6%
	300	88%	12%	90%	10%

Poniższa tabela przedstawia ocenę zdolności systemu Eversense E3 CGM do wykrywania wysokich i niskich poziomów glukozy, generowania alertów przewidywania wysokich i niskich poziomów oraz weryfikowania alertów prawdziwie dodatnich i fałszywie dodatnich. Informacje te są przedstawione jako wartości procentowe alertów porównane z wartościami referencyjnymi z analizatora YSI w zakresie różnych progów.

Tabela 6 – Skuteczność alertów wysokiego i niskiego poziomu glukozy oraz alertów przewidywania z systemu Eversense E3 (próg i przewidywanie) w ramach badania PROMISE

Ustawienie alertu (mg/dl)		Wskaźnik wykrywania potwierdzonych zdarzeń	Wskaźnik wykrywania pominiętych zdarzeń	Wskaźnik prawdziwych alertów	Wskaźnik fałszywych alertów
Alert niskiego poziomu	60	90%	10%	73%	27%
	70	94%	6%	84%	16%
	80	97%	3%	87%	13%
	90	98%	2%	89%	11%
Alert wysokiego poziomu	120	99%	1%	96%	4%
	140	99%	1%	95%	5%
	180	99%	1%	93%	7%
	200	99%	1%	93%	7%
	220	98%	2%	92%	8%
	240	98%	2%	91%	9%
	300	92%	8%	87%	13%

Zgodność trendów w zakresie szybkości zmian czujnika Eversense E3

Wyszarzony obszar w poniższej tabeli przedstawia zgodność między trendami poziomu glukozy z czujnika Eversense E3 i trendami referencyjnymi, gdy poziom glukozy zmienia się w różnym tempie (mg/dl na minutę). Na przykład, gdy poziom glukozy zmienia się w tempie od –1 do 1 mg/dl/minuta, trendy poziomu glukozy z czujnika Eversense E3 są zgodne z trendami referencyjnymi przez 90% czasu.

Tabela 7 – Zgodność trendów w zakresie szybkości zmian z czujnika Eversense E3 w ramach badania PROMISE

Trend CGM (mg/dl/min)	Referencyjna szybkość zmian (mg/dl/min) Wartość procentowa dopasowanych par w każdym zakresie trendów referencyjnych dla każdego zakresu CGM ROC					
	< -2	[-2, -1)	[-1, 1]	(1, 2]	> 2	Łącznie
< -2	24%	35%	41%	0%	0%	163
[-2, -1)	4%	36%	59%	0%	0%	824
[-1, 1]	0%	4%	90%	5%	1%	8 716
(1, 2]	0%	1%	46%	42%	11%	896
> 2	0%	0%	24%	40%	35%	336
						10 935

Zgodność wartości z czujnika Eversense E3 z wartościami z analizatora YSI

Wyszarzony obszar w poniższych tabelach przedstawia, jaki procent wartości referencyjnych z analizatora YSI mieścił w takim samym zakresie, co wartości poziomu glukozy z czujnika. Na przykład, gdy poziom glukozy z czujnika mieścił się w zakresie od 81 do 120 mg/dl, wartości referencyjne z analizatora YSI mieściły się w tym samym zakresie przez 76% czasu.

Tabela 8 – Zgodność z zakresami z analizatora YSI przez wszystkie dni badania PROMISE

CGM (mg/dl)	Liczba sparowanych wartości CGM-YSI	Wartość procentowa dopasowanych par w każdym zakresie poziomu glukozy z analizatora YSI względem każdego zakresu poziomu glukozy z czujnika CGM (mg/dl)										
		< 40	40-60	61-80	81-120	121-160	161-200	201-250	251-300	301-350	351-400	> 400
40–60	574	0%	62%	36%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
61–80	1 178	0%	19%	66%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81–120	2 066	0%	0%	11%	76%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
121–160	2 067	0%	0%	0%	14%	71%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
161–200	1 648	0%	0%	0%	0%	21%	66%	13%	0%	0%	0%	0%
201–250	1 437	0%	0%	0%	0%	1%	15%	68%	15%	1%	0%	0%
251–300	1 353	0%	0%	0%	0%	0%	1%	17%	56%	25%	1%	0%
301–350	1 191	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	17%	70%	12%	0%
351–400	520	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	51%	42%	5%
> 400	155	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	21%	52%	26%

Tabela 9 – Zgodność z zakresem z analizatora YSI w 1. dniu badania PROMISE

CGM (mg/dl)	Liczba sparowanych wartości CGM-YSI	Wartość procentowa dopasowanych par w każdym zakresie poziomu glukozy z analizatora YSI względem każdego zakresu poziomu glukozy z czujnika CGM (mg/dl)										
		< 40	40-60	61-80	81-120	121-160	161-200	201-250	251-300	301-350	351-400	> 400
40–60	120	0%	51%	45%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
61–80	146	0%	10%	54%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81–120	271	0%	0%	5%	70%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
121–160	202	0%	0%	0%	14%	62%	21%	3%	0%	0%	0%	0%
161–200	124	0%	0%	0%	0%	33%	51%	16%	0%	0%	0%	0%
201–250	75	0%	0%	0%	0%	4%	19%	51%	27%	0%	0%	0%
251–300	121	0%	0%	0%	0%	0%	1%	24%	57%	18%	0%	0%
301–350	86	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	33%	64%	0%	0%
351–400	58	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	84%	9%	0%
> 400	25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	48%	48%	0%

Zgodność stabilności kalibracji

Poniższa tabela porównuje procent wartości poziomów glukozy z czujnika z wartością referencyjną z analizatora YSI w różnych punktach czasowych po wpisie kalibracyjnym. Na przykład w poniższej tabeli 89,7% wartości z czujnika Eversense E3 mieściło się w zakresie 15 mg/dl (w przypadku odczytów referencyjnych 80 mg/dl lub mniej) i 15% (w przypadku odczytów referencyjnych powyżej 80 mg/dl) wartości referencyjnej przez 8–10 godzin po wpisie kalibracyjnym.

Tabela 10 – Zgodność stabilności kalibracji czujnika Eversense E3 w ramach badania PROMISE

Czas od kalibracji	Liczba sparowanych wartości CGM-YSI	Wartość procentowa odczytów z systemu CGM w poszczególnych zakresach				
		Wartość procentowa 15/15% odniesienia	Wartość procentowa 20/20% odniesienia	Wartość procentowa 30/30% odniesienia	Wartość procentowa 40/40% odniesienia	Wartość procentowa > 40/40% odniesienia
(0, 2) godziny	2 638	88,8	94,1	98,7	99,9	0,1
[2, 4) godziny	1 905	87,2	94,4	98,5	99,5	0,5
[4, 6) godziny	1 404	85,3	93,3	98,1	99,3	0,7
[6, 8) godziny	1 043	83,0	91,5	97,7	99,6	0,4
[8, 10) godziny	1 041	89,7	93,9	98,8	99,6	0,4
[10, 12) godziny	1 091	87,8	94,1	97,7	99,5	0,5
[12, 14) godziny	590	85,8	93,4	99,0	99,3	0,7
[14, 16) godziny	440	82,7	91,8	100,0	100,0	0,0
[16, 18) godziny	379	87,6	93,9	99,5	100,0	0,0
[18, 20) godziny	370	90,0	97,0	98,4	99,7	0,3

Tabela 10 – Zgodność stabilności kalibracji czujnika Eversense E3 w ramach badania PROMISE (cd.)

Czas od kalibracji	Liczba sparowanych wartości CGM-YSI	Wartość procentowa odczytów z systemu CGM w poszczególnych zakresach				
		Wartość procentowa 15/15% odniesienia	Wartość procentowa 20/20% odniesienia	Wartość procentowa 30/30% odniesienia	Wartość procentowa 40/40% odniesienia	Wartość procentowa > 40/40% odniesienia
[20, 22) godziny	436	88,3	94,5	99,5	99,8	0,2
[22, 24) godziny	522	89,7	96,2	99,4	99,8	0,2
[24, 26) godziny	168	93,5	98,2	99,4	100,0	0,0
[26, 28) godziny	7	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Czas eksploatacji czujnika

Czas eksploatacji czujnika jest mierzony względem wartości procentowej czujników, które są w stanie funkcjonować przez przewidziany okres 180 dni. W ramach badania PROMISE 90% czujników funkcjonowało przez okres 180 dni. Średnia liczba dni wynosiła 175.

Odsetek czujników, które działały 60, 120 i 180 dni

Dni	Czas eksploatacji czujnika
60	98%
120	98%
180	90%

Średnia liczba dni
175

Bezpieczeństwo

Badanie PROMISE trwało przez 180 dni, a liczba powiązanych zdarzeń niepożądanych została zarejestrowana. System Eversense E3 CGM był doskonale tolerowany w trakcie badania. Podczas 31 373 dni noszenia czujników nie wykryto nieprzewidzianych zdarzeń niepożądanych. U 37 uczestników wystąpiło 59 zdarzeń niepożądanych. Żadne ze zdarzeń niepożądanych nie zakończyło się hospitalizacją.

Table 11 – Zdarzenia niepożądane (wszyscy pacjenci, n = 181)

Typ zdarzenia	Liczba zdarzeń	Liczba pacjentów (% pacjentów)
	59	**37 (20,4)**
Podrażnienie skóry, miejsce przyklejenia przylepca lub wszczepieni czujnika (w tym rumień, świąd, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, surowiczak)	16	11 (6,1)
Atrofia skóry	4	4 (2,2)
Odbarwienie	4	3 (1,7)
Zakażenie (związane z zabiegiem)	2	2 (1,1)
Zakażenie (niezwiązane z zabiegiem)	1	1 (0,6)
Siniak	19	11 (6,1)
Krwawienie	3	3 (1,7)
Ból	7	6 (3,3)
Drętwienie ramienia	1	1 (0,6)
Drżenie	1	1 (0,6)
Samoprzylepne paski do zamykania brzegów nie uzyskały odpowiedniej stabilności	1	1 (0,6)

20. Dane techniczne

Czujnik

Charakterystyka	Opis
Wymiary	Długość: 18,3 mm Średnica: 3,5 mm
Materiały	Homopolimerowy polimetakrylan metylu (PMMA) – 86 mg, hydrożel na bazie metakrylanu hydroksyetylu (HEMA) zawierający wskaźnik glukozy – 2,0 mg, platyna – 0,012 mg, silikon – 4,1 mg, octan deksametazonu – 1,7 mg, epoksyd 301-2 – 0,62 mg
Zakres poziomu glukozy	40–400 mg/dl
Czas eksploatacji czujnika	Maksymalnie 180 dni
Kalibracja	Dostępny w handlu glukometr osobisty
Zakres kalibracji	40–400 mg/dl
Sterylizacja	Sterylizacja tlenkiem etylenu

Inteligentny nadajnik

Charakterystyka	Opis
Wymiary	Długość: 48,0 mm Szerokość: 37,6 mm Grubość: 8,8 mm
Materiały	Korpus: poliwęglan
Ciężar	11,3 g
Zasilacz	Bateria litowo-jonowa (niewymienna)
Warunki eksploatacyjne	5–40°C (41–104°F)
Okres eksploatacji	12 miesięcy
Warunki przechowywania.	0–35°C (32-95°F)
Ochrona przed wilgocią	IP67: wodoszczelny, można zanurzyć na głębokość 1 metra na 30 minut
Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym	Część klasy BF wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta
Ładować przy użyciu adaptera prądu zmiennego	15 minut do pełnego naładowania
Zasięg	Odległość między aplikacją a inteligentnym nadajnikiem może wynosić maksymalnie 24,9 stopy Łączność bezprzewodowa z aplikacją nie działa dobrze przy zanurzeniu w wodzie. Zasięg ulegnie zmniejszeniu, jeżeli użytkownik jest w wannie, łóżku wodnym, basenie itd.
Ciśnienie w kabinie	Od 700 hPa do 1060 hPa

Inteligentny nadajnik (cd.)

Charakterystyka	Opis
Zakres wilgotności względnej (bez kondensacji)	15–90%
Wysokość nad poziomem morza	10 000 ft

Zasilacz i ładowarka

Charakterystyka	Opis
Klasa	II
Wejście	Napięcie wejściowe – prąd przemienny, 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3–0,15 A
Napięcie wyjściowe stałoprądowe	5 V DC, 1 A (5,0 W)
Ochrona przed wilgocią (stacja dokująca)	IP22

Przewód USB* do ładowania i pobierania

Charakterystyka	Opis
We/wy	5 V DC, 1 A
Typ	Od USB-A do USB micro-B
Długość	91 cm (36 cali)

*Niewłaściwe posługiwanie się przewodem USB może grozić uduszeniem. Przewód USB można podłączać do zasilacza/ładowarki i ładować z gniazda sieciowego. W celu odcięcia systemu należy odłączyć ładowarkę/zasilacz od gniazda ściennego. Ładując inteligentny nadajnik przez port USB w komputerze, należy się upewnić, że komputer spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa IEC 60950-1 (lub jego odpowiednika).

Zalecenia i deklaracje producenta – odporność elektromagnetyczna

Nadajnik został zaprojektowany do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym w następnej tabeli. Użytkownik powinien zapewnić zgodne środowisko pracy dla nadajnika.

Specyfikacja odporności elektromagnetycznej nadajnika

Test odporności	Test odporności	Poziom zgodności nadajnika	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Wyładowania elektryczne (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV, kontaktowo ±15 kV, powierzchnie	±8 kV, kontaktowo ±15 kV, powierzchnie	Posadzki powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. W przypadku pokrycia posadzek materiałem syntetycznym wilgotność powinna wynosić co najmniej 30%.
Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej (110 V AC / 60 Hz, 230 V AC / 50 Hz) wg normy IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej powinny mieć poziomy charakterystyczne dla typowej lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Normy bezpieczeństwa i elektryczne (cd.)

System Eversense E3 CGM jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym w poniższej tabeli. Użytkownicy systemu powinni zapewnić jego użytkowanie zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja odporności elektromagnetycznej systemu

Test odporności	Poziom testowy wg normy IEC 60601	Poziom zgodności nadajnika	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Odporność na zakłócenia przewodzone o częstotliwości radiowej wg normy IEC 61000-4-6 (tylko smartfon [urządzenie odbiorcze])	≥ 3 Vrms (od 150 kHz do 80 MHz)	3 Vrms	Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem:
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg normy IEC 61000-4-3	≥ 10 V/m w zakresie od 80 MHz do 2700 MHz (modulacja amplitudowa, AM)	3 Vrms	

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

Uwaga 2: Zalecenia te mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Wpływ na propagację elektromagnetyczną ma wchłanianie przez i odbijanie się od konstrukcji, obiektów i ludzi.

a. Natężeń pól generowanych przez różne nadajniki, takie jak stacje bazowe telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej) oraz radiotelefony, radia amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne oraz transmisje telewizyjne, nie można precyzyjnie przewidzieć w sposób teoretyczny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne z uwzględnieniem stałych nadajników radiowych, należałoby rozważyć pomiary pól elektromagnetycznych w lokalizacji. Jeżeli zmierzone natężenia pól w miejscu użytkowania systemu Eversense E3 CGM przekracza wyżej wymieniony poziom zgodności radiowej, należy obserwować system Eversense E3 CGM w celu zweryfikowania jego normalnej pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy systemu może wystąpić konieczność zastosowania środków dodatkowych, takich jak zmiana orientacji lub przeniesienie systemu Eversense E3 CGM.

b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być mniejsze niż 10 V/m.

Zalecenia i deklaracje producenta – emisje elektromagnetyczne

System przenośny Eversense E3 CGM jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym w następnej tabeli. Klient powinien zapewnić zgodne środowisko pracy systemu.

Test emisji	Zgodność	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Emisje radiowe wg CISPR 11	Grupa 1	System Eversense E3 CGM wykorzystuje energię na częstotliwościach radiowych tylko do realizowania funkcji wewnętrznych. W związku z powyższym jego emisje radiowe są bardzo niskie i nie powodują raczej żadnych zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych.
Emisje radiowe wg CISPR 11	Klasa B	System Eversense E3 CGM można użytkować we wszystkich pomieszczeniach, także mieszkalnych, podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej zasilającej w energię wykorzystywaną w gospodarstwach domowych.

Zalecane odległości oddzielające smartfon (urządzenie odbiorcze) od innych urządzeń przenośnych/mobilnych do komunikacji radiowej.

Zastosuj odległości jak w instrukcji producenta smartfona (lub innego urządzenia odbiorczego). Klient lub użytkownik smartfona (lub innego urządzenia odbiorczego) może zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym przez zachowanie minimalnej odległości co najmniej 30 cm (ok. 12 cali) między smartfonem (lub innym urządzeniem odbiorczym) i innym urządzeniem przenośnym/mobilnym do komunikacji radiowej (nadajnik). Przenośne/mobilne urządzenia do komunikacji radiowej obejmują: elektroniczne nianie, słuchawki Bluetooth, routery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, laptopy z kartami WiFi, telefony komórkowe, skanery RFID, ręczne wykrywacze metalu wykorzystywane podczas kontroli bezpieczeństwa.

Symbole w aplikacji mobilnej Eversense CGM

Symbol	Objaśnienie
	**Alert poziomu glukozy** Pojawia się wtedy, gdy poziom glukozy wykracza poza górną lub dolną wartość progową alertu poziomu glukozy. Ikona wyświetla się na ekranie **HISTORIA ALERTÓW**.
	**Alert Przewidywany niski poziom glukozy lub Spadająca szybkość zmiany poziomu glukozy** Oznacza wystąpienie alertu Spadająca szybkość zmiany poziomu glukozy lub Przewidywany niski poziom glukozy. Ikona wyświetla się na ekranie **HISTORIA ALERTÓW** oraz na linii trendu na ekranie głównym.
	**Alert Przewidywany wysoki poziom glukozy lub Rosnąca szybkość zmiany poziomu glukozy** Oznacza wystąpienie alertu Rosnąca szybkość zmiany poziomu glukozy lub Przewidywany wysoki poziom glukozy. Ikona wyświetla się na ekranie **HISTORIA ALERTÓW** oraz na linii trendu na ekranie głównym.
	**Alert rozładowanej baterii** Pojawia się, gdy bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
	**Alert niskiego poziomu baterii** Pojawia się, gdy w baterii nadajnika pozostało mniej niż 10% energii.
	**Alert inteligentnego nadajnika / czujnika** Ikona wyświetla się na ekranie **HISTORIA ALERTÓW**.
	**Powiadomienia inteligentnego nadajnika / czujnika** Pojawiają się, gdy istnieją powiadomienia dotyczące inteligentnego nadajnika lub czujnika.
	**Alert kalibracji** Pojawia się gdy istnieją alerty związane z kalibracją.

Symbole w aplikacji mobilnej Eversense CGM (cd.)

Symbol	Objaśnienie
	**Powiadomienie o kalibracji** Wyświetla się na ekranie **HISTORIA ALERTÓW** w przypadku braku powiadomień powiązanych z kalibracją. Ikona wyświetla się również na linii trendu Moja glukoza i na ekranie Dziennik zdarzeń po zarejestrowaniu ręcznego wpisu BG.
	**Kalibracja zaakceptowana** Wyświetla się na linii trendu glukozy i na ekranie **DZIENNIK ZDARZEŃ** po wprowadzeniu i zaakceptowaniu wartości kalibracji.
	**Trwa kalibracja** Wyświetla się na linii trendu glukozy i na ekranie Dziennik zdarzeń przez mniej więcej 15 minut, gdy kalibracja jest w toku. Ikona zmieni kolor na czerwony, czarny lub niebieski, gdy kalibracja nie będzie już w toku.
	**Kalibracja niekompletna** Wyświetla się na linii trendu glukozy i na ekranie Dziennik zdarzeń, gdy odpowiednia ilość danych nie zostanie zgromadzona w celu zakończenia kalibracji. Na przykład, gdy nadajnik zostanie zdjęty z miejsca wszczepienia czujnika podczas kalibracji trwającej ok. 15 minut.
	**Nie można zastosować wartości kalibracji** Wyświetla się na linii trendu glukozy i na ekranie Dziennik zdarzeń po wprowadzeniu wartości kalibracji, której nie można użyć. Na przykład wprowadzona wartość wynosi mniej niż 40 mg/dl lub więcej niż 400 mg/dl. W takiej sytuacji wartość kalibracji jest zapisywana jako ręczny wpis BG.
	**Pomyślnie nawiązano połączenie z systemem** Wyświetla się, gdy inteligentny nadajnik jest połączony ze smartfonem oraz gdy czujnik jest połączony z inteligentnym nadajnikiem. Paski wskazują siłę sygnału połączenia.

Symbole w aplikacji mobilnej Eversense CGM (cd.)

Symbol	Objaśnienie
	**Połączenie nadajnika i czujnika** Wyświetla się, gdy nadajnik jest połączony z czujnikiem oraz gdy połączenie między nadajnikiem i czujnikiem zostanie przerwane.
	**Połączenie nadajnika i aplikacji mobilnej** Wyświetla się, gdy połączenie BLE między nadajnikiem i aplikacją mobilną zostanie przerwane.
	**Alerty łączone (więcej niż jeden alert lub więcej niż jedno zdarzenie)** Pojawia się w przypadku odebrania dwóch lub więcej alertów w krótkim odstępie czasu.
	**Ikona zdarzeń** Wyświetla się na linii trendu glukozy i na ekranie **DZIENNIK ZDARZEŃ** po wprowadzeniu informacji o zdarzeniu. Informacje o zdarzeniach, które można wprowadzić:  Glukoza  Insulina  Ćwiczenie  Posiłek  Zdrowie
	**Profil tymczasowy** Pojawia się wtedy, gdy profil tymczasowy zostanie aktywowany.
	**Nie przeszkadzać (NP)** Wyświetla się, gdy ustawienie NP zostanie aktywowane.

Symbole na opakowaniu i urządzeniu

Symbol	Objaśnienie
	Zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Wskazanie elektronicznej instrukcji używania
	Przestroga: zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Termin ważności
	Producent
	Data produkcji
	Zakres temperatury przechowywania
	Numer partii
	Uniwersalna magistrala szeregowa (USB)

Symbol	Objaśnienie
	Numer katalogowy
	Numer seryjny
	Część klasy BF wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta
	Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne
	Wyprodukowano bez użycia lateksu naturalnego
FCC ID	Identyfikator FCC jest przypisany do wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot certyfikacji.
	Niejałowy

Symbole na opakowaniu i urządzeniach (cd.)

Symbol	Objaśnienie
	Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest przeciwwskazane w przypadku inteligentnego nadajnika.
	Przyrząd warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego. Przyrząd z potwierdzonym poziomem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego w określonych warunkach, w tym w warunkach dotyczących statycznego pola magnetycznego, gradientów pól magnetycznych zróżnicowanych czasowo oraz pól częstotliwości radiowej. Pełne informacje można znaleźć w części *Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI*.

Symbol	Objaśnienie
	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE
	Wyłącznie do użytku jednorazowego.
	Nie sterylizować powtórnie
	Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
	Sterylizowano tlenkiem etylenu
	Pojedyncza bariera sterylna: sterylizowano tlenkiem etylenu
	Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż systemu Eversense E3 CGM do sprzedaży przez lub na zlecenie lekarza

Symbole na opakowaniu i urządzeniach (cd.)

Symbol	Objaśnienie
	Zastosuj się odo instrukcji użytkowania
	Oznaczenie potwierdza, że urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Rady Europy 2017/745
	w sprawie wyrobów medycznych (uwaga: na karcie implantu wskazuje to nazwę wyrobu)
	Unikalny identyfikator wyrobu
	Data wprowadzenia
	Ośrodek lub lekarz wszczepiający
	Identyfikator pacjenta (nazwisko)
	Witryna informacyjna dla pacjentów

Symbol	Objaśnienie
	Importer
	Upoważniony przedstawiciel na obszarze Wspólnoty Europejskiej
	Do wielokrotnego użytku u jednego pacjenta
	Zawiera substancję medyczną
	Informacje dotyczące recyklingu
	Dystrybutor

Ograniczona gwarancja inteligentnego nadajnika Eversense E3

1. Zakres i czas obowiązywania ograniczonej gwarancji

Firma Senseonics, Incorporated („Senseonics") gwarantuje użytkownikowi końcowemu („użytkownik") inteligentnego nadajnika Eversense E3 („inteligentny nadajnik"), że ów inteligentny nadajnik jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez okres jednego roku (365 dni), począwszy od dnia pierwszego odebrania inteligentnego nadajnika od pracownika służby zdrowia („okres gwarancji ograniczonej"). Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi szczególne prawa, przy czym mogą mu też przysługiwać dodatkowe prawa, w zależności od jurysdykcji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest uwarunkowana obowiązkiem przekazywania firmie Senseonics pisemnych powiadomień o wszelkich wadach materiałowych i/lub wykonania niezwłocznie po ich wykryciu oraz stwierdzeniu przez firmę Senseonics, że roszczenie jest skutkiem wystąpienia wady materiałowej i/lub wykonania. Jeżeli firma Senseonics dostarczy zastępczy inteligentny nadajnik zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji ograniczonej, pozostały okres gwarancji dotyczący oryginalnego inteligentnego nadajnika zostanie przeniesiony na zastępczy inteligentny nadajnik, przy czym taki okres gwarancyjny zakończy się w dniu pierwszej rocznicy pierwszego odebrania inteligentnego nadajnika od pracownika służby zdrowia, a gwarancja obejmująca nadajnik oryginalny zostanie anulowana.

2. Wyłączenia ograniczonej gwarancji.

Ograniczona gwarancja obejmuje tylko inteligentny nadajnik wyprodukowany przez firmę Senseonics i jest uwarunkowana właściwym użytkowaniem produktu. Ograniczona gwarancja nie obejmuje a) uszkodzeń kosmetycznych, zarysowań lub innych uszkodzeń powierzchni i części odsłoniętych, powstałych w toku normalnego użytkowania; b) uszkodzeń będących skutkiem wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, wystąpienia nietypowych naprężeń fizycznych, elektrycznych lub elektromechanicznych, lub modyfikacji dowolnej części produktu; c) urządzeń, których numer identyfikacyjny został usunięty, zmieniony lub w inny sposób uczyniony nieczytelnym; d) przypadków nieprawidłowego działania będącego skutkiem użytkowania [inteligentnego nadajnika] z produktami, akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi nieprzeznaczonymi lub niezatwierdzonymi do tego celu; e) materiałów eksploatacyjnych (baterii); f) urządzeń rozmontowanych; g) uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, testowania, konserwacji, instalacji lub regulacji.

Inteligentny nadajnik jest wodoszczelny, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w instrukcji użytkownika. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń na skutek działania wody w przypadku, gdy obudowa nadajnika jest spękana lub uszkodzona w inny sposób. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do usług, urządzeń i oprogramowania towarzyszącego, użytkowanego w połączeniu z nadajnikiem inteligentnym.

3. Zobowiązania firmy Senseonics wynikające z ograniczonej gwarancji.

Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym i wyłącznym zobowiązaniem firmy Senseonics wynikającym z niniejszej ograniczonej gwarancji jest bezpłatna naprawa lub wymiana, wg uznania firmy Senseonics, pod warunkiem że wada powstała oraz odnośne ważne roszczenie zostało zgłoszone firmie Senseonics w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Wadliwy inteligentny nadajnik należy zwrócić do autoryzowanego działu obsługi klienta firmy Senseonics w odpowiednim opakowaniu wysyłkowym, chroniącym inteligentny nadajnik przed dalszym uszkodzeniem, opatrzonym imieniem nazwiskiem i adresem użytkownika, imieniem nazwiskiem i adresem pracownika służby zdrowia, od którego użytkownik otrzymał nadajnik, datą i numerem identyfikacyjnym inteligentnego nadajnika. Adres do wysyłki inteligentnego nadajnika można znaleźć na stronie **https://global.eversensediabetes.com**. Po odebraniu nadajnika firma Senseonics podejmie decyzję, czy inteligentny nadajnik jest objęty ograniczoną gwarancją, a jeżeli ochrona gwarancyjna nie została anulowana, niezwłocznie wymieni inteligentny nadajnik. W przypadku, gdy firma Senseonics stwierdzi, że inteligentny nadajnik nie podlega ochronie z tytułu ograniczonej gwarancji, użytkownik może wykupić nadajnik zastępczy. Jeżeli użytkownik zażąda zwrotu oryginalnego nadajnika, będzie musiał pokryć koszty jego wysyłki.

Taki naprawiony lub wymieniony inteligentny nadajnik będzie objęty gwarancją równą pozostałej części okresu gwarancyjnego oryginalnego inteligentnego nadajnika lub obowiązującą przez [30] dni od daty wymiany lub naprawy, zależnie od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

4. Ograniczenia zobowiązań firmy Senseonics wynikających z ograniczonej gwarancji.

OPISANA WYŻEJ OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY SENSEONICS JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, USTAWOWE BĄDŹ INNE. FIRMA SENSEONICS JEDNOZNACZNIE WYKLUCZA I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH TAKICH GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z M.IN. SUGEROWANYMI GWARANCJAMI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIEZAKŁÓCANIA, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ANI GWARANCJAMI WYNIKAJĄCYMI Z PROCEDOWANIA, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA SENSEONICS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA PRZED PRAWEM ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, NIEISTOTNE, POWIĄZANE LUB POŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, WYNIKŁE ZE SPRZEDAŻY, UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA INTELIGENTNEGO NADAJNIKA BĄDŹ SYSTEMU EVERSENSE E3 FIRMY SENSEONICS. OGRANICZENIE TE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA SENSEONICS LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ POINFORMOWANY O TAKICH SZKODACH, NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA ZASADNICZEGO CELU TEGO OGRANICZONEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA. NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE ROZCIĄGA SIĘ NA OSOBY INNE NIŻ ORYGINALNY UŻYTKOWNIK KOŃCOWY TEGO PRODUKTU I OKREŚLA WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE. W PRZYPADKU, GDY DOWOLNY FRAGMENT NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ OKAŻE SIĘ NIEEGZEKWOWALNY NA MOCY PRAWA W ZAKRESIE, W JAKIM FIRMA SENSEONICS NIE MOŻE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA JEDNOZNACZNIE ZRZEC SIĘ SUGEROWANEJ GWARANCJI ANI OGRANICZYĆ SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SENSEONICS BĘDĄ MINIMALNE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

21. Eversense DMS

Wprowadzenie

Przeznaczenie

System zarządzania bazą danych (DMS) Eversense jest przeznaczony do stosowania jako akcesorium wraz ze zgodnymi urządzeniami Eversense CGM. Jest to aplikacja internetowa, której można używać do wyświetlania, analizowania i przechowywania informacji dotyczących pomiarów glukozy, uzyskanych z systemu Eversense CGM.

Wykaz zgodnych urządzeń i systemów operacyjnych zamieszczono na stronie **https://global.eversensediabetes.com/compatibility**.

WAŻNE: SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH EVERSENSE NIE DOSTARCZA PORAD MEDYCZNYCH. NIE WOLNO PODEJMOWAĆ DECYZJI DOTYCZĄCYCH LECZENIA BEZ KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI SŁUŻBY ZDROWIA.

Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności

Użytkowanie systemu Eversense DMS podlega warunkom najnowszej licencji dla użytkownika końcowego i polityki prywatności firmy Eversense. Dokumenty te są okresowo zmieniane i publikowane na stronie **global.eversensediabetes.com.**

Pomoc techniczna

W razie niezrozumienia jakiejkolwiek części w tej sekcji *Eversense DMS* prosimy o kontakt z darmową obsługą klienta pod numerem 844-SENSE4U (844 736 7348) na terenie Stanów Zjednoczonych. Poza USA należy zadzwonić do lokalnego dystrybutora lub odwiedzić stronę global.eversensediabetes.com, aby odszukać lokalnego dystrybutora. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji użytkowania Eversense DMS, odwiedź stronę: **https://global.eversensediabetes.com/patient-education/eversense-user-guides**.


Rozpoczynanie pracy

Eversense DMS to aplikacja oparta na przeglądarce internetowej (aplikacja internetowa), umożliwiająca użytkownikowi automatyczne wczytywanie danych z aplikacji mobilnej Eversense ze zgodnego inteligentnego urządzenia do Internetu w celu umożliwienia ich przechowywania i przeglądania na bieżąco.

Oprogramowanie komputerowe umożliwia bezpośrednie połączenie komputera z aplikacją internetową. Dane można także wczytać bezpośrednio z inteligentnego nadajnika na konto w systemie Eversense DMS przez połączenie kablowe oraz pobranie i zainstalowanie oprogramowania komputerowego Eversense Client bezpośrednio na komputer.


Utwórz nowe konto

Przed rozpoczęciem używania systemu Eversense DMS konieczne będzie zarejestrowanie się jako użytkownik.

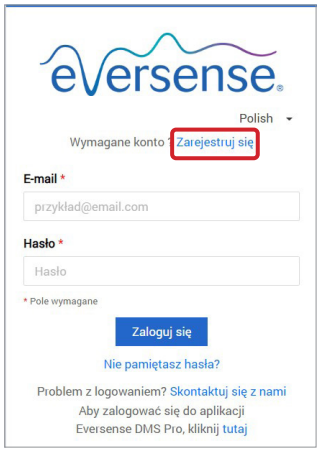

Jeśli użytkownik utworzył już konto w aplikacji mobilnej Eversense, nie ma konieczności rejestrowania nowego konta.

1. **Przejdź do strony global.eversensedms.com**
2. **Kliknij „Zarejestruj się”**
3. **Wprowadź wymagane informacje**
4. **Kliknij „Zatwierdź”**

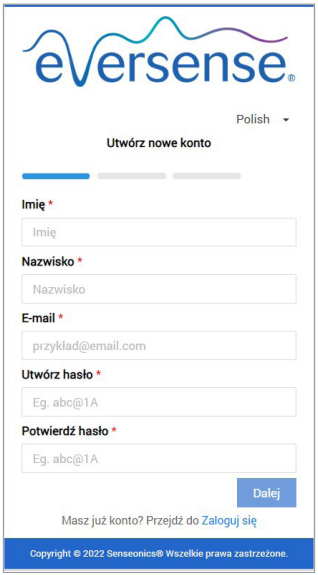


Uwaga: po pierwszym logowaniu użytkownik otrzyma monit o wybranie tajnego pytania w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa. Zarejestrowany adres e-mail i hasło można teraz wykorzystać jako login do konta systemu Eversense DMS, a także do wszystkich innych produktów firmy Eversense.

Logowanie

Przed każdym uzyskaniem dostępu do systemu Eversense DMS konieczne będzie zalogowanie się.

1. **Przejdź do strony global.eversensedms.com**
2. **Na stronie logowania wprowadź swój adres e-mail oraz hasło**
3. **Kliknij „Zaloguj się”**

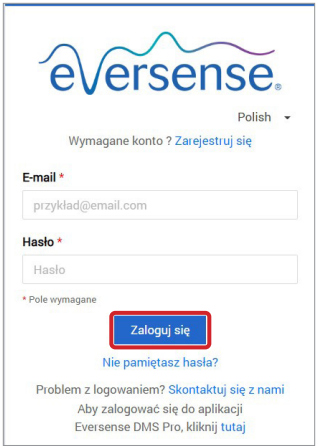


WAŻNE: jeśli próba logowania nie powiedzie się trzy razy, konto Eversense DMS zostanie zablokowane na 30 minut.

Uwaga: w przypadku braku aktywności na stronie DMS przez ponad godzinę pojawi się monit z prośbą o wybranie opcji „**Kontynuuj**”, aby uniknąć wylogowania ze strony.

Zapomniane hasło

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła, można z łatwością utworzyć nowe hasło.

1. **Kliknij „Nie pamiętasz hasła” na stronie logowania**
2. **Wprowadź adres e-mail, gdy pojawi się monit**
3. **Kliknij „Wyślij wiadomość”**

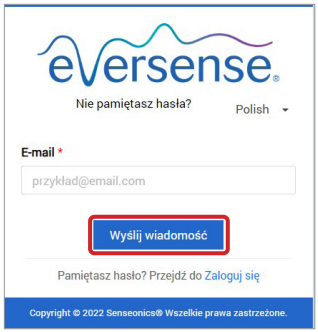




Zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości mailowej z instrukcjami zresetowania hasła.

4. **Otwórz wiadomość e-mail i kliknij link prowadzący do strony internetowej**

   Nastąpi przekierowanie do strony internetowej w celu utworzenia i potwierdzenia nowego hasła.

5. **Kliknij „Zresetuj hasło”**

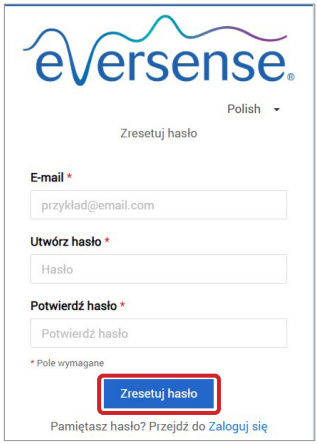




*Pojawi się komunikat potwierdzający, że hasło zostało zresetowane. Wybierz link „**kliknij tutaj**”, aby wrócić do strony logowania.*

Profil i menu nawigacyjne

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlona strona panelu nawigacyjnego z AGP.


- Na górze po prawej stronie można uzyskać dostęp do danych **Profil**.
- Na górze po lewej stronie znajduje się **menu nawigacyjne**.

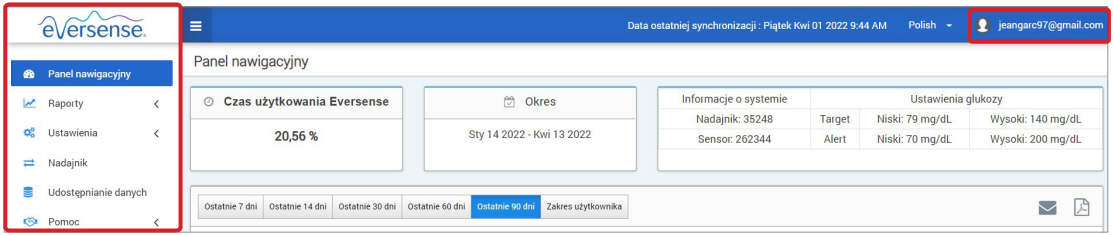

Profil

Ta funkcja, znajdująca się w prawym górnym rogu panelu nawigacyjnego, umożliwia zmianę nazwy lub hasła, edytowanie profilu użytkownika lub wylogowanie z oprogramowania systemu Eversense DMS.

Aby zmienić hasło do logowania, można w łatwy sposób ustawić nowe hasło.




1. **Kliknij nazwę użytkownika**

   Pojawi się rozwijane okno ze zdjęciem profilowym użytkownika, informacją na temat ostatniego logowania oraz opcjami wyświetlania/edytowania profilu lub wylogowania.

2. **Kliknij „Profil", aby uzyskać dostęp do ustawień profilu użytkownika**


3. **Kliknij „Zmień hasło", aby wyświetlić i zmienić bieżące hasło**

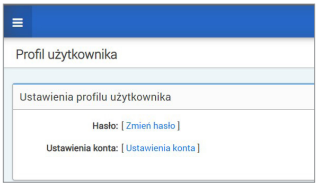

4. **Wpisz bieżące hasło**

5. **Wpisz i potwierdź nowe hasło**

6. **Kliknij „Zmień hasło", aby zapisać zmiany**

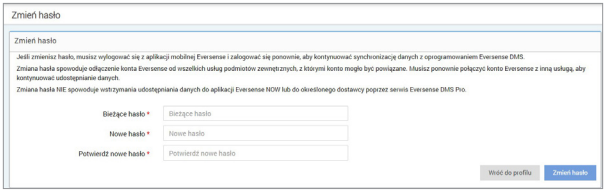


Aby dostosować informacje o koncie osobistym:

1. Kliknij „Ustawienia konta”

2. Wprowadź informacje, które mają być zmienione

Aby zmienić zdjęcie profilowe, naciśnij przycisk **Wybierz plik** i wybierz zdjęcie z plików na komputerze. Zdjęcie profilowe zostanie zmienione dla wszystkich kompatybilnych produktów Eversense.

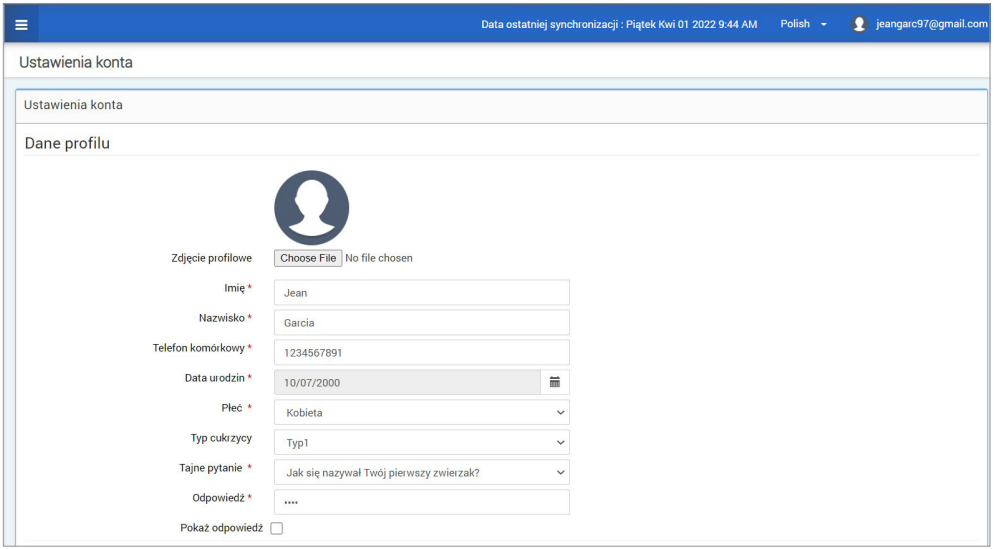

3. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany


Ponownie pojawi się strona Ustawienia profilu użytkownika. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij pozycję „**Panel nawigacyjny**” w lewym górnym rogu panelu nawigacyjnego.


Menu nawigacyjne

W lewym górnym rogu panelu nawigacyjnego AGP znajduje się menu nawigacyjne. Menu nawigacyjne można otwierać i zamykać poprzez kliknięcie ≡. W celu przejścia do tej opcji wyboru należy kliknąć dowolny przycisk menu.

Uwaga: klikając język, można także wybrać preferowany język.

Można kliknąć ikonę ⌄ w celu rozwinięcia menu nawigacyjnego.

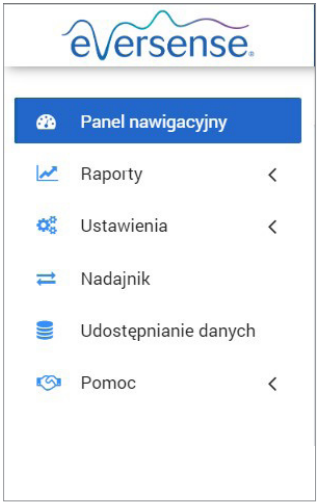

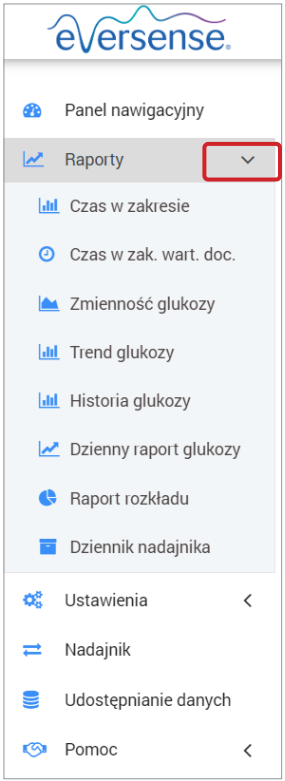


Opcje wyboru menu	Funkcje
Panel nawigacyjny	Powrót do strony panelu nawigacyjnego
Raporty	Wyświetlanie, drukowanie i udostępnianie raportów • Czas w zakresie wartości docelowej • Czas w zakresie • Zmienność glukozy • Trend glukozy • Historia glukozy • Dzienny raport glukozy • Raport rozkładu • Dziennik nadajnika
Ustawienia	Ustawienia aplikacji Eversense DMS • Glukoza • Podsumowanie raportu
Nadajnik	Pobierz aplikację Client
Udostępnianie danych	Łączenie konta DMS z DMS Pro
Pomoc	• Informacje • Kontakt • Dezaktywuj konto • Informacje o wersji

Ustawianie zakresu dat

W górnej części strony panelu nawigacyjnego można znaleźć opcje wstępnie definiowanego zakresu dat, a także opcję ustawienia własnego zakresu dat użytkownika. Umożliwi to określenie, które dane zostaną wykorzystane do analiz i w jaki sposób będą wyświetlane na stronie panelu nawigacyjnego AGP oraz we wszystkich raportach.

Aby dostosować ustawienia zakresu dat:


1. **Aby wyświetlić zestaw danych, który nie znajduje się w jednym z wstępnie zdefiniowanych zakresów dat, kliknij przycisk oznaczony jako „Zakres użytkownika”, aby wyświetlić rozwijany kalendarz**




Spowoduje to wyświetlenie wyskakującego okna umożliwiającego wybór niestandardowego zakresu dat.

Uwaga: dane dostępne w systemie DMS dotyczą okresu do jednego roku wstecz.

2. **Wybierz żądaną *Data początkowa* dla raportu**
3. **Wybierz żądaną *Data końcowa* dla raportu**
4. **Kliknij „OK”, gdy skończysz**

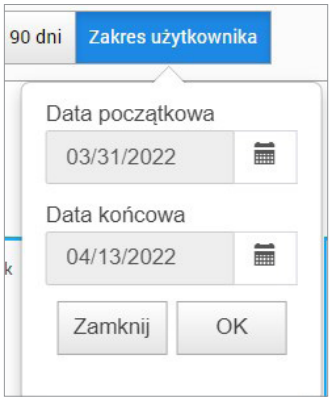

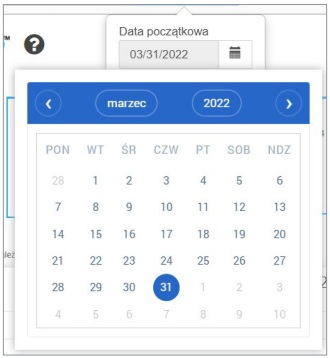

Panel nawigacyjny Eversense DMS z AGP

Panel nawigacyjny DMS to domyślna strona, która wczyta się po każdym zalogowaniu do systemu DMS. Ta strona zawiera informacje dotyczące czasu użytkowania Eversense, raporty Captur AGP oraz informacje o systemie.

Czas użytkowania Eversense

Czas użytkowania Eversense to odsetek czasu, przez jaki noszony był inteligentny nadajnik w wybranym zakresie dat. 100% oznacza, że codzienny czas noszenia inteligentnego nadajnika wynosi 23,5 godziny. Odsetek nie obejmuje czasu, gdy poziom glukozy nie jest wyświetlany. Na przykład: początek fazy inicjalizacji lub gdy aktywny jest alert uniemożliwiający wyświetlanie poziomu glukozy.



Informacje o systemie W górnej części strony panelu nawigacyjnego AGP znajduje się obszar Informacje o systemie.

Zawiera on następujące informacje:

- Numer seryjny nadajnika
- Numer seryjny czujnika
- Ustawienia glukozy: Ustawienia glukozy można zmieniać w systemie DMS, a także poprzez aplikację mobilną Eversense (więcej informacji można znaleźć w części *Ustawienia*).

Informacje o systemie	Ustawienia glukozy		
Nadajnik: 35248	Target	Niski: 79 mg/dL	Wysoki: 140 mg/dL
Sensor: 262344	Alert	Niski: 70 mg/dL	Wysoki: 200 mg/dL


Captur AGP w Eversense DMS

Głównym raportem na panelu nawigacyjnym Eversense DMS jest raport Captur AGP (ambulatoryjnego profilu glukozy). Raport AGP wyświetla dane dotyczące glukozy w 3 częściach raportu.



Raport statystyk poziomu glukozy: Dane dotyczące poziomu glukozy

- Śr. glukoza (średnia): wszystkie wartości glukozy dodane razem, podzielone przez liczbę odczytów
- Szacunkowa wart. HbA1c: obliczona na podstawie wartości glukozy AGP; może różnić się od laboratoryjnego A1c ze względu na różne okresy
- Zakres poziomu glukozy: idealnie wartości glukozy mieszczą się w docelowym zakresie
  - Niski / bardzo niski: cel – brak bardzo niskich lub niskich wartości; mniejsza liczba niskich wartości poprawi samopoczucie
  - Wysoki / bardzo wys.: cel – brak bardzo wysokich lub wysokich wartości; mniejsza liczba wysokich wartości spowoduje z czasem obniżenie A1c
- SD (odchylenie standardowe): stopień zmienności w zestawie danych; w optymalnej sytuacji wartość tego parametru jest niska
- CV (współczynnik zmienności): stopień, w jakim wartości odbiegają od średniej; w optymalnej sytuacji wartość tego parametru jest niska

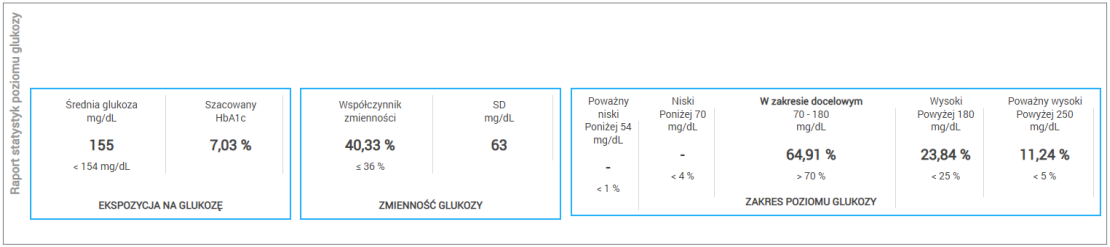


Profil glukozy: **codzienne profile glukozy łączone są w celu uzyskania obrazu jednodniowego (24-godzinnego). Najlepiej gdy linie mieszczą się w obrębie wyszarzonego obszaru (zakres docelowy). Linie mogą nie przecinać całego obszaru, ponieważ nie o każdej godzinie w ciągu dnia wykonywane jest badanie.**


Pomarańczowy: Mediana (linia środkowa), gdzie połowa wartości glukozy jest powyżej, a połowa poniżej; w optymalnej sytuacji pomarańczowa linia jest w większości płaska i mieści się w obrębie wyszarzonego obszaru

Niebieski: pole między niebieskimi liniami pokazuje 50% wartości poziomu glukozy; w optymalnej sytuacji ta przestrzeń jest wąska

Zielony: 10% wartości jest powyżej (linia górna 90%), a 10% poniżej (linia dolna 10%); im bliżej zielone linie znajdują się wyszarzonego obszaru, tym lepiej

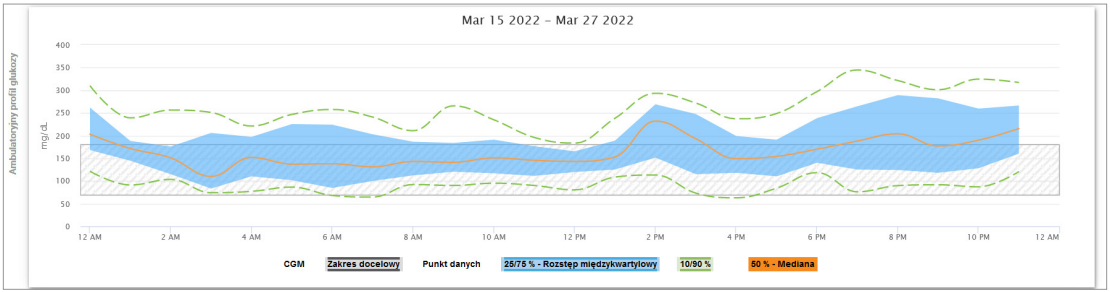

Dzienne profile glukozy: każda ramka to jednodniowy rozkład poziomu glukozy. Będą wyświetlane tylko w przypadku, gdy zakres dat jest ustawiony na 14 dni lub krótszy okres.

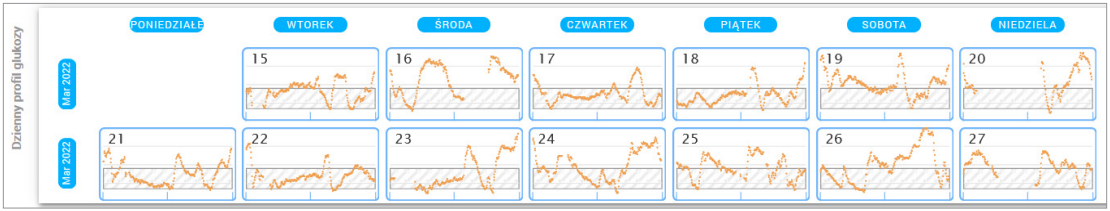

Raporty



Najważniejszą funkcję aplikacji systemu Eversense DMS stanowi możliwość generowania, drukowania i udostępniania szczegółowych raportów dotyczących historii poziomu glukozy. Raporty zapewniają wiele sposobów organizowania i wizualizacji odczytów glukozy z pomiarów w określonym zakresie godzin, dni lub na przestrzeni kilku tygodni lub miesięcy.

Uwaga: jeśli po wybraniu danego raportu nie są wyświetlane żadne dane, należy sprawdzić, czy dane dotyczące pomiarów glukozy w wybranym zakresie dat zostały wcześniej wczytane. Jeśli dane nadal nie są wyświetlane, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtrowanie, drukowanie lub wysłanie treści raportów pocztą elektroniczną

W prawym górnym rogu stron raportów znajdują się opcje zmiany preferencji raportu, drukowania raportu i wysyłania go pocztą elektroniczną.

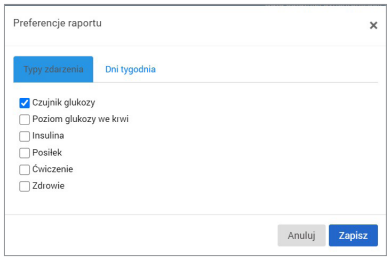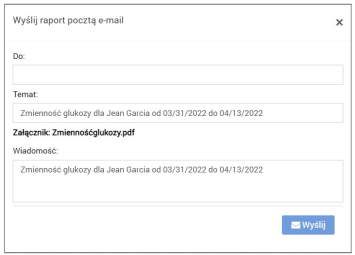

Kliknij			
Aby	**Zmienić filtry raportu**	**Wysłać raport pocztą elektroniczną**	**Zapisać raport jako plik PDF**
Jak	Można wybrać, które typy zdarzeń, dni tygodnia i inne opcje pojawią się w raportach, jeśli dotyczy. Ten filtr nie jest dostępny dla raportów AGP, czasu w zakresie według pory dnia lub czasu w ramach wartości docelowej. 	Należy wykonywać instrukcje wyświetlane w monitach w wyskakujących oknach, dotyczące wysyłania pocztą elektroniczną do wskazanego odbiorcy raportu w postaci gotowej do druku. 	Należy kliknąć ikonę, aby przekonwertować raport do formatu PDF, co umożliwi wydrukowanie go w domu.

Czas w zak. wart. doc.


Raport „Czas w zak. wart. doc.” zawiera diagram kołowy umożliwiający analizę wartości procentowej czasu, przez jaki poziom glukozy jest poniżej, w ramach lub powyżej zakresu docelowego ustawionego na ekranie Ustawienia glukozy.

Wyświetlanie raportu:

Zielony klin odzwierciedla odsetek czasu w zakresie docelowym.

Szary klin odzwierciedla odsetek czasu powyżej zakresu docelowego.

Czerwony klin odzwierciedla odsetek czasu poniżej zakresu docelowego.

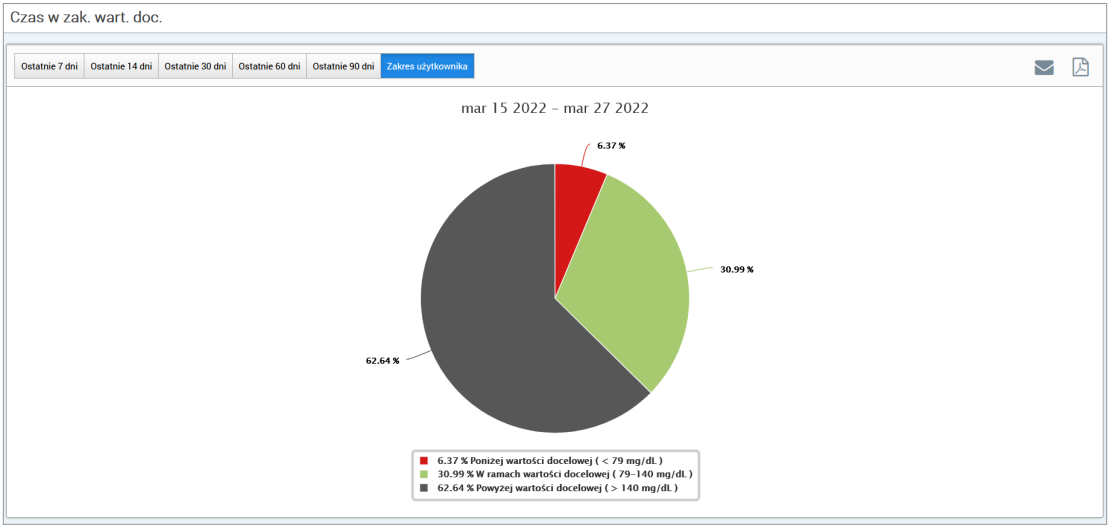

Czas w zakresie

Czas w zakresie według pory dnia


Raport „Czas w zakresie według pory dnia” wyświetla zakres wykresów słupkowych, które analizują odsetek czasu, gdy wartość poziomy glukozy mieści się we wstępnie ustawionym zakresie.

- Bardzo niski: < 54 mg/dl
- Niski: 54–70 mg/dl
- W ramach wartości docelowej: 70–180 mg/dl
- Wysoki: 180–250 mg/dl
- Bardzo wys.: >250 mg/dl

Ten raport składa się z dwóch części:

Czas w zakresie


Wyświetla ogólny odsetek czasu, gdy wartości poziomu glukozy mieściły się w zadanym zakresie, na podstawie zakresu dat wybranych przez użytkownika.

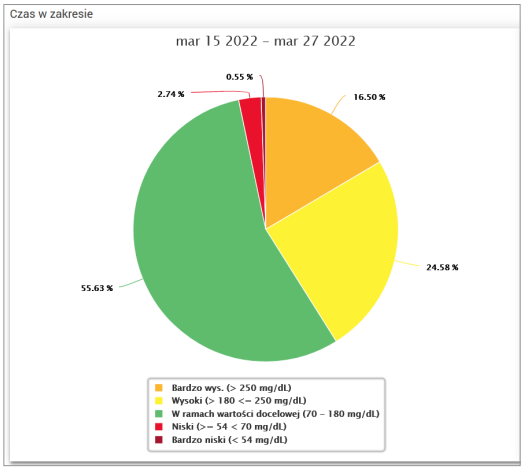

Czas w zakresie według pory dnia

Ta część raportu rozbija ogólny wykres czasu w zakresie na różne pory dnia. Można wyświetlić dane w segmentach po 4 godziny, 6 godzin lub 8 godzin. Można to dostosować, wybierając opcję w górnej części raportu.

Każdy segment pokazuje odsetek czasu, gdy poziom glukozy mieścił się w tych segmentach w zakresach bardzo niskim, niskim, w ramach wartości docelowej, wysokim i bardzo wysokim.

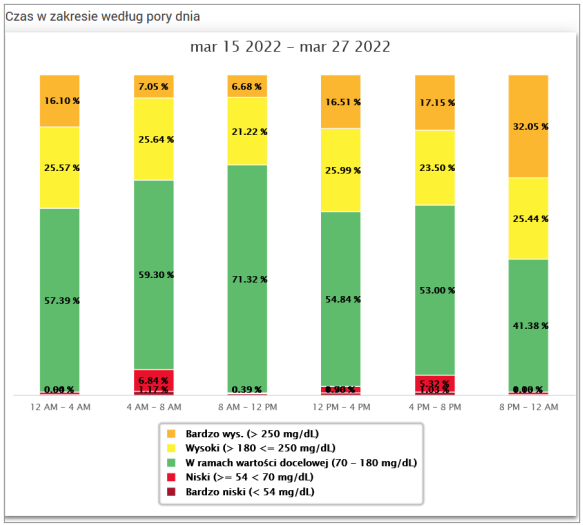

Raport zmienności poziomu glukozy

Raport zmienności poziomu glukozy wyświetla informacje na dwa sposoby:

Wykres trendu:

- Przedstawia zestawienie odczytów poziomu glukozy z okresu 24 godzin.
- Zawiera dane z wielu dni nałożone na ten sam wykres.
- Przedstawia maksymalny, minimalny i średni odczyt poziomu glukozy dla każdej godziny.
- Stanowi wizualne przedstawienie zmian codziennych poziomów glukozy.

Uwaga: w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat odczytów uzyskanych w ciągu godziny należy umieścić kursor nad konkretnym średnim odczytem czujnika.


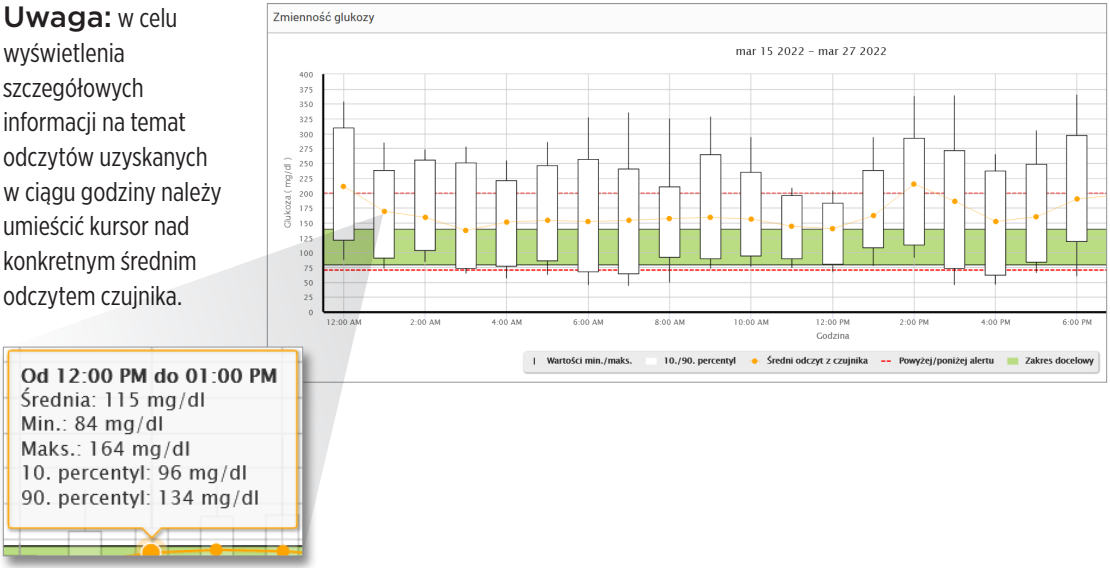


Tabela:

- Przedstawia w zorganizowany sposób dane dotyczące poziomu glukozy z uwzględnieniem 4-godzinnego okresu.
- Zapewnia szczegółowe analizy statystyczne dla każdego z okresów.
- Uwzględnia wartość procentową odczytów w ramach, powyżej oraz poniżej zakresu docelowego poziomu glukozy.
- Umożliwia analizę wartości wykorzystania insuliny oraz węglowodanów wprowadzonych dla tych samych okresów.

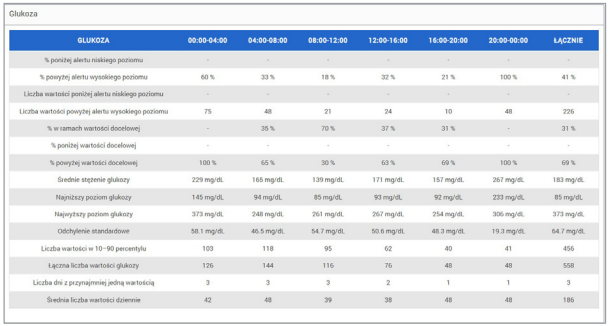

Glukoza

GLUKOZA	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	ŁĄCZNIE
% poniżej alertu niskiego poziomu	-	-	-	-	-	-	-
% powyżej alertu wysokiego poziomu	60 %	33 %	18 %	32 %	21 %	100 %	41 %
Liczba wartości poniżej alertu niskiego poziomu	-	-	-	-	-	-	-
Liczba wartości powyżej alertu wysokiego poziomu	75	48	21	24	10	48	226
% w ramach wartości docelowej	-	35 %	70 %	37 %	31 %	-	31 %
% poniżej wartości docelowej	-	-	-	-	-	-	-
% powyżej wartości docelowej	100 %	65 %	30 %	63 %	69 %	100 %	69 %
Średnie stężenie glukozy	229 mg/dL	165 mg/dL	139 mg/dL	171 mg/dL	157 mg/dL	267 mg/dL	183 mg/dL
Najniższy poziom glukozy	145 mg/dL	94 mg/dL	85 mg/dL	93 mg/dL	92 mg/dL	233 mg/dL	85 mg/dL
Najwyższy poziom glukozy	373 mg/dL	248 mg/dL	261 mg/dL	267 mg/dL	254 mg/dL	306 mg/dL	373 mg/dL
Odchylenie standardowe	58.1 mg/dL	46.5 mg/dL	54.7 mg/dL	50.6 mg/dL	48.3 mg/dL	19.3 mg/dL	64.7 mg/dL
Liczba wartości w 10–90 percentylu	103	118	95	62	40	41	456
Łączna liczba wartości glukozy	126	144	116	76	48	48	558
Liczba dni z przynajmniej jedną wartością	3	3	3	2	1	1	3
Średnia liczba wartości dziennie	42	48	39	38	48	48	186

Uwaga: w razie problemów z wyświetleniem raportu można spróbować zawęzić zakres dat. Niestandardowo duże ilości danych mogą uniemożliwiać funkcjonowanie raportu.

Uruchamianie funkcji raportu

1. **Wybierz kolejno Raporty > Zmienność glukozy**

   Wyświetlany zakres dat będzie obejmował dane wprowadzone lub wczytane w ciągu ostatniego tygodnia.

2. **Wybierz zakres dat**

   Uwaga: aby zmienić zakres dat danego raportu, należy postępować zgodnie z poprzednią *Instrukcją ustawiania zakresu dat* w części *Panel nawigacyjny* niniejszej instrukcji użytkownika.

Raport trendu poziomu glukozy

Raport trendu poziomu glukozy:

- Przedstawia poszczególne odczyty poziomu glukozy z okresu 24 godzin.
- Wyświetla dane z wielu dni nałożone na ten sam wykres.
- Umożliwia łatwe ustalenie zmienności poziomu glukozy na przestrzeni kolejnych dni tygodnia.

Uruchamianie funkcji raportu

1. Wybierz kolejno **Raporty > Trend glukozy**
2. Wybierz zakres dat

Wyświetlanie raportu

Punkty danych zawarte w raporcie są oznaczone kolorami, a każdy dzień tygodnia jest wyświetlany w innym kolorze. Za pomocą filtrów raportu można wybrać dzień/dni do wyświetlenia na wykresie.



Uwaga: należy umieścić kursor nad konkretnym odczytem czujnika w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat tego odczytu.

Raport historii poziomu glukozy


Raport historii poziomu glukozy przedstawia dane systemu CGM i ręcznie wprowadzone dane w postaci wykresu trendu. Raport historii poziomu glukozy zapewnia skuteczny sposób śledzenia odczytów poziomu glukozy i kalibracji czujnika.

Uruchamianie funkcji raportu

1. Wybierz kolejno **Raporty > Raport historii glukozy**
2. Wybierz zakres dat

Wyświetlanie raportu

Każdy punkt danych jest odczytem czujnika glukozy. Zdarzenia zarejestrowanie w aplikacji mobilnej są wyświetlane w raporcie w momencie ich zarejestrowania. W przypadku wybrania zakresu dat obejmującego ponad 30 dni zdarzenia takie jak posiłki, insulina itd. nie są wyświetlane.

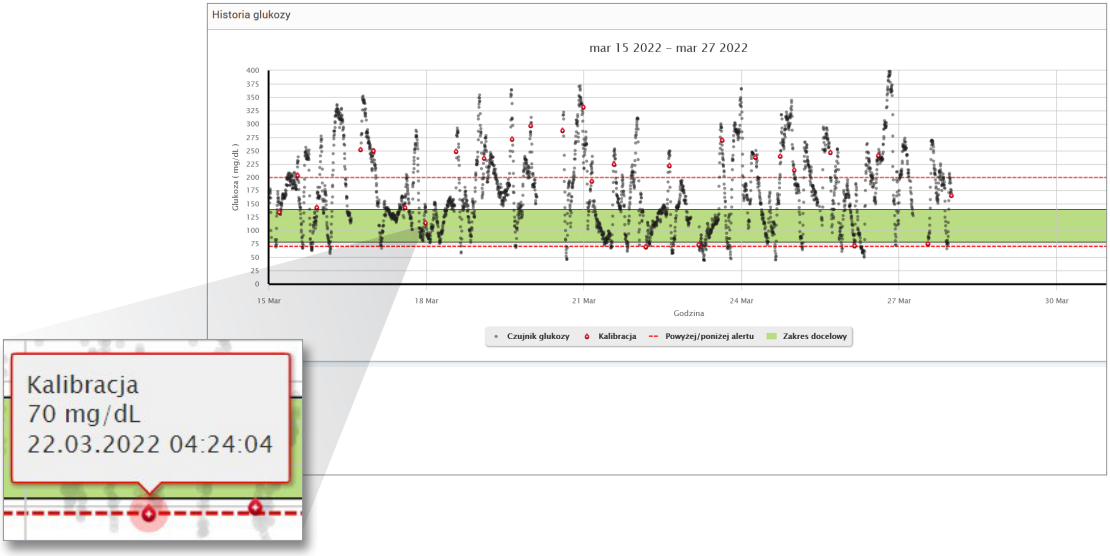

Uwaga: należy umieścić kursor nad konkretnym odczytem czujnika w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat tego odczytu. Można także umieścić kursor nad ikoną zdarzenia w celu wyświetlenia szczegółów na temat tego zdarzenia.

Dzienny raport glukozy

Dzienny raport glukozy zawiera odczyty poziomu glukozy w okresie 24 godzin dla wielu następujących po sobie dni.

Dzienny raport glukozy:


- Ma ustalony docelowy zakres poziomu glukozy 70–180 mg/dL.
- Pokazuje poziomy alarmowe wysokiego i niskiego stężenia glukozy (czerwone linie), które zostały ustawione w systemie CGM.
- Pokazuje kluczowe statystyki dla każdego dnia na podstawie docelowego poziomu glukozy i ustawień alertów.
- Zawiera opcję wyświetlania ikon zdarzeń na wykresie trendu i rozwijania tabeli zdarzeń dla każdego dnia.

Uruchamianie funkcji raportu

1. Wybierz kolejno **Raporty > Dzienny raport glukozy**
2. Wybierz zakres dat

Wyświetlanie raportu

Dzienny raport glukozy pokazuje wiele następujących po sobie dni dla wybranego zakresu dat i umożliwia identyfikację wzorców poziomu glukozy na przestrzeni wielu dni. Statystyki dla każdego dnia pojawiają się po prawej stronie wykresu trendu i są oparte na standardowym docelowym zakresie poziomu glukozy wynoszącym 70–180 mg/dL oraz poziomach alarmowych wysokiego i niskiego stężenia glukozy ustawionych przez użytkownika. Aby przejrzeć dodatkowe informacje z systemu CGM dla każdego dnia (alerty, kalibracje, zdarzenia wprowadzone w aplikacji CGM), można włączyć wyświetlanie ikon zdarzeń na wykresie trendu i rozwinąć tabelę zdarzeń pod wykresem trendu. Po rozwinięciu tabela zdarzeń przedstawia informacje w odstępach 4-godzinnych, zgodnych z segmentami 4-godzinnymi na wykresie trendu.

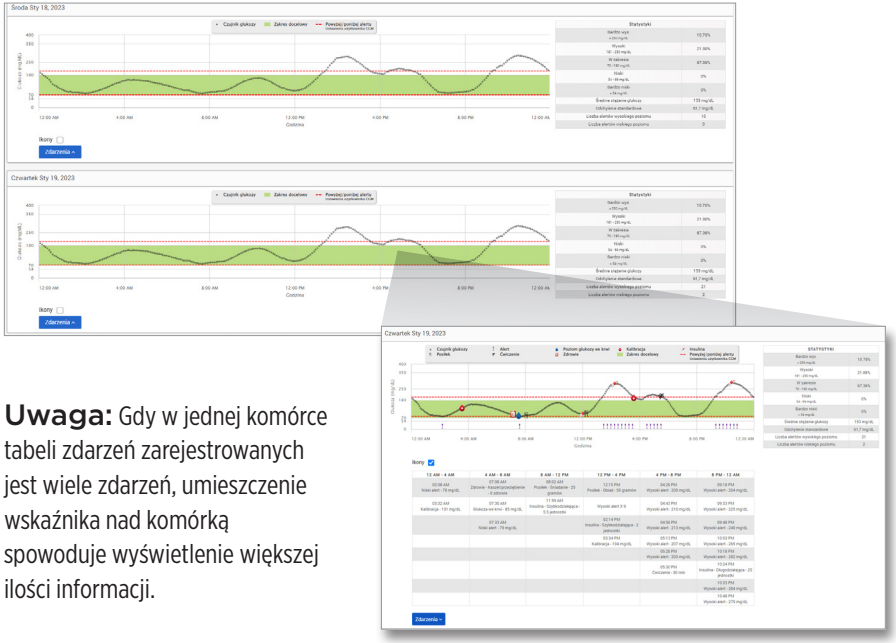

Uwaga: Gdy w jednej komórce tabeli zdarzeń zarejestrowanych jest wiele zdarzeń, umieszczenie wskaźnika nad komórką spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji.

Raport rozkładu poziomu glukozy

Raport rozkładu poziomu glukozy:


- Przedstawia w zorganizowany sposób dane dotyczące poziomu glukozy zgodnie z wartościami docelowymi poziomu glukozy i zakresami alertów oraz wyświetla dane w postaci diagramu kołowego.
- Wyświetla oddzielne diagramy kołowe dla okresu bieżącego i okresów poprzednich.
- Zakresy docelowe można ustawić w opcji Ustawienia poziomu glukozy.
- Umożliwia wizualną kontrolę liczby odczytów w ramach wartości docelowej w wybranym, wstępnie zdefiniowanym definiowanym zakresie oraz zmian zachodzących z upływem czasu.

Uruchamianie funkcji raportu

1. Wybierz kolejno **Raporty > Raport rozkładu poziomu glukozy**
2. Wybierz zakres dat

Wyświetlanie raportu

Raport rozkładu poziomu glukozy zawiera dwa diagramy kołowe na podstawie wstępnie zdefiniowanego zakresu dat. Raport przedstawia bieżący i poprzedni zbiór danych dla wybranego zakresu dat. Dane umożliwiają użytkownikowi porównanie bieżących i wcześniejszych zmian wprowadzanych w leczeniu.

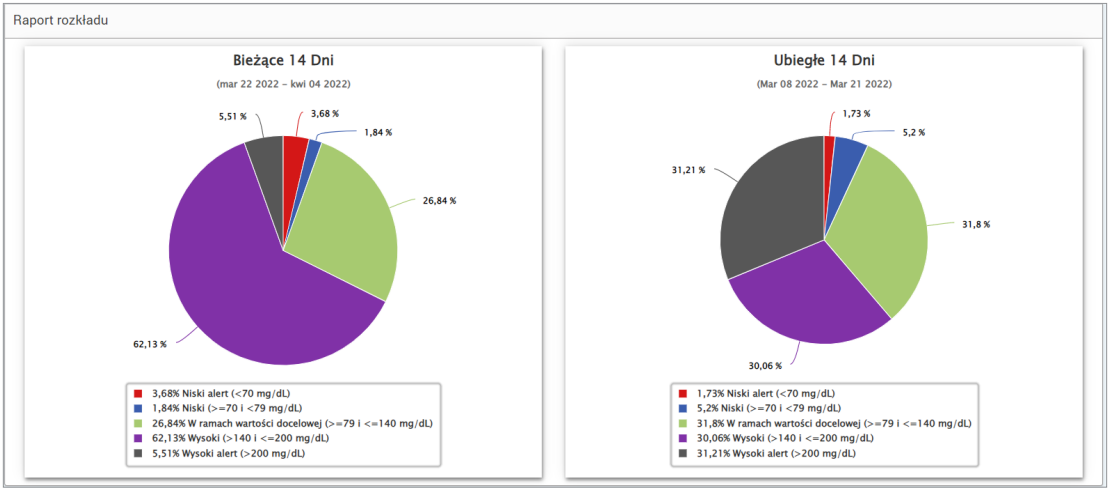

Raport dziennika nadajnika

Raport dziennika nadajnika zapewnia pełny przegląd danych w wybranym zakresie dat.

Raport dziennika nadajnika wyświetla trzy oddzielne tabele:

- **Poziom glukozy we krwi:** wyświetla listę wszystkich ręcznie wprowadzonych poziomów glukozy we krwi oraz powiązanych z nimi zdarzeń w porządku chronologicznym.
- **Wpisy zdarzenia:** wyświetla zdarzenia, jakie wystąpiły u pacjenta i zostały wprowadzone przez aplikację mobilną Eversense.
- **Poziom glukozy z czujnika:** wyświetla wartości poziomu glukozy wyznaczone przez czujnik.

Uruchamianie funkcji raportu


1. Wybierz kolejno **Raporty > Dziennik nadajnika**
2. Wybierz zakres dat

Wyświetlanie raportu

Zdarzenia są wyświetlane wraz z informacjami na temat daty i godziny oraz następującymi danymi:

- **Poziom glukozy we krwi:** wartość poziomu glukozy, jednostka, kalibracja
- **Wpisy zdarzenia:** typ zdarzenia, wartość podtypu zdarzenia
- **Poziom glukozy z czujnika:** wartość poziomu glukozy, jednostka, ID czujnika

Zdarzenia można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej przez kliknięcie nagłówka kolumny. Liczba zapisów jest wskazywana w dolnej części każdego dziennika.

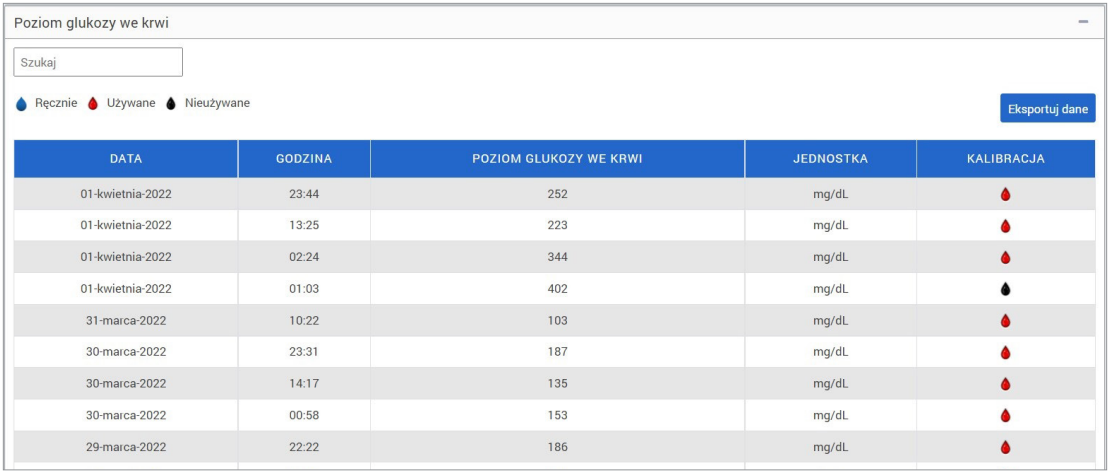

DATA	GODZINA	POZIOM GLUKOZY WE KRWI	JEDNOSTKA	KALIBRACJA
01-kwietnia-2022	23:44	252	mg/dL	
01-kwietnia-2022	13:25	223	mg/dL	
01-kwietnia-2022	02:24	344	mg/dL	
01-kwietnia-2022	01:03	402	mg/dL	
31-marca-2022	10:22	103	mg/dL	
30-marca-2022	23:31	187	mg/dL	
30-marca-2022	14:17	135	mg/dL	
30-marca-2022	00:58	153	mg/dL	
29-marca-2022	22:22	186	mg/dL	

Symbol pod kolumną „**Kalibracja**” w tabeli poziomu glukozy we krwi wskazuje, czy wartość glukozy została użyta do kalibracji, nieużyta lub wpisana ręcznie.


- **Używane:** wartość poziomu glikozy, która została wprowadzona jako wartość kalibracyjna i jest zaakceptowana przez system.
- **Nieużywane:** wprowadzona wartość kalibracji powyżej 400 mg/dl lub poniżej 40 mg/dl.
- **Ręcznie:** zdarzenie związane z poziomem glukozy we krwi, które nie zostało wprowadzone jako wartość kalibracyjna.

Po wybraniu „**Historia urządzenia**” wyświetlona zostanie data wszczepienia czujnika oraz data rozpoczęcia kalibracji.

Eksportowanie danych

Na stronie Raport dziennika nadajnika można również wyeksportować dane w formacie .xlsx.

1. Wybierz kolejno **Raporty > Dziennik nadajnika**
2. Wybierz **„Eksportuj wszystko”** na górze strony, aby wyeksportować wszystkie dane z dziennika nadajnika jako plik .xlsx (arkusz programu Excel)

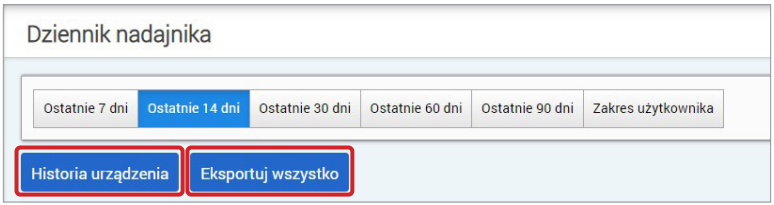


Ustawienia

Glukoza

Ustawienia glukozy umożliwiają dostosowanie wartości docelowej poziomu glukozy i poziomów alertów. Ustawienie to określa sposób organizacji i wyświetlania danych poziomu glukozy i innych danych dotyczących zdarzeń w raportach. Po bezprzewodowym zsynchronizowaniu danych za pomocą funkcji „Udostępnij moje dane w aplikacji mobilnej" ustawienia glukozy zapisane w aplikacji również zostaną zsynchronizowane z kontem systemu DMS użytkownika.

Uwaga:

- Ustawienia glukozy NIE zostaną zsynchronizowane, jeśli dane zostaną wczytane z inteligentnego nadajnika za pomocą kabla USB i aplikacji klienckiej Eversense.
- Zmiana ustawień w systemie DMS NIE zmieni ustawień wprowadzonych w aplikacji mobilnej Eversense. Ustawienia systemu Eversense CGM można zmienić tylko bezpośrednio w aplikacji mobilnej systemu Eversense CGM.

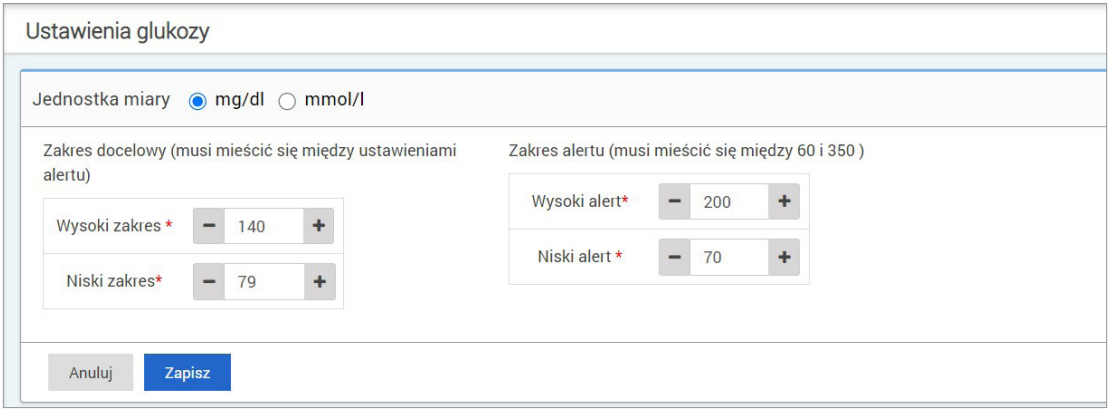

Aby zmienić ustawienia konta systemu Eversense DMS, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Glukoza**
2. **Kliknij przycisk mg/dL lub mmol/L poniżej opcji jednostki miary, aby wybrać żądaną jednostkę miary, w której będą wyświetlane wartości poziomu glukozy**

   W przypadku zmiany jednostki miary wartości zakresu poziomu glukozy i zakresu alertów zostaną odpowiednio zmienione.
3. **Kliknij przyciski -/+ po prawej stronie wartości Wysoki zakres lub Niski zakres, aby wyświetlić i dostosować wysoką i niską wartość graniczną docelowego zakresu wartości poziomu glukozy**
4. **Powtórz te czynności dla zakresu alertu poziomu glukozy**
5. **Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij „Zapisz", aby zapisać zmiany**


Uwaga: ustawienia systemu Eversense DMS nie wpływają na ustawienia systemu CGM firmy Eversense, a jedynie na sposób organizacji i wyświetlania danych na ekranie systemu Eversense DMS.

Podsumowanie raportu

Ustawienia podsumowania raportu pozwalają skonfigurować regularne wysyłanie automatycznego raportu w wiadomości e-mail. Można wybrać częstość otrzymywania raportów oraz to, które raporty mają być wysyłane.

Uwaga:

- Raporty będą wysyłane w postaci plików PDF załączonych do wiadomości e-mail.
- Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wykorzystany do utworzenia konta Eversense.

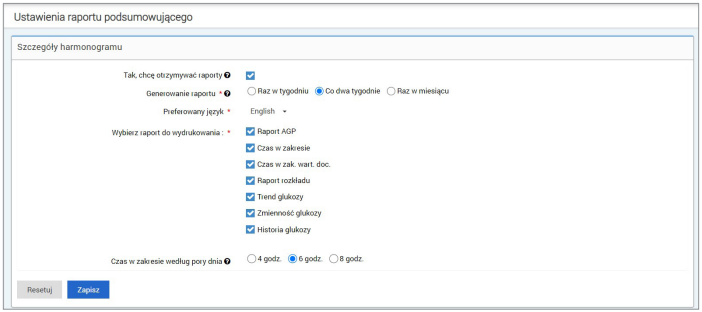

Aby zmienić ustawienia konta systemu Eversense DMS, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz **Ustawienia > Podsumowanie raportu**
2. **Kliknij pole obok wpisu „Tak, chcę otrzymywać raporty”, aby pojawił się symbol zaznaczenia**
3. **Wybierz, jak często raporty mają być wysyłane w wiadomości e-mail**
   - **Raz w tygodniu:** raporty będą wysyłane w każdą niedzielę. Raporty będą zawierały dane, które system Eversense CGM wyliczył w poprzedzającym tygodniu.
   - **Co dwa tygodnie:** raporty będą wysyłane co drugą niedzielę. Raporty będą zawierały dane, które system Eversense CGM wyliczył w okresie 2 tygodni.
   - **Raz w miesiącu:** raporty będą wysyłane pierwszego dnia każdego miesiąca. Raporty będą zawierały dane, które system Eversense CGM wyliczył w poprzedzającym miesiącu.

4. **Wybierz język, w jakim będą przygotowane raporty**

5. **Wybierz raporty, które mają być wysyłane**

Uwaga:

- Raporty będą wysyłane jako plik PDF załączony do wiadomości e-mail.
- Jeśli wybrany zostanie raport czasu w zakresie, konieczne będzie też ustawienie pory dnia. Więcej informacji na temat raportu Czas w zakresie według pory dnia można znaleźć w punkcie *Raporty*.

6. **Kliknij „Zapisz”**

   Gdy ustawienie zostanie zapisane, użytkownik otrzyma pierwszą wiadomość e-mail pierwszego dnia kolejnego cyklu. Jeśli wybrana opcja to „Raz w tygodniu” lub „Co dwa tygodnie”, pierwszy raport zostanie wysłany w nadchodzącą niedzielę. Jeśli wybrana opcja to „Raz w miesiącu”, pierwszy raport zostanie wysłany pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Aby zakończyć otrzymywanie wiadomości e-mail z podsumowaniem raportu.

1. Wybierz **Ustawienia > Podsumowanie raportu**

2. **Kliknij pole obok wpisu „Tak, chcę otrzymywać raporty”, aby zniknął symbol zaznaczenia**

3. **Kliknij „Zapisz” na dole strony**

Uwaga: jeśli synchronizacja danych z kontem Eversense nie została wykonana z poziomu systemu Eversense CGM przez cały okres raportowy, użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail informujące, że nie będą wysyłane dalsze wiadomości, dopóki dane na koncie nie zostaną zsynchronizowane.

Nadajnik

Wyślij dane urządzenia

Dane systemu CGM można wczytać na konto systemu DMS bezprzewodowo lub za pomocą kabla USB dostarczanego wraz z systemem Eversense CGM:

1. **Jeśli włączona jest opcja Automatycznej synchronizacji w aplikacji mobilnej Eversense, dane CGM będą automatycznie przesyłane co 5 minut na konto DMS.**

   Wskazówka: do synchronizacji danych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Eversense jest wymagane bezprzewodowe połączenie z internetem.

   Uwaga: dane można przesłać ręcznie, przechodząc do opcji „Udostępnij moje dane w aplikacji mobilnej Eversense" i dotykając opcji „Rozpocznij synchronizację" w celu bezprzewodowego wczytania danych systemu CGM na konto systemu DMS użytkownika.

2. **Można również przesłać dane z inteligentnego nadajnika za pomocą kabla USB dostarczonego z systemem Eversense CGM. Aby wczytać dane z inteligentnego nadajnika za pomocą kabla USB, należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Eversense Client.**

   Uwaga: w trakcie procesu przesyłania inteligentny nadajnik nie będzie pobierać danych z czujnika.


Aby pobrać i zainstalować aplikację kliencką Eversense:


1. Wybierz opcję **Nadajnik** z menu nawigacyjnego

2. Kliknij opcję **Pobierz wersję na komputer** lub **Pobierz wersję na Mac**

   Wyświetlony zostanie odpowiedni przycisk w zależności od wykorzystywanego systemu komputerowego.

   Uwaga: po pomyślnym pobraniu może pojawić się ostrzeżenie przeglądarki o instalacji rzadko pobieranego oprogramowania, które może być niebezpieczne. System Eversense DMS **nie zawiera** złośliwego oprogramowania ani wirusów komputerowych, które mogłyby uszkodzić komputer użytkownika.

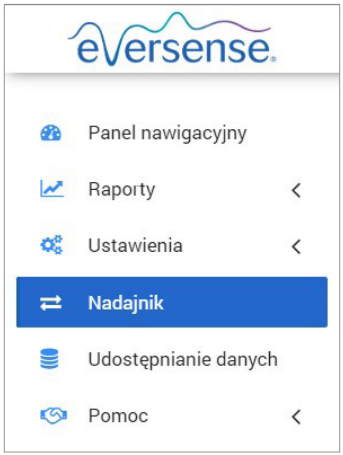

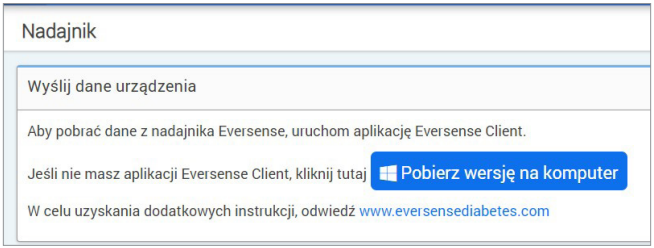

Aby pobrać aplikację kliencką Eversense w wersji na komputer:


1. Uruchom oprogramowanie instalacyjne

Można też kliknąć „**Zapisz**”, aby zapisać oprogramowanie na pulpicie komputera i zainstalować je później. Po uruchomieniu oprogramowania należy postępować zgodnie z monitami kreatora InstallShield.

Dla użytkowników przeglądarki Chrome:




Dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek:




Uwaga: aplikacja kliencka Eversense jest pobierana bezpośrednio z systemu Eversense DMS. Wyświetlone może zostać wyskakujące okno z pytaniem, czy użytkownik chce zainstalować aplikację, ponieważ nie jest pobierana ze sklepu Microsoft. Kliknij „**Uruchom mimo to**”, aby kontynuować proces instalacji.

2. Klikaj domyślne opcje, aby zainstalować oprogramowanie


a.

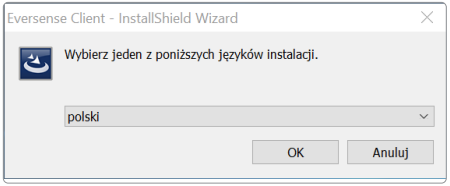


b.

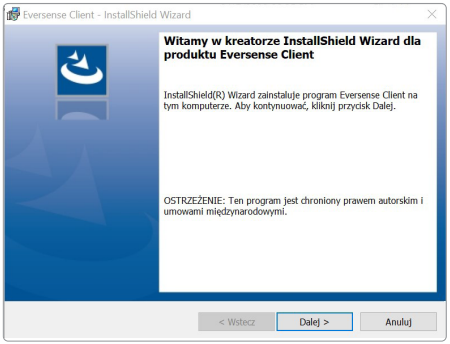


c.

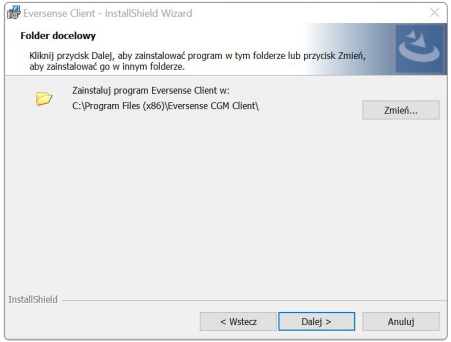

d.

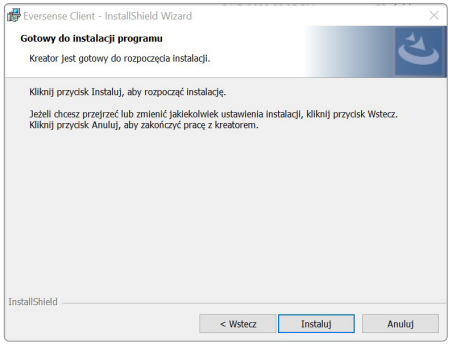

e.

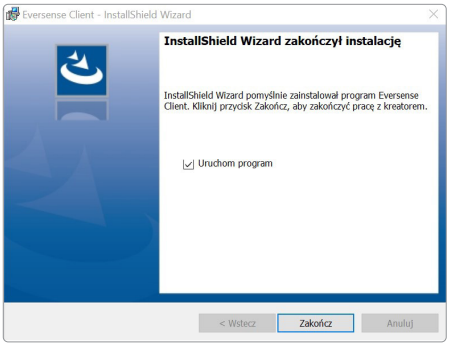

Eversense Client - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard pomyślnie zainstalował program Eversense Client. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę z kreatorem.
Uruchom program
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Aby pobrać aplikację kliencką Eversense w wersji na Mac:

1. Uruchom oprogramowanie instalacyjne
2. Przeciągnij i upuść ikonę klienta Eversense do folderu aplikacji na ekranie



3. Otwórz aplikację kliencką Eversense w folderze aplikacji Mac.

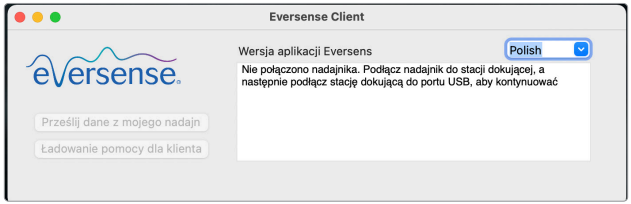

WAŻNE: APLIKACJA KLIENCKA EVERSENSE JEST POBIERANA BEZPOŚREDNIO Z SYSTEMU EVERSENSE DMS. PRZY PRÓBIE OTWARCIA APLIKACJI MOŻE POJAWIĆ SIĘ WYSKAKUJĄCE OKNO Z INFORMACJĄ, ŻE URZĄDZENIE APPLE NIE MOŻE OTWORZYĆ TEJ APLIKACJI. APLIKACJA KLIENCKA EVERSENSE NIE ZAWIERA ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA.

Aby otworzyć aplikację:

1. Przejdź do opcji **Preferencje systemu > Bezpieczeństwo i prywatność**
2. Kliknij opcję **„Otwórz mimo to”** obok **„Klient Eversense został zablokowany, ponieważ nie pochodzi od zidentyfikowanego dewelopera”**
3. Kliknij **„Otwórz”** w kolejnym wyskakującym oknie


Aby przesłać dane z inteligentnego nadajnika na konto systemu DMS:

1. **Uruchom aplikację kliencką Eversense – w tym celu otwórz menu Start > Wszystkie programy > otwórz folder Eversense > otwórz folder Klient Eversense > kliknij ikonę**




2. **Kliknij pozycję „Prześlij dane z mojego nadajnika”, a następnie wprowadź adres e-mail użyty do utworzenia konta oraz hasło**


Podłącz inteligentny nadajnik do komputera za pomocą kabla USB.

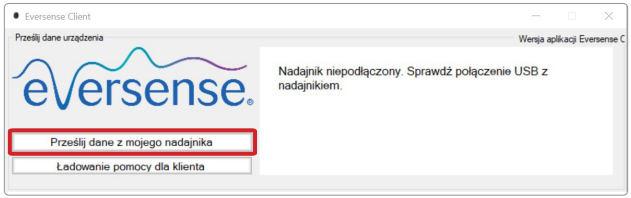


Wskazówka: aby użytkownik komputera mógł szybko uruchomić program w systemie operacyjnym Windows, powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy **ikonę klienta Eversense** i przypiąć ją do **paska zadań** lub menu **Start**.

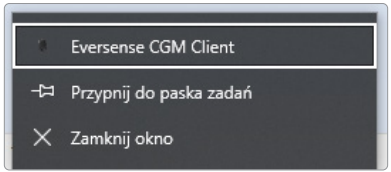

3. Gdy pojawi się komunikat, kliknij „**Przekazać**”, aby rozpocząć przesyłanie danych z inteligentnego nadajnika na konto

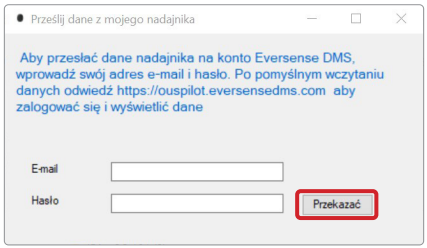


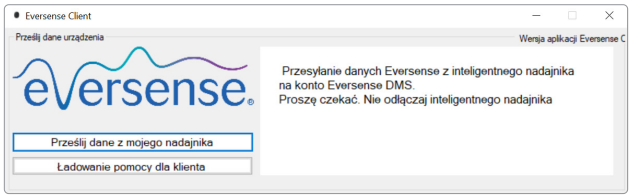

4. Kliknij „**OK**”, aby kontynuować




(komputer)



(Mac)

Uwaga: po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy technicznej użytkownik może zostać poproszony o przesłanie dziennika diagnostycznego. Zostanie on wykorzystany do przesłania pliku dziennika diagnostycznego z inteligentnego nadajnika do działu obsługi klienta. Ta funkcja zostanie wykorzystana wyłącznie w związku z zaawansowanym procesem rozwiązywania problemów z pomocą działu obsługi klienta.

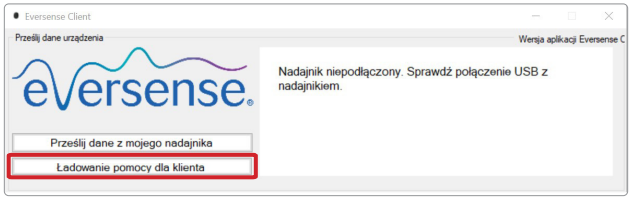


Udostępnianie danych

DMS Pro

Można połączyć konto w systemie Eversense DMS z kontem w aplikacji Eversense DMS Pro lekarza, aby mógł on wyświetlać i analizować raporty DMS.

Zapraszanie ośrodka

Aby połączyć swoje konto w systemie Eversense DMS z kontem ośrodka w aplikacji Eversense DMS Pro:

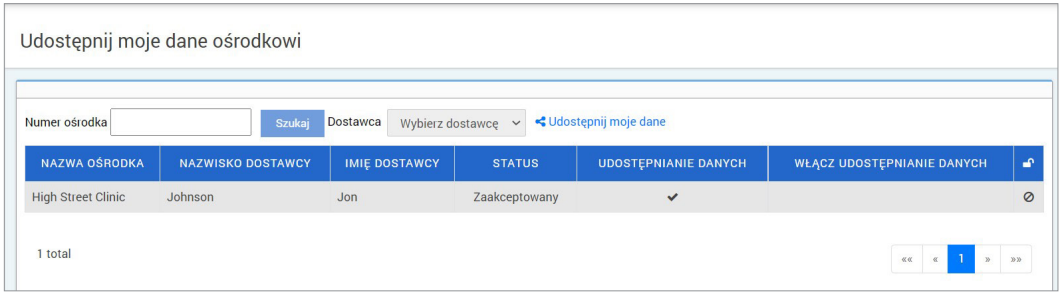

1. **Wpisz numer ośrodka w systemie Eversense DMS Pro i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze.**

Uwaga: jeśli nie znasz numeru ośrodka w aplikacji Eversense DMS Pro, skontaktuj się z ośrodkiem.

2. **Wybierz pracownika służby zdrowia z listy rozwijanej.**

3. **Kliknij „Udostępnij moje dane”**

Wyświetlona zostanie nazwa ośrodka, nazwisko dostawcy, status oraz udostępnianie danych. Status będzie wyświetlony jako **Oczekujące**, dopóki ośrodek nie zaakceptuje zaproszenia.

Gdy ośrodek zaakceptuje zaproszenie, status **Oczekujące** zmieni się na **Zaakceptowany**, a ✖ zmieni się na ✔ w kolumnie Udostępnianie danych.

Dostawca będzie teraz mógł wyświetlać dane użytkownika z poziomu swojego konta Eversense DMS Pro.

Zaproszenie od ośrodka

Ośrodek może zaprosić Cię do udostępniania danych na użytek ich konta Eversense DMS Pro.

Wówczas otrzymasz wiadomość e-mail z adresu **DMS.Feedback@senseonics.com**.

Kliknij link znajdujący się w wiadomości e-mail, aby udostępnić raporty.

Po kliknięciu linku Twoje konto zostanie dodane do konta Eversense DMS Pro ośrodka.

Usuwanie ośrodka

Aby usunąć dostęp ośrodka do danych, kliknij ⊘ na końcu wiersza. Można usunąć dostęp dla ośrodka, który został zaproszony, ale nie zaakceptował jeszcze zaproszenia, lub dla ośrodka, który ma już dostęp do przeglądania danych.

Aby umożliwić ośrodkowiośrodkowi wyświetlanie danych, kliknij 🔗, aby udostępnić swoje dane.


Pomoc

Informacje

Ta strona przedstawia najnowsze wersje aplikacji Eversense DMS i Eversense Client.

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe obsługi klienta.

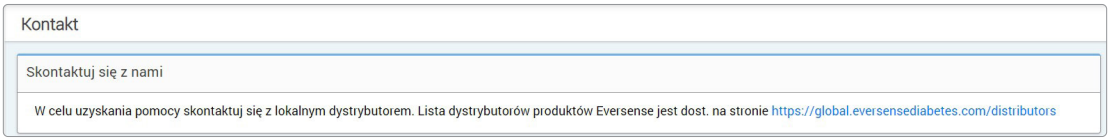

WAŻNE: w przypadku pytań na temat systemu Eversense CGM należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Na terenie Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt pod numerem 844-SENSE4U (844-736-7348).

Dezaktywuj moje konto

WAŻNE: dezaktywacja konta w systemie Eversense DMS spowoduje dezaktywację konta w odniesieniu do WSZYSTKICH produktów firmy Eversense.

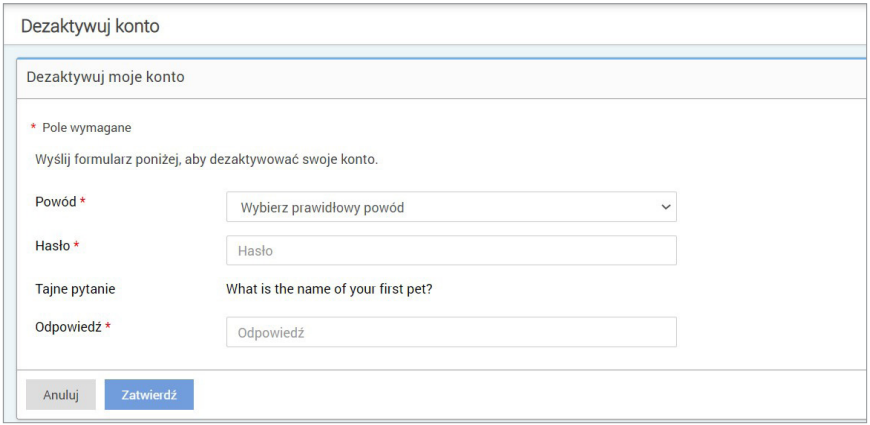

Informacje o wersji

Na tym ekranie znajdują się ogólne informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania systemu Eversense DMS.

Uwaga: w przypadku dostępności aktualizacji oprogramowania systemu Eversense DMS w górnej części strony wyświetlany będzie baner z taką informacją. Należy kliknąć baner w celu wyświetlenia listy aktualizacji.

22. Eversense NOW

Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense CGM i aplikacji Eversense NOW

Aplikacja Eversense CGM jest wyposażona w dodatkową funkcję zdalnego monitorowania. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie danych z systemu Eversense CGM na dodatkowym wyświetlaczu przy użyciu aplikacji mobilnej Eversense NOW.

Przeznaczenie

Aplikacja Eversense NOW przeznaczona do używania jako dodatkowy wyświetlacz danych poziomu glukozy i alertów od użytkowników systemu Eversense CGM.

Przeciwwskazania

Należy przestrzegać zaleceń kliniki lub innej instytucji w zakresie używania urządzeń przenośnych w obecności skanerów rezonansu magnetycznego, tomografów i innych urządzeń zabiegowych.

Zagrożenia

Mogą wystąpić sytuacje, gdy dane odczytu poziomu glukozy nie będą mogły zostać przesłane do aplikacji Eversense NOW. Brak transmisji danych odczytów poziomu glukozy od użytkownika systemu Eversense CGM uniemożliwia zareagowanie w sytuacji wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Funkcja zdalnego monitorowania umożliwia dodatkowe wyświetlanie danych. Nie jest to system zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy systemu Eversense CGM nie zawsze mogą dysponować połączeniem niezbędnym do przesyłania danych, np. połączeniem z Internetem/Wi-Fi lub siecią 3G/4G/LTE. W przypadku braku połączenia z Internetem dane odczytów poziomu glukozy nie będą wyświetlane. Wszelkie problemy związane z urządzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu, połączeniem do transmisji danych, systemem zarządzania bazą danych Eversense (DMS), inteligentnym nadajnikiem użytkownika systemu CGM znajdującym się poza zasięgiem urządzenia przenośnego lub ładowanie inteligentnego nadajnika mogą spowodować, że dane nie będą wyświetlane. Użytkownik systemu Eversense nie powinien zakładać, że jego poziom glukozy będzie nieustannie monitorowany w celu udzielenia mu pomocy w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Dodatkowe informacjedotyczące bezpieczeństwa są dostępne na stronie **https://ec.europa.eu/tools/eudamed**.

Korzyści

System Eversense CGM używany razem z aplikacją do zdalnego monitorowania Eversense NOW może dać użytkownikom systemu CGM dodatkową pewność dzięki świadomości, że inne osoby również mogą wyświetlić ich dane z systemu CGM.

Ostrzeżenia:

- **Informacje o poziomie glukozy wyświetlane w aplikacji Eversense NOW nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Aplikacja Eversense NOW służy pomocniczo do wyświetlania danych z systemu Eversense CGM i nie należy jej używać jako ekranu głównego systemu Eversense CGM. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących terapii użytkownicy systemu Eversense CGM powinni zawsze korzystać z odczytów poziomu glukozy zmierzonych za pomocą glukometru. Podejmowanie decyzji terapeutycznych na podstawie poziomu glukozy z czujnika może skutkować wystąpieniem podwyższonego lub obniżonego poziomu glukozy we krwi.**
- **Użytkownicy systemu Eversense CGM nie powinni polegać na powiadomieniach o podwyższonym lub obniżonym poziomie glukozy przekazywanych przez osoby zdalnie monitorujące odczyty.**

Przestrogi:

- Aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastępuje schematu monitorowania pomiarów wskazanego przez dostawcę usług zdrowotnych.
- Jeśli użytkownik systemu Eversense CGM nie ma włączonej funkcji automatycznej synchronizacji (która umożliwia automatyczne przesyłanie danych do aplikacji Eversense NOW), trendy i zdarzenia dotyczące podwyższonego lub obniżonego poziomu glukozy nie będą wyświetlane.
- Jeśli użytkownik aplikacji Eversense NOW i użytkownicy systemu Eversense CGM nie dysponują połączeniem z Internetem lub urządzenie przenośne użytkownika systemu CGM wyłączyło się z powodu rozładowanej baterii, dane z systemu Eversense CGM nie będą wyświetlane w aplikacji Eversense NOW.
- Po wyłączeniu dźwięku w urządzeniu przenośnym nie będą emitowane alerty dźwiękowe o danych z systemu CGM monitorowanych zdalnie za pośrednictwem aplikacji Eversense NOW.
- Jeśli użytkownik systemu CGM ustawi swój status na offline, żadne dane z systemu CGM nie będą przesyłane do aplikacji Eversense NOW.
- Aplikacja Eversense NOW nie komunikuje się bezpośrednio z czujnikiem Eversense ani z inteligentnym nadajnikiem Eversense.
- Aplikacja Eversense NOW nie może zmienić ustawień aplikacji Eversense CGM.
- W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień z aplikacji Eversense NOW nie będą otrzymywane alerty dotyczące poziomu glukozy od użytkowników systemu Eversense CGM.
- Jeśli w urządzeniu przenośnym zostanie ustawiony tryb „Nie przeszkadzać”, powiadomienia z aplikacji Eversense NOW nie będą odtwarzane.

Używanie aplikacji Eversense NOW

Instrukcja użytkownika wyjaśnia, jak używać aplikacji Eversense NOW w celu zdalnego monitorowania poziomu glukozy u użytkowników systemu Eversense CGM.

Dziękujemy za pobranie aplikacji mobilnej Eversense NOW. Aplikacja Eversense NOW pozwala na zdalne monitorowanie danych dotyczących poziomu glukozy u użytkowników systemu Eversense CGM.

Przestroga: aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastępuje głównego miejsca wyświetlania pomiarów w aplikacji systemu Eversense CGM ani schematu monitorowania pomiarów wskazanego przez dostawcę usług zdrowotnych.

Wymagania systemowe

- Aplikacja Eversense NOW pobrana na urządzenie przenośne z Apple® App Store.
- Zgodne urządzenie z systemem Android lub Apple® iPhone®, iPod® lub iPad®.
- Wykaz zgodnych urządzeń oraz systemów operacyjnych zamieszczono na stronie **http://global.eversensediabetes.com/compatibility**.

Uwaga: w celu pobrania aplikacji Eversense NOW oraz otrzymywania danych odczytów poziomów glukozy wymagane jest bezprzewodowe połączenie z Internetem. Jeśli użytkownik systemu Eversense CGM wyłączy funkcję automatycznej synchronizacji, wartości pomiarów glukozy nie będą wyświetlane w aplikacji Eversense NOW.

Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności

Użytkowanie aplikacji Eversense NOW podlega warunkom najnowszej licencji dla użytkownika końcowego aplikacji Eversense NOW oraz polityki prywatności dotyczącej aplikacji Eversense NOW. Dokumenty te są okresowo aktualizowane i publikowane na stronie **global.eversensediabetes.com**.

Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu

NIE NALEŻY używać aplikacji Eversense na urządzeniach iPhone, iPad i iPod poddanych nieautoryzowanym modyfikacjom systemu. Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu nie zapewniają użytkownikowi wymaganego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności oraz nie są zatwierdzone do użytku przez firmę Senseonics.

Pomoc techniczna

W przypadku niezrozumienia czegokolwiek w tej części prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 844-SENSE4U (844 736 7348) na terenie Stanów Zjednoczonych. Poza USA należy zadzwonić do lokalnego dystrybutora lub odwiedzić stronę global.eversensediabetes.com, aby odszukać lokalnego dystrybutora. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji użytkowania Eversense NOW, odwiedź stronę: **https://global.eversensediabetes.com/patient-education/eversense-user-guides**.

Dołączenie do kręgu Eversense

Krąg Eversense odnosi się do grupy osób, które mogą zdalnie monitorować dane użytkownika systemu Eversense CGM dotyczące poziomu glukozy oraz związanych z nim alertów. Aby dołączyć do kręgu, należy zaakceptować zaproszenie wysłane w wiadomości e-mail otrzymanej od użytkownika systemu Eversense CGM, utworzyć konto na stronie internetowej Eversense DMS i pobrać aplikację mobilną Eversense NOW.

Program Eversense DMS jest aplikacją internetową, kompatybilną z systemem Eversense CGM. Służy do wyświetlania historycznych danych i raportów dotyczących odczytów poziomów glukozy w celu identyfikowania trendów i ułatwiania kontrolowania cukrzycy u pacjenta. Program Eversense DMS pozwala również na utworzenie konta i zdalne wyświetlanie danych odczytów poziomów glukozy przy użyciu aplikacji Eversense NOW. Nie można zdalnie wyświetlać danych odczytów poziomów glukozy przy użyciu programu Eversense DMS. Więcej informacji na temat programu Eversense DMS można znaleźć na stronie internetowej **www.eversensediabetes.com**.

Akceptowanie zaproszenia do kręgu Eversense


Krąg Eversense to grupa osób, która została zaproszona przez użytkownika systemu Eversense CGM do zdalnego wyświetlania jego danych i alertów dotyczących poziomu glukozy.


1. **Otrzymasz w wiadomości e-mail zaproszenie „Zaproszenie do obejrzenia danych dotyczących glukozy”, aby dołączyć do kręgu użytkownika Eversense CGM.**


Uwaga: jeśli spodziewasz się zaproszenia, lecz nie widzisz go w swojej skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spamu lub folder niechcianych wiadomości.

2. **Kliknij łącze znajdujące się w wiadomości e-mail.**

3. Zaloguj się na swoje konto Eversense.

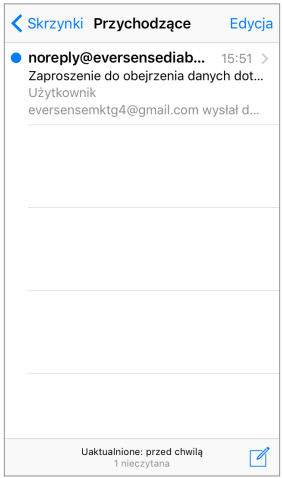

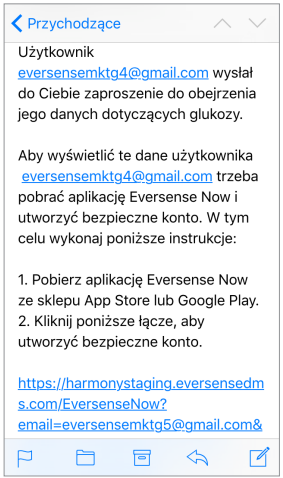

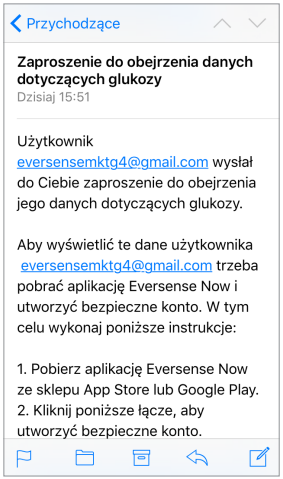

Uwaga: aplikacja Eversense NOW pozwala na dołączenie do maksymalnie 10 kręgów Eversense. Po otrzymaniu zaproszenia do 11. kręgu (przed jego zaakceptowaniem) użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o rezygnację z jednego z istniejących kręgów.

Pobieranie aplikacji Eversense NOW


1. Przejdź do Apple App Store i wyszukaj „**Eversense NOW**”.

2. Dotknij ikony **Eversense NOW**, pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu inteligentnym.

3. Gdy wyświetlony zostanie monit, dotknij „**Pozwalaj**”, aby otrzymać związane z poziomem glukozy alerty od użytkowników Eversense CGM z listy.

Przestroga: w przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień z aplikacji Eversense NOW nie będziesz otrzymywać alertów dotyczących poziomu glukozy od użytkowników systemu Eversense CGM.



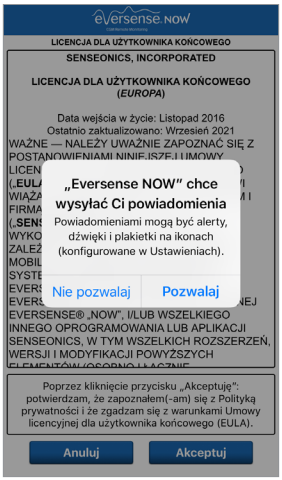



4. Zostanie wyświetlona pełna wersja LICENCJA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Zapoznaj się z nią i zaakceptuj. Zostanie wtedy wyświetlone podsumowanie Licencji dla użytkownika końcowego.


   • Potwierdź i dotknij opcji **Akceptuj**.


5. Utwórz konto Eversense, aby zalogować się do aplikacji.


Uwaga: jeśli masz już konto Eversense, nie musisz tworzyć nowego konta, aby korzystać z aplikacji Eversense NOW. Kliknij łącze w wiadomości e-mail z zaproszeniem i zaloguj się na istniejące konto Eversense. Po odświeżeniu na stronie głównej aplikacji Eversense NOW będzie wyświetlone imię i nazwisko użytkownika CGM, którego zaproszenie zaakceptowano. Jeśli chcesz usunąć utworzone konto, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa po wpisaniu niepoprawnego hasła w aplikacji mobilnej trzy razy z rzędu konto zostanie zablokowane na 30 minut. W tym czasie nie będzie dostępu do zdalnego monitorowania danych użytkowników systemu Eversense CGM.

6. Wybierz jednostkę miary. Wybrana jednostka miary zostanie zastosowana dla wszystkich użytkowników Eversense CGM, których dane możesz wyświetlać. Nie można zmienić jednostki miary po zainstalowaniu aplikacji.

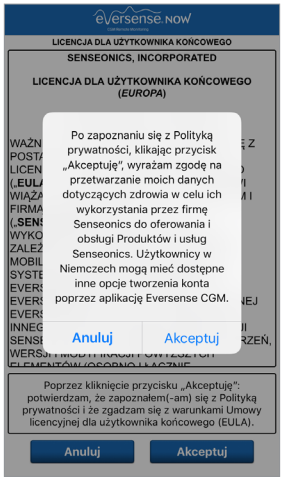

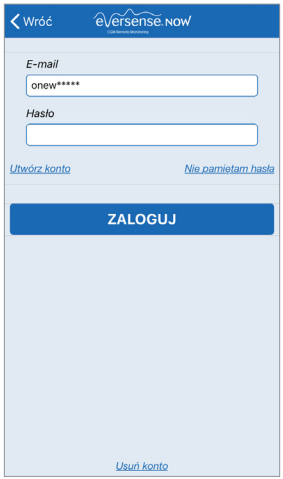

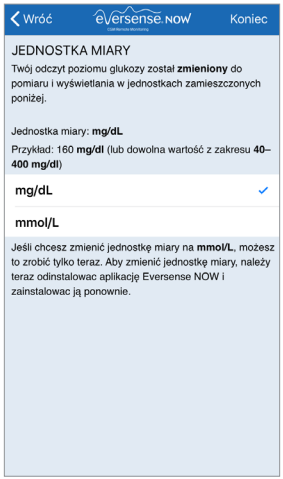

Usuwanie użytkownika systemu Eversense CGM z listy

Usunięcie użytkownika systemu Eversense CGM z listy oznacza, że nie będzie można zdalnie monitorować jego danych dotyczących poziomu glukozy. Aby ponownie dodać użytkownika do listy, należy skontaktować się z użytkownikiem systemu Eversense CGM i poprosić o przesłanie nowego zaproszenia.


1. **Przesuń nazwę użytkownika systemu Eversense CGM na ekranie głównym w lewo.**

2. **Dotknij opcji „Usuń”.**


   Wyświetli się ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie usunięcia użytkownika systemu Eversense CGM.


3. **Dotknij opcji „Tak”, aby na stałe usunąć tę osobę z listy.**

   Użytkownik nie będzie już wyświetlany na liście na ekranie głównym.

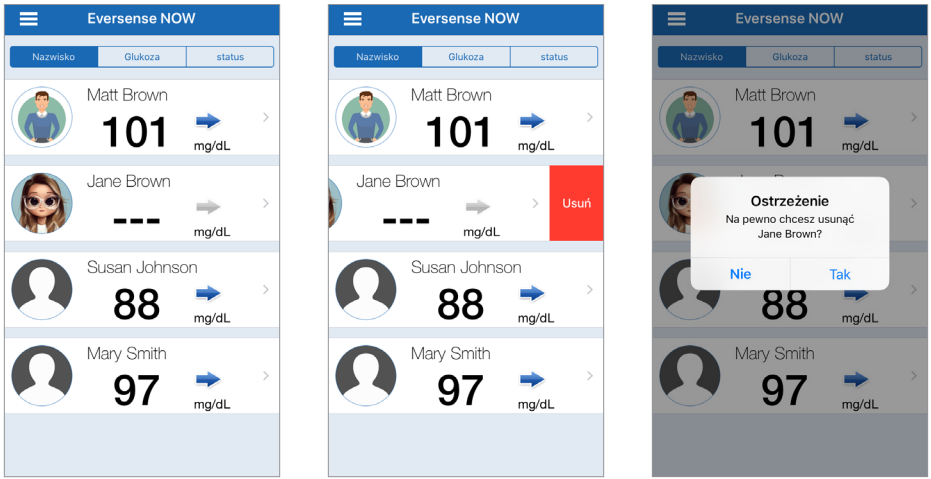

Uwaga: aktualizacja grupy osób w kręgu aplikacji systemu Eversense CGM informująca użytkownika systemu Eversense CGM o zmianie może potrwać do 2 godzin.

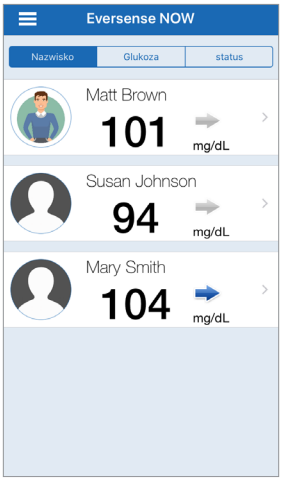




Uwaga: użytkownik systemu Eversense CGM może również usuwać uczestników swojego kręgu. W takim przypadku uczestnik otrzyma powiadomienie.


Menu główne

Menu główne umożliwia dostęp do ekranu głównego aplikacji Eversense NOW, informacji o stronie i strony wylogowania.


Z poziomu menu głównego można przejść do ekranu głównego w celu wyświetlenia na swojej liście użytkowników systemu Eversense CGM, wyświetlenia informacji o aplikacji Eversense NOW na karcie Informacje, wylogowania się z aplikacji, dodania zdjęcia profilowego.

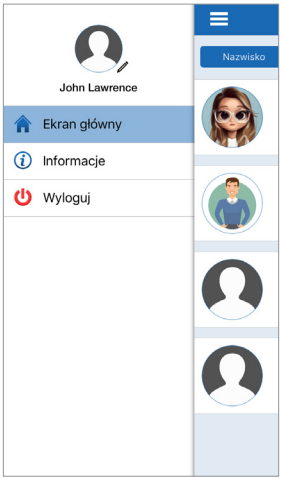

Aby przejść do menu głównego, należy dotknąć ikony z trzema paskami w lewym górnym rogu ekranu.

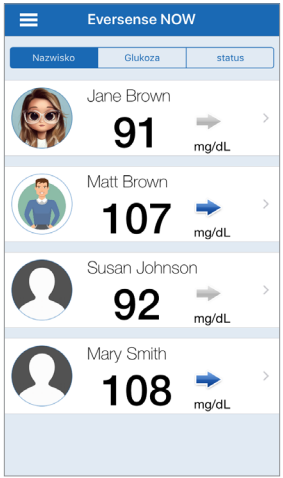


Ekran główny

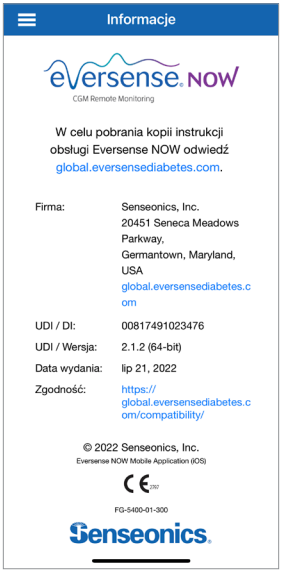


Informacje

Aplikacja Eversense NOW wyświetli powiadomienie z prośbą o potwierdzenie przed wylogowaniem. Po wylogowaniu w celu ponownego otwarcia aplikacji konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

Aby dodać zdjęcie profilowe, należy dotknąć ikony zdjęcia profilowego w menu głównym aplikacji Eversense NOW. Aby zrobić zdjęcie lub dodać zdjęcie zapisane na urządzeniu przenośnym, należy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną w powiadomieniach. Dodane zdjęcie profilowe będzie także wyświetlane w aplikacji użytkownika systemu CGM obok nazwy użytkownika.

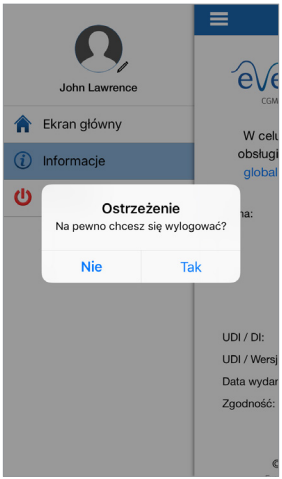

Wyloguj

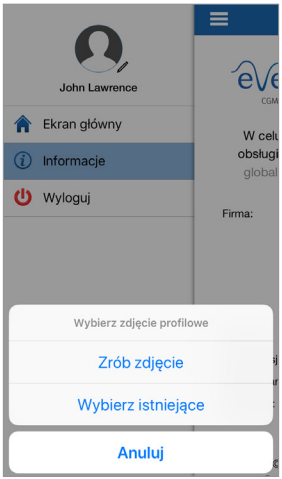

Zdjęcia profilowe

Wyświetlanie danych z systemu CGM

Strona główna wyświetla listę osób, których dane z systemu CGM można odczytywać zdalnie, wraz z ostatnią wartością CGM oraz strzałką trendu wskazującą kierunek i szybkość zmian.

Lista jest domyślnie sortowana według nazwisk. Listę można sortować według nazwiska, glukozy oraz statusu, klikając żądaną kartę u góry strony.


Ekran główny aplikacji Eversense NOW

Aby odświeżyć ekran główny:


1. Otwórz **Ekran główny**.
2. **Przesuń w dół z wnętrza ekranu głównego *(jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, po przeciągnięciu palcem od góry ekranu otwiera się okno widżetów iOS zamiast odświeżenia ekranu głównego).***

   Dane glukozy użytkownika systemu CGM odświeżają się w aplikacji Eversense NOW automatycznie co 5 minut, jeśli Ty oraz użytkownik systemu CGM jesteście połączeni z Internetem.


Przestroga: **jeśli użytkownik systemu Eversense CGM wyłączy funkcję automatycznej synchronizacji, wartości pomiarów glukozy nie będą automatycznie przesyłane do aplikacji Eversense NOW.**

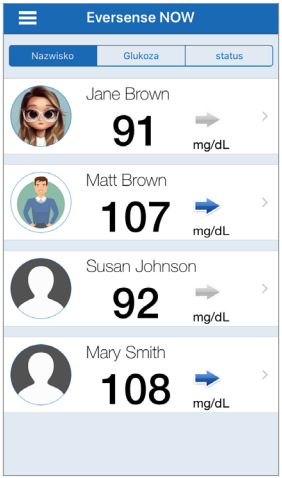

Strona główna sortowana według nazwiska

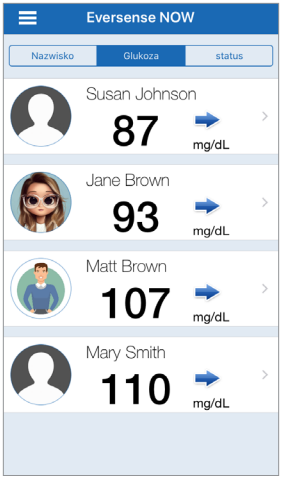

Strona główna sortowana według poziomu glukozy

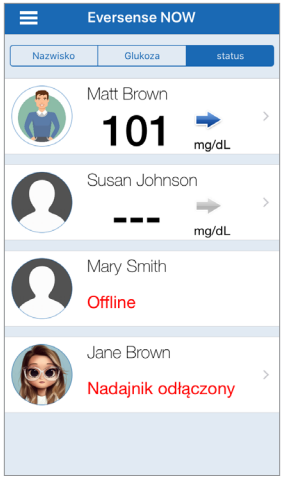

Strona główna sortowana według statusu

Strzałki trendu


Obok nazwy użytkownika systemu Eversense CGM zostanie wyświetlona strzałka trendu. Strzałka trendu pokazuje obecny kierunek oraz tempo zmian poziomu glukozy.

Aby wykonać obliczenia i wyświetlić strzałkę trendu poziomu glukozy, aplikacja wykorzystuje **dane dotyczące stałego monitorowania poziomu glukozy z ostatnich 20 minut**. W przypadku braku wystarczającej ilości danych z czujnika do obliczeń strzałka trendu nie jest wyświetlana, a wartość poziomu glukozy ma kolor szary zamiast czarnego.

	Poziomy glukozy rosną lub spadają z szybkością od 0,0 mg/dl do 1,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy rosną umiarkowanie z szybkością od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy spadają umiarkowanie z szybkością od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy rosną bardzo szybko z szybkością ponad 2,0 mg/dl na minutę.
	Poziomy glukozy spadają bardzo szybko z szybkością ponad 2,0 mg/dl na minutę.

Status

Obok nazwy użytkownika systemu Eversense CGM można wyświetlić jeden z czterech statusów.

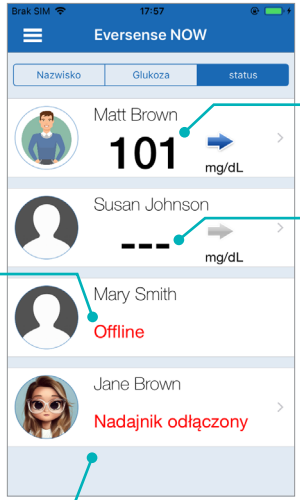

Ostatni odczyt poziomu glukozy
Użytkownik aktywnie otrzymuje dane dotyczące poziomu glukozy.

„---”
Inteligentny nadajnik użytkownika jest podłączony, ale obecnie nie otrzymuje danych dotyczących poziomu glukozy lub nie ma wystarczającej ilości danych do wyświetlenia.
Przyczyny:

- System CGM jest w fazie rozgrzewania.
- Użytkownik CGM jest w fazie inicjalizacji i nie otrzymał jeszcze swojego pierwszego odczytu poziomu glukozy.
- Użytkownik otrzymał alert, który uniemożliwia wyświetlanie danych dotyczących poziomu glukozy.

„Offline”
Użytkownik tymczasowo wyłączył udostępnianie danych. (Aktualizacja statusu w aplikacji Eversense NOW użytkownika może zająć do 10 minut).


„Nadajnik odłączony”
Brak połączenia pomiędzy inteligentnym nadajnikiem i aplikacją Eversense CGM. Przyczyny:

- Bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana lub jest w trakcie ładowania.
- Połączenie Bluetooth, połączenie z Internetem lub urządzenie przenośne jest wyłączone.
- Inteligentny nadajnik jest poza zasięgiem lub jest wyłączony.
- Użytkownik systemu CGM wyłączył automatyczną synchronizację.

Wykres trendu

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących poziomu glukozy użytkownika systemu CGM na stronie głównej należy dotknąć nazwy użytkownika systemu Eversense CGM. Pierwszy ekran pokazuje wykres trendu wartości glukozy użytkownika z ostatnich trzech godzin.
Strzałka trendu wskazuje obecny kierunek i tempo zmian stężenia glukozy.

Aby odświeżyć ekran, należy dotknąć ikony odświeżania .

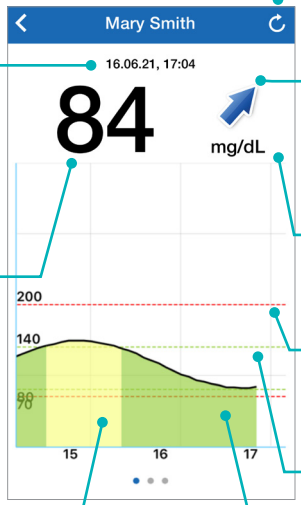

Odśwież
Wczytuje ostatnio zsynchronizowane dane odczytów poziomu glukozy.

Data i godzina*
Data i godzina wyświetlanego odczytu poziomu glukozy.

Strzałka trendu
Kierunek i tempo zmian poziomu glukozy użytkownika (stopniowo, umiarkowanie, szybko rośnie lub szybko spada).

Odczyt poziomu glukozy
Poziom glukozy z ostatniej synchronizacji.

Jednostka miary
Jednostka miary wykorzystywana do wyświetlania wszystkich danych odczytów poziomu glukozy.


Czerwone linie przerywane
Ustawienia wysokiego i niskiego poziomu alertów wprowadzone przez użytkownika.

Zielone linie przerywane
Wysoki i niski zakres docelowy ustawiony przez użytkownika.

Żółty obszar pod linią trendu
Wskazuje wartości glukozy użytkownika znajdujące się poza ustawionym zakresem docelowym, ale znajdujące się w ustawionym zakresie alertu.

Zielony obszar pod linią trendu
Wskazuje wartości poziomu stężenia glukozy użytkownika znajdujące się w ustawionym zakresie docelowym.

** W przypadku nieotrzymania nowego odczytu poziomu glukozy w ciągu 5 minut od ostatniej wartości poziomu stężenia glukozy data i godzina będą wyświetlane na czerwono.*




Czerwony obszar pod linią trendu
Wskazuje poziomy stężenia glukozy użytkownika znajdujące się poza ustawionym zakresem alertu.

Alerty aplikacji Eversense NOW


W sytuacji gdy użytkownik systemu Eversense CGM otrzyma alert poziomu glukozy, aplikacja Eversense NOW wysyła również alert do osób w jego lub jej kręgu. Alerty mogą być wyświetlane w postaci powiadomienia na ekranie blokady, powiadomienia w górnej części ekranu, okna wyskakującego lub powiadomienia na zegarku Apple Watch.

Ostrzeżenie: informacje o poziomie glukozy wyświetlane w aplikacji Eversense NOW nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Aplikacja Eversense NOW służy pomocniczo do wyświetlania danych z systemu Eversense CGM i nie należy jej używać jako ekranu głównego systemu Eversense CGM.


Uwaga: aby otrzymywać alerty o poziomach glukozy na zegarku Apple Watch, w aplikacji Eversense NOW należy ustawić powielanie powiadomień na zegarku Apple Watch.

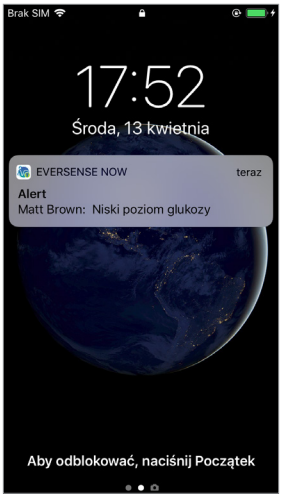


Alert: ekran blokady

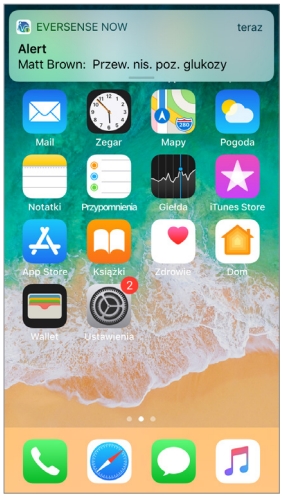

Alert: powiadomienie

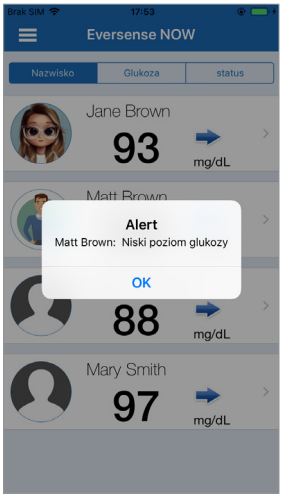

Alert: w oknie wyskakującym w aplikacji



Alert: na zegarku Apple Watch


Historia alertów

Aby przejrzeć historię alertów o poziomach glukozy użytkownika systemu Eversense CGM, należy przesunąć ekran na lewo z widoku wykres trendu.

Ekran **Historia alertów** wyświetla ostatnie 20 alertów związanych z poziomem glukozy, które użytkownik otrzymał w aplikacji Eversense CGM.

Alerty monitorują zdarzenia takie jak tempo wzrostu lub spadku poziomu glukozy, wysokie i niskie wartości poziomu stężenia glukozy (hiperglikemia lub hipoglikemia).


Uwaga: po włączeniu funkcji alertów przewidywania w systemie Eversense CGM będą otrzymywane wyłącznie alerty dotyczące przewidywanego wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

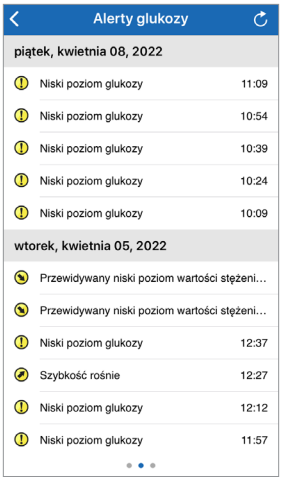

Dziennik zdarzeń

Aby przeglądać dziennik zdarzeń Eversense CGM, należy przesunąć ekran w lewo z widoku Historia alertów.

Dziennik zdarzeń wyświetla 20 ostatnich zdarzeń zapisanych przez użytkownika systemu CGM. Ekran Dziennik zdarzeń pokazuje informacje wprowadzone przez użytkownika systemu Eversense CGM: kalibracje, posiłki, wysiłek fizyczny, poziom glukozy we krwi, poziom insuliny, stan zdrowia. Jeżeli użytkownik nie wprowadził żadnych zdarzeń, lista będzie pusta.

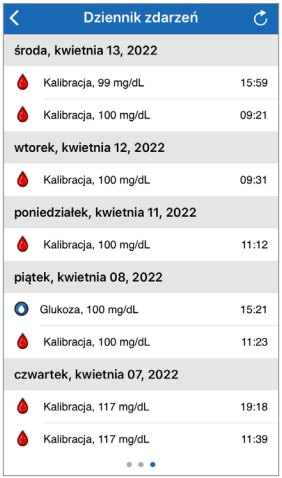

Informacje prawne

Informacje prawne firmy Apple

Określenia „Made for iPod touch”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia się odpowiednio z urządzeniem iPod touch, iPhone lub iPad oraz jest opatrzone certyfikatem jakości zgodnym ze standardami firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie niniejszego urządzenia ani za jego zgodność z normami elektrycznymi i normami bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniami iPod touch, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność połączenia bezprzewodowego.

Apple, iPad, iPhone, iPod oraz iPod touch to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w USA i w pozostałych krajach.

Informacje prawne firmy Google

Nazwa „Android”, logo Android oraz Google Play to znaki handlowe firmy Google Inc.

Informacje o Bluetooth®

Bluetooth® to rodzaj komunikacji bezprzewodowej (radiowej). Technologia Bluetooth® jest wykorzystywana w smartfonach oraz wielu innych urządzeniach. Inteligentny nadajnik wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart do parowania nadajnika z urządzeniem przenośnym oraz przesyłania wyników do aplikacji.

Znak handlowy Bluetooth®

Znak handlowy i logotypy Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth® SIG, Inc. a firma Senseonics, Inc. używa ich na podstawie licencji.

Informacje FCC

Nadajnik inteligentny spełnia wymagania części 15 Zasad FCC. Działanie urządzenia podlega poniższym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
(2) Urządzenie musi tolerować wszystkie zakłócenia, łącznie z takimi, które mogą powodować niepożądane skutki.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez firmę Senseonics, Inc., mogą skutkować anulowaniem prawa użytkownika do użytkowania urządzenia.

Niniejsze zalecenia mają na celu zapewnienie, że inteligentny nadajnik nie będzie wpływał na działanie pobliskich urządzeń elektronicznych. Ponadto inne urządzenia elektroniczne nie powinny mieć wpływ na działanie inteligentnego nadajnika.

Z wyjątkiem obsługiwanego urządzenia mobilnego, pozostałe znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne, takie jak telefon komórkowy, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa, mogą uniemożliwiać lub opóźniać przesyłanie danych ze smartfona do aplikacji. Oddalenie się od takich urządzeń elektronicznych może poprawić komunikację.

Nadajnik inteligentny został przetestowany, a testy potwierdziły jego przydatność do użytku domowego. W większości przypadków nie powinien on zakłócać działania innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem przestrzegania zasad jego użytkowania. Inteligentny nadajnik emituje energię w postaci falach radiowych. W przypadku niewłaściwego użytkowania nadajnik może zakłócać pracę odbiorników telewizyjnych i radiowych lub innych urządzeń elektronicznych odbierających lub nadających fale radiowe.

W przypadku problemów z zakłóceniami należy oddalić się od źródła zakłóceń. Można też przesunąć urządzenie elektroniczne lub jego antenę w inne miejsce, co także rozwiąże problem zakłóceń.

W przypadku, gdy zakłócenia będą się powtarzać, należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta urządzenia elektronicznego będącego źródłem zakłóceń.

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego

Firma Senseonics, Inc. deklaruje, że typ sprzętu radiowego, do którego należy inteligentny nadajnik Eversense E3, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: **https://global.eversensediabetes.com/declarationofconformity**.

Indeks

Alerty...91, 95, 99, 101, 107, 123, 124, 125, 127
Alerty i powiadomienia, urządzenie Apple Watch.....177
Aplikacja, informacje.....11, 92
Aplikacja, informacje o produkcie.....169, 171
Aplikacja, pobieranie.....31
Aplikacja, uruchomienie.....32
Aplikacja, użytkowanie.....68
Aplikacja, wylogowanie.....173
Bateria, ładowanie.....29
Bezprzewodowy...13, 28, 68, 332
Bluetooth.....92, 332
Bluetooth, ponowne włączanie.....213
Czujnik.....205
Czujnik, informacje...10, 205, 208
Czujnik, wszczepianie i usuwanie.....206, 207
Ekran MOJA GLUKOZA.....39, 68, 71, 91
Elementy systemu.....10
Eversense DMS.....164, 259
Eversense NOW.....310
Informacje FCC.....333
Inteligentny nadajnik, informacje.....10, 17
Inteligentny nadajnik, konserwacja.....55
Inteligentny nadajnik, mocowanie.....50
Inteligentny nadajnik, resetowanie.....139, 213
Inteligentny nadajnik, użytkowanie.....48, 49
Inteligentny nadajnik, włączanie/wyłączanie.....54
Jednostka miary.....37
Kalibracja, faza codzienna...58, 61
Kalibracja, faza inicjalizacji..58, 60
Kalibracja, procedura....58, 63, 91
Kontrolka LED.30, 48, 54, 56, 57
Łączenie inteligentnego nadajnika z czujnikiem.....41
Menu.....91
Mój krąg.....167, 198
Parowanie, inteligentny nadajnik i urządzenie mobilne...32, 36, 212
Podróże.....208
Ponowne włączanie funkcji Bluetooth.....213
Powiadomienia.....124, 149, 194
Poziom naładowania baterii, wskaźnik.....55
Poziomy docelowe.....97
Profil tymczasowy.....120
Przewodnik umieszczania, siła sygnału.....52, 92
Przycisk na inteligentnym nadajniku.....35, 48, 54
Przylepiec.....50, 53
Raporty.....91, 161
Resetowanie inteligentnego nadajnika.....139, 213
RF to komunikacja wykorzystująca częstotliwości radiowe.....332
RM, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego...16, 17
Rozwiązywanie problemów, najczęściej zadawane pytania.....209
Stacja dokująca.....17
Strzałki trendu.....74
Symbole, alerty, powiadomienia.....250, 251, 252
Symbole, opakowanie i urządzenie.....253, 254, 255

System zarządzania bazą danych (DMS)....164
Tryb „Nie przeszkadzać”....117
Tryb „Widoczny”....35, 212, 215
Udostępniane danych....164
Udostępnianie aplikacji....168
Udostępnij moje dane....164
Urządzenie przenośne....31, 70
Urządzenie przenośne, Apple Watch....174
USB, gniazdo....29
USB, kabel....29
Ustawienia, aplikacja....32, 92, 93, 104
Ustawienie powtarzania....107
Wykres trendu....90
Zasilacz....30
Zdarzenia....91, 153

Basic UDI/DI:
- Zestaw inteligentnego nadajnika Eversense E3: 081749102FG3500T8
- Zestaw przylepca Eversense E3: 081749102FG6400TQ
- Stacja dokująca Eversense: 081749102FG6501TX
- Aplikacja mobilna Eversense dla systemu iOS: 081749102FG5101T4
- Aplikacja mobilna Eversense dla systemu Android: 081749102FG5301TE
- Eversense DMS 081749102FG5200T7
- Aplikacja mobilna Eversense NOW na urządzenia z systemem iOS: 081749102FG5400TH
- Aplikacja mobilna Eversense NOW na urządzenia z systemem Android: 081749102FG5401TK

Aby skontaktować się z obsługą klienta, zadzwoń pod numer +48 22 372 72 20, wew.4 (pn-pt, 9.00-17.00).

Dystrybucja:

Polska
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Polska
+48 22 372 7220
www.ascensia.com/eversense

eversense®

Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
global.eversensediabetes.com

Patents:
www.senseonics.com/products/patents

Senseonics®

CE 2797

EC REP **Emergo Europe**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

EU: MedEnvoy global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123, The Hague
The Netherlands

(241) LBL-4202-22-001_REV_J

© Senseonics, Inc. 2025 PN: LBL-4202-22-001 Rev J 01/2025

Dimensions	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded (*Include folded dimensions if applicable*):	

Colors: 4/color
Spot (*Name PMS colors if applicable*): N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text